

Verbale n. 1 del 12 marzo 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta Pubblica

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADIE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno dodici del mese di marzo, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
Teresa ANDRIANI	Segretario

Ai sensi di quanto stabilito all'art.21 del Disciplinare di gara nel caso della presente seduta pubblica la Commissione procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti all'art. 16 del medesimo Disciplinare, di seguito elencati:

- a) Scheda tecnica del dispositivo offerto
- b) Documentazione attestante la conformità del dispositivo offerto alle direttive europee applicabili;
- c) Documento di garanzia;
- d) Scheda delle caratteristiche del servizio di assistenza tecnica;
- e) Relazione tecnica di sintesi del sistema offerto;
- f) Elenco senza prezzo degli accessori, consumabili e software;
- g) Programma temporale della fornitura;
- h) Programma di addestramento del personale;
- i) Requisiti per l'installazione e l'esercizio;
- j) Schema di contratto di manutenzione "full-risk".

Alla seduta, partecipa anche il Responsabile del Procedimento ing. Giuseppe Bianchini in possesso delle credenziali di accesso alla procedura telematica ed alle relative buste telematiche.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

E' presente alla seduta il sig. Giuseppe Luongo, giusta delega agli atti, in rappresentanza dell'operatore economico Stryker Italia S.r.l.

Alle ore 11:30 il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e da inizio alla fase di apertura della *Busta B - "Offerta tecnica"* degli operatori economici ammessi a tale fase in esito alla verifica della documentazione amministrativa effettuata dal Seggio di gara che hanno presentato offerta per il **Lotto n. 1** secondo l'ordine di arrivo della candidatura telematica e di seguito elencati:

Lotto	Plico n.	Operatore economico
1	1	TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
	5	MARTIN ITALIA S.r.l.
	6	STRYKER ITALIA S.r.l.

La Commissione procede, quindi, all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **TRUMPF MED ITALIA S.r.l** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - "Documentazione tecnica" della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all'assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all'offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - "Documentazione tecnica" della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all'assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all'offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **MARTIN ITALIA S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - "Documentazione tecnica" della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all'assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all'offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **STRYKER ITALIA S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - "Documentazione tecnica" della documentazione richiesta dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Relativamente al documento “Relazione relativa alla Garanzia” la commissione si riserva di chiedere all’offerente se il numero di mesi indicato nel documento al primo capoverso “La garanzia full- risk è per 48 mesi decorrenti dalla data del collaudo positivo e prevede” coincide con il parametro GDO (durata in mesi della garanzia offerta) offerto in busta C.

Tanto, in considerazione del fatto che:

- 1) ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di gara, l’indicazione della durata del periodo di garanzia costituisce motivo di esclusione;
- 2) avendo in tale documento indicato il minimo previsto dagli atti di gara, è necessario acquisire la conferma /non conferma che lo stesso dato sia tal quale riportato in busta C (in caso di conferma ne conseguirà l’esclusione)

La Commissione, chiede, pertanto, al Responsabile del Procedimento di formulare la suddetta richiesta di chiarimento all’operatore economico in questione.

La Commissione procede quindi alla disamina della documentazione presentata relativamente al **Lotto n. 2** dagli offerenti di seguito elencati:

Lotto	Plico n.	Operatore economico
2	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
	4	F.A.S.E. Srl
	5	MARTIN ITALIA S.r.l
	6	STRYKER ITALIA S.r.l.

La Commissione procede all’apertura della busta telematica B presentata dall’operatore economico **HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall’art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - “Documentazione tecnica” della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all’assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all’offerta economica.

La Commissione procede all’apertura della busta telematica B presentata dall’operatore economico **F.A.S.E. S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall’art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - “Documentazione tecnica” della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all’assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all’offerta economica.

La Commissione procede all’apertura della busta telematica B presentata dall’operatore economico **MARTIN ITALIA S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall’art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - “Documentazione tecnica” della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all’assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all’offerta economica.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

“Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per ~~sola~~ operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera”

La Commissione procede all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **STRYKER ITALIA S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione nel riscontrare la completezza della documentazione prodotta rileva l'assenza del "Documento di garanzia" previsto alla lettera c) dell'art. 16, essendo stato caricato altro file non pertinente relativo alla conformità del dispositivo offerto.

Ciò premesso in applicazione di quanto previsto dalla regola di gara che richiede a pena di esclusione la completezza della documentazione contenuta nella "Busta B – Offerta tecnica", la Commissione dispone l'esclusione dell'operatore economico **STRYKER ITALIA S.r.l.** per il lotto in questione.

La Commissione procede quindi alla disamina della documentazione presentata relativamente al **Lotto n. 3** dagli offerenti di seguito elencati

	Lotto	Plico n.	Operatore economico
3	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
		4	F.A.S.E. Srl
		5	MARTIN ITALIA S.r.l

La Commissione procede all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - "Documentazione tecnica" della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all'assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all'offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **F.A.S.E. S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - "Documentazione tecnica" della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all'assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all'offerta economica.

La Commissione procede all'apertura della busta telematica B presentata dall'operatore economico **MARTIN ITALIA S.r.l.** ed alla disamina della documentazione ivi contenuta in merito a quanto richiesto dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione riscontra la completezza della presenza nella Busta B - "Documentazione tecnica" della documentazione richiesta dal Disciplinare di gara, nonché il rispetto di quanto previsto dal citato art. 16 in merito all'assenza di qualsiasi indicazione o riferimento all'offerta economica.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Alle ore 12:30 il Presidente, esaurite le operazioni odierne dichiara chiusa la seduta pubblica e consegna tutta la documentazione tecnica al Segretario della Commissione giudicatrice per la custodia in luogo sicuro all'interno della sede della SUA-RB al piano 5 del palazzo della Giunta Regionale in via V. Verrastro, n. 4.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente




ing. Giuseppe SPERA – Componente



dott. Rocco CARBONELLA – Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario



Verbale n. 2 del 12 marzo 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA –N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 12.30, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
Teresa ANDRIANI	Segretario

Si da atto del termine di 60 giorni per l'espletamento delle attività oggetto dell'incarico che consiste nella valutazione di n. 10 offerte decorrenti dalla data odierna in cui si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura della Busta "B".


Dopo una breve disamina dell'art.18 e 21 del Disciplinare di gara relativi alla valutazione delle offerte, la Commissione giudicatrice condivide a grandi linee le modalità di prosecuzione dei lavori.

In considerazione, infatti, di quanto previsto all'art. 21 del Disciplinare di gara che prevede, propedeuticamente alle sedute riservate inerenti la valutazione delle offerte tecniche, una sessione dimostrativa (DEMO) finalizzata a saggiare de visu le caratteristiche e funzionalità dei prodotti offerti da tenersi presso un locale appositamente adibito dall'ASM, la Commissione chiede al Responsabile del Procedimento ing. Bianchini di contattare il committente ASM per la calendarizzazione delle attività dimostrative previste.

Nelle more della suddetta calendarizzazione, la Commissione stabilisce di procedere alla disamina delle offerte per la mera verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dagli atti di gara.



COMMISSIONE GIUDICATRICE

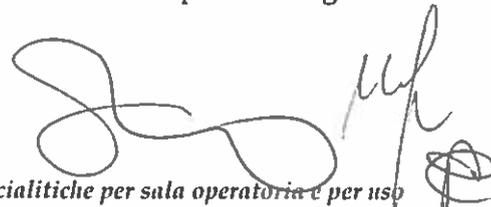

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"


Alle ore 12:50 la seduta viene sospesa, autoconvocandosi per il 21.03. 2019 alle ore 09:30 presso i locali della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente



ing. Giuseppe SPERA – Componente



dott. Rocco CARBONELLA – Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario



COMMISSIONE GIUDICATRICE

“Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera”

Verbale n. 3 del 21 marzo 2019 della Commissione Giudicatrice

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 11.00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
Teresa ANDRIANI	Segretario

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia alla Commissione della corrispondenza intercorsa con l'operatore economico STRYKER ITALIA S.r.l., a seguito della richiesta di chiarimento emersa in occasione della seduta pubblica del 12.03.2019, giusto verbale agli atti.

La Commissione prende atto della risposta al quesito trasmessa da STRYKER ITALIA S.r.l. con PEC del 20.03.2019 (nota prot. n. 0049677/AOO del 21.03.2019) con la quale l'operatore economico conferma che il dato inserito nel *Documento di garanzia* presente in busta a B coincide con quello presente nell'offerta economica.


Ciò premesso, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 16 del Disciplinare di gara, la Commissione conferma l'esclusione, già preannunciata nella seduta pubblica del 12.03.2019, della ditta STRYKER ITALIA S.r.l. dalle successive fasi gara e pertanto non procederà alla valutazione dell'offerta tecnica prodotta.

La Commissione da mandato al Segretario di attivare le attività necessarie alla trasmissione di copia del presente verbale e del verbale della seduta pubblica del 12.03.2019 al Responsabile del Procedimento per la predisposizione degli atti conseguenti.



COMMISSIONE GIUDICATRICE


"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

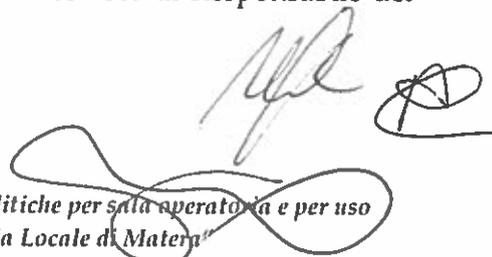

Alle ore 11:30 la seduta viene sospesa, autoconvocandosi per le ore 12:00 presso i locali della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'avvio delle attività di verifica del possesso dei requisiti minimi delle offerte tecniche.

Letto, confermato e sottoscritto


ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente

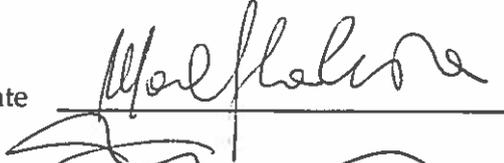

ing. Giuseppe SPERA – Componente



dott. Rocco CARBONELLA – Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario



COMMISSIONE GIUDICATRICE

“Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera”

Verbale n. 4 del 21 marzo 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore 12.00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

La Commissione giudicatrice da avvio alle attività di valutazione propedeuticamente con la verifica della sussistenza dei requisiti minimi delle offerte tecniche così come declinati all'art. 2 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* di gara prendendo in esame il **Lotto 1**, per il quale hanno presentato offerta i seguenti concorrenti ammessi:

Lotto	Plico n.	Operatore economico
1 Lampade Scialitiche per Sala Operatoria	1	TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
	5	MARTIN ITALIA S.r.l.

La Commissione procede all'analisi ed attenta disamina delle offerte pervenute al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi riferiti ai seguenti elementi:

- caratteristiche costruttive generali;
- caratteristiche illuminotecniche;
- dispositivi di comando;
- caratteristiche aggiuntive;

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

- videocamera;
- monitor;
- sistema di registrazione;
- accessori.

Alle ore 13:55 la seduta viene sospesa, autoconvocandosi per il giorno 28.09.2019 alle ore 09:30 per dare seguito alle suddette attività di verifica presso i locali della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente



ing. Giuseppe SPERA – Componente



dott. Rocco CARBONELLA – Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario



COMMISSIONE GIUDICATRICE

“Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera”

Verbale n. 5 del 28 marzo 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA –N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 11.10, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

La Commissione giudicatrice da seguito alle attività avviate nella seduta precedente del 21.03.2019 relative alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi delle offerte tecniche, così come declinati all'art. 2 del *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale* di gara, sempre relativamente al **Lotto n. 1**.

La Commissione quindi procede all'analisi ed attenta disamina delle offerte per la verifica dei requisiti minimi riferiti ai seguenti elementi:

- caratteristiche costruttive generali;
- caratteristiche illuminotecniche;
- dispositivi di comando;
- caratteristiche aggiuntive;
- videocamera;
- monitor;
- sistema di registrazione;
- accessori.

Alle ore 14:00 la Commissione dichiara terminate le attività della seduta odierna autoconvocandosi in data da concordare.

Letto, confermato e sottoscritto

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"


ing. Maria Gelsomina LAULETTA - Presidente



ing. Giuseppe SPERA - Componente



dott. Rocco CARBONELLA - Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI - Segretario



COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Verbale n. 6 del 05 aprile 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA –N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno cinque del mese di aprile, alle ore 11.00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

La Commissione giudicatrice da seguito alle attività avviate nella seduta precedente del 28.03.2019, procedendo alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi dell'offerta, così come declinati nel Capitolato speciale, relativamente alle offerte prodotte per il **Lotto n. 2** di seguito riportate:

	Lotto	Plico n.	Operatore economico
2	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
		4	F.A.S.E. Srl
		5	MARTIN ITALIA S.r.l

La Commissione procede, quindi, all'analisi ed attenta disamina delle offerte al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi riferiti ai seguenti aspetti:

- caratteristiche costruttive generali;
- caratteristiche illuminotecniche;
- sanificabilità e sterilizzazione.

La Commissione procede con analoga analisi relativa alle offerte prodotte per il **Lotto n. 3** di seguito riportate:

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto	Plico n.	Operatore economico
3	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
	4	F.A.S.E. Srl
	5	MARTIN ITALIA S.r.l

La Commissione procede, quindi, all'analisi ed attenta disamina delle offerte al fine di verificare la sussistenza dei requisiti minimi riferiti ai seguenti aspetti:

- caratteristiche costruttive generali;
- caratteristiche illuminotecniche;
- sanificabilità e sterilizzazione.

Relativamente alle sopra indicate attività di verifica dei requisiti minimi, la Commissione rappresenta la necessità di formulare un approfondimento di natura squisitamente tecnica che interessa tutti i lotti in gara e, pertanto, chiede al Responsabile del procedimento, per il tramite del Segretario, di attivare quanto necessario ai fini di apposita consulenza tecnica in relazione al seguente aspetto riferito al requisito D10 di una lampada scialitica, rispetto al quale si chiede di conoscere:

1. se detto parametro va inteso come valore tanto più apprezzabile quanto più piccolo rispetto ad un valore indicato quale requisito minimo ovvero se è una soluzione maggiormente valida l'offerta di un D10 più elevato;
2. se, in caso di D10 non in linea con il requisito minimo inteso ai sensi del punto precedente, la non conformità possa essere bilanciata e come possa esserlo da una maggiore intensità luminosa rispetto a quella richiesta in gara.

Esaurite le attività della seduta odierna, la Commissione, alle ore 13:45 la seduta viene conclusa autoconvocandosi in occasione della datata stabilita per le attività dimostrative DEMO presso i locali all'uopo individuati dall'ASM così come previsto dagli atti di gara.


Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente

ing. Giuseppe SPERA – Componente

dott. Rocco CARBONELLA – Componente

dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario

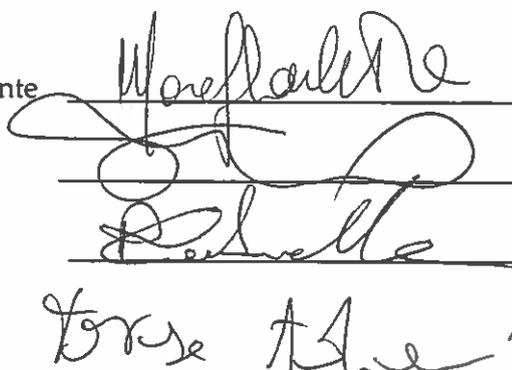

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Verbale n. 7 del 30 aprile 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera - ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

La Commissione giudicatrice riprende le attività di valutazione relative alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi delle offerte tecniche a partire dalla risposta al quesito di natura squisitamente tecnica emerso nel corso della seduta precedente del 06.04.2019 relativo al requisito D10 di una lampada scialitica rispetto al quale la Commissione ha chiesto di conoscere:

1. se detto parametro va inteso come valore tanto più apprezzabile quanto più piccolo rispetto ad un valore indicato quale requisito minimo ovvero se è una soluzione maggiormente valida l'offerta di un D10 più elevato;
2. se, in caso di D10 non in linea con il requisito minimo inteso ai sensi del punto precedente, la non conformità possa essere bilanciata e come possa esserlo da una maggiore intensità luminosa rispetto a quella richiesta in gara.

In risposta alla nota prot. n. 61047/20AB del 08.04.2019, il committente ASM, con nota del 10/04/2019 acquisita al protocollo dipartimentale con il n. 72526/20AB del 30.04.2019, ha chiarito che:

"Il D10" viene definito come il diametro all'interno del quale l'intensità luminosa si mantiene almeno al 10% della massima. Quindi un D10 maggiore ai 16 cm indicati nei requisiti minimi è da considerarsi migliorativo (infatti il requisito dice almeno). Al contrario un D10 inferiore è peggiorativo (e non rispetta il requisito minimo). Inoltre una maggiore luminosità massima (misurata al centro del fascio) non compensa un D10 più piccolo."

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

La Commissione procede, quindi, ad una revisione globale delle offerte tecniche relative a tutti i tre lotti in gara alla luce del suddetto chiarimento che vengono elencate nei prospetti sotto riportati:

Lotto		Plico n.	Operatore economico
1	Lampade Scialitiche per Sala Operatoria	1	TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
		3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
		5	MARTIN ITALIA S.r.l.

Lotto		Plico n.	Operatore economico
2	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
		4	F.A.S.E. Srl
		5	MARTIN ITALIA S.r.l.

Lotto		Plico n.	Operatore economico
3	Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso	3	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
		4	F.A.S.E. Srl
		5	MARTIN ITALIA S.r.l.

L'esito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei citati requisiti minimi viene riportato in check list di controllo appositamente predisposte allegate al presente verbale.

In esito a tale attività la Commissione rappresenta la necessità di una richiesta di chiarimento in merito ad alcuni elementi dell'offerta non chiaramente evincibili dalla documentazione prodotta e riportati nella relativa scheda di controllo, da quindi mandato al Segretario per il tramite del Responsabile del Procedimento di inoltrare all'offerente tale richiesta.

Esaurite le attività della seduta odierna, la Commissione, alle ore 12:00, dichiara la seduta conclusa autoconvocandosi a seguito di ricezione dei chiarimenti richiesti agli Operatori Economici.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente



ing. Giuseppe SPERA – Componente



dott. Rocco CARBONELLA – Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario



COMMISSIONE GIUDICATRICE

“Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera”

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADIE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - TRUMPF MED ITALIA S.r.l.

Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Caratteristiche costruttive generali			
a. Struttura con due corpi lampada preferibilmente in combinazione gemellare, con elevate prestazioni per qualunque tipo di chirurgia	X		
b. Dotate di quanto necessario (piastre, contropiastre, ancoraggi, etc..) per il montaggio a soffitto, per la corretta installazione e il funzionamento sicuro (trasformatori di alimentazione, commutazione automatica sulla linea di sicurezza, pacco batterie ausiliarie d'emergenza)	X		
c. Design ottimale per non interferire con i flussi di aereazione della sala operatoria	X		
d. Tecnologia a LED, con moduli illuminanti/LED sostituibili singolarmente	X		
e. Predisposizione per telecamera (video) su tutte le lampade	X		
f. Possibilità di successiva integrazione di almeno un ulteriore braccio e/o stativo per carichi leggeri su tutte le lampade	X		
g. Ampia possibilità di movimentazione dei bracci e dei corpi lampada			
- rotazioni e movimentazioni non devono interferire e collidere con la strumentazione presente in sala,	X		
- la manovrabilità del corpo illuminante deve essere possibile da parte di un solo operatore, sia dal manipolo centrale che da impugnature laterali.	X		
h. N. 2 lampade (delle 7 complessive) devono essere dotate di sistema di visualizzazione e registrazione di immagini di sala operatoria, composto indicativamente			
- videocamera, preferibilmente utilizzabile anche sulle altre lampade	X		
- monitor (montato su apposito braccio aggiuntivo)	X		
- sistema di registrazione di tipo medicale.	X		

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
 Caratteristiche della fornitura

		SI	NO	Note	
Caratteristiche illuminotecniche	a. Intensità luminosa centrale massima non inferiore a 150.000 lux per l'unità principale e di 130.000 lux per la secondaria	X			
	b. Luce bianca, con temperatura di colore non inferiore a 3500°K e preferibilmente regolabile su più livelli	X			
	c. Basso aumento della temperatura nella zona testa, preferibilmente non superiore a 2°C;	X			
	d. Indice di resa cromatica (Ra) almeno 95	X			
	e. Adeguata ampiezza del campo luminoso, con D10 di almeno 16 cm;	X			
	f. Possibilità di variare il diametro del campo, mantenendo la stessa intensità luminosa del punto centrale	X			
	g. Dotate di una adeguata profondità di campo: L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm e preferibilmente a 120 cm;	X			
	h. Adeguata distanza operativa: area di lavoro senza necessità di rifocalizzazione preferibilmente nel range 90 ÷ 110 cm o superiore	X			
	Dispositivi di comando	a. Comandi su corpo lampada che permettano almeno le seguenti regolazioni: accensione/spengimento, intensità luminosa e temperatura colore	X		
		b. Preferibilmente regolazione dei parametri principali anche da manipolo	X		
c. Pannello di comandi a parete (o altra soluzione fuori dall'area paziente)		X			
a. Elevata durata delle lampade (almeno 40000 h)		X			
Caratteristiche aggiuntive	b. Dotato di sistemi e/o funzioni per l'utilizzo durante le procedure endoscopiche	X			
	c. Preferibilmente dotato di sistemi per la regolazione del fuoco e di altri sistemi per la gestione automatica della luce/ombra	X			
	d. Preferibilmente fascio luminoso che consenta di variare la geometria del campo		X	L'assenza di tale requisito non costituisce motivo di in quanto esclusione richiesto	

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - TRUMPF MED ITALIA S.r.l.

Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
			"preferibilmente"
Videocamera			
a. Preferibilmente integrata nel corpo lampada o nel manipolo, deve essere di peso contenuto in modo da non inficiare la maneggevolezza della lampada	X		
b. Ad alta risoluzione, per formato HD o preferibilmente superiore	X		
c. Dotata di zoom ottico e digitale, preferibilmente regolabile anche da pannello di controllo a bordo lampada		X	L'assenza di tale requisito non costituisce motivo di in quanto esclusione richiesto "preferibilmente"
d. Preferibilmente dotata di messa a fuoco automatica	X		
e. Distanza ottimale di visualizzazione/focalizzazione (range)			Caratteristica non evincibile dalla documentazione tecnica (questo n. 1)
f. Possibilità di trasmettere il segnale sia HD che SD a monitor e a al sistema di registrazione			Caratteristica non evincibile dalla documentazione tecnica (questo n. 2)
Monitor			
a. Diagonale almeno 21"	X		
b. Risoluzione massima preferibilmente in Full HD	X		
c. Ampio angolo di visione, preferibilmente non inferiore a 170°	X		
d. Adatto alla ricezione/replica dei segnali video della telecamera, in diversi formati (es. VGA, S-Video, DVI)	X		
e. Mobile tramite impugnatura sterilizzabile			Caratteristica non evincibile dalla documentazione

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
			tecnica (quesito n. 3)
a. Capacità di archiviazione di un numero elevato di immagini e video in alta risoluzione (hard disk interno di dimensioni non inferiori a 100 GB)	X		
b. Diverse risoluzioni/formati di registrazione (almeno SD e HD)	X		
c. Preferibilmente dotato di dispositivo di comando a distanza	X		
d. Possibilità di (successiva) connessione alla rete dati e di comunicazione con altri sistemi aziendali (es. PACS)	X		
Ogni corpo lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili			Chiarire se la fornitura include due manipoli sterilizzabili per ogni corpo lampada come richiesto negli atti di gara (quesito n. 4)
Accessori			

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Caratteristiche costruttive generali		SI	NO	Note
Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l				
Caratteristiche della fornitura				
a.	Struttura con due corpi lampada preferibilmente in combinazione gemellare, con elevate prestazioni per qualunque tipo di chirurgia	X		
b.	Dotate di quanto necessario (piastre, contropiastre, ancoraggi, etc..) per il montaggio a soffitto, per la corretta installazione e il funzionamento sicuro (trasformatori di alimentazione, commutazione automatica sulla linea di sicurezza, pacco batterie ausiliarie d'emergenza)	X		
c.	Design ottimale per non interferire con i flussi di aereazione della sala operatoria	X		
d.	Tecnologia a LED, con moduli illuminanti/LED sostituibili singolarmente	X		
e.	Predisposizione per telecamera (video) su tutte le lampade	X		
f.	Possibilità di successiva integrazione di almeno un ulteriore braccio e/o stativo per carichi leggeri su tutte le lampade	X		
g.	Ampia possibilità di movimentazione dei bracci e dei corpi lampada			
	- rotazioni e movimentazioni non devono interferire e collidere con la strumentazione presente in sala,	X		
	- la manovrabilità del corpo illuminante deve essere possibile da parte di un solo operatore, sia dal manipolo centrale che da impugnature laterali.	X		
h.	N. 2 lampade (delle 7 complessive) devono essere dotate di sistema di visualizzazione e registrazione di immagini di sala operatoria, composto indicativamente			
	- videocamera, preferibilmente utilizzabile anche sulle altre lampade	X		
	- monitor (montato su apposito braccio aggiuntivo)	X		
	- sistema di registrazione di tipo medicale.	X		

Lotto N. 1 - N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l
Caratteristiche della fornitura

Caratteristiche illuminotecniche		SI	NO	Note
a.	Intensità luminosa centrale massima non inferiore a 150.000 lux per l'unità principale e di 130.000 lux per la secondaria	X		
b.	Luce bianca, con temperatura di colore non inferiore a 3500°K e preferibilmente regolabile su più livelli	X		
c.	Basso aumento della temperatura nella zona testa, preferibilmente non superiore a 2°C;	X		
d.	Indice di resa cromatica (Ra) almeno 95	X		
e.	Adeguate ampiezza del campo luminoso, con D10 di almeno 16 cm;	X		
f.	Possibilità di variare il diametro del campo, mantenendo la stessa intensità luminosa del punto centrale			Al punto 2.4 della Scheda Tecnica è definita la variabilità del campo senza specificare se l'intensità luminosa rimane costante al variare del campo (questo n.1)
g.	Dotate di una adeguata profondità di campo: L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm e preferibilmente a 120 cm;	X		
h.	Adeguate distanza operativa: area di lavoro senza necessità di rifocalizzazione preferibilmente nel range 90 ÷ 110 cm o superiore	X		
a.	Comandi su corpo lampada che permettano almeno le seguenti regolazioni: accensione/spegnimento, intensità luminosa e temperatura colore	X		
b.	Preferibilmente regolazione dei parametri principali anche da manipolo	X		
c.	Pannello di comandi a parete (o altra soluzione fuori dall'area paziente)	X		

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 1 - N. 7 LAMPADE SCALITICHE PER SALA OPERATORIA - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l
Caratteristiche della fornitura

Caratteristiche aggiuntive		SI	NO	Note
a. Elevata durata delle lampade (almeno 40000 h)		X		
b. Dotato di sistemi e/o funzioni per l'utilizzo durante le procedure endoscopiche		X		
c. Preferibilmente dotato di sistemi per la regolazione del fuoco e di altri sistemi per la gestione automatica della luce/ombra		X		
d. Preferibilmente fascio luminoso che consenta di variare la geometria del campo		X		
a. Preferibilmente integrata nel corpo lampada o nel manipolo, deve essere di peso contenuto in modo da non inficiare la maneggevolezza della lampada		X		
b. Ad alta risoluzione, per formato HD o preferibilmente superiore		X		
c. Dotata di zoom ottico e digitale, preferibilmente regolabile anche da pannello di controllo a bordo lampada		X		
d. Preferibilmente dotata di messa a fuoco automatica		X		
e. Distanza ottimale di visualizzazione/focalizzazione (frange)				Caratteristica non evincibile dalla documentazione tecnica (quesito n. 2)
f. Possibilità di trasmettere il segnale sia HD che SD a monitor e a al sistema di registrazione		X		
a. Diagonale almeno 21"		X		
b. Risoluzione massima preferibilmente in Full HD		X		
c. Ampio angolo di visione, preferibilmente non inferiore a 170°		X		
d. Adatto alla ricezione/replica dei segnali video della telecamera, in diversi formati (es. VGA, S-Video, DVI)		X		

(Handwritten signatures and initials)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l
 Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
e. Mobile tramite impugnatura sterilizzabile			Caratteristica non evincibile dalla documentazione tecnica (questo n. 3)
a. Capacità di archiviazione di un numero elevato di immagini e video in alta risoluzione (hard disk interno di dimensioni non inferiori a 100 GB)	X		
b. Diverse risoluzioni/formati di registrazione (almeno SD e HD)	X		
c. Preferibilmente dotato di dispositivo di comando a distanza	X		
d. Possibilità di (successiva) connessione alla rete dati e di comunicazione con altri sistemi aziendali (es. PACS)	X		
Ogni corpo lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili			Chiarire se la fornitura include due manipoli sterilizzabili per ogni corpo lampada come richiesto negli atti di gara – (questo n. 4)
Accessori			

Handwritten signature and initials in black ink, located at the top right of the page.

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - MARTIN ITALIA S.r.l

Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Caratteristiche costruttive generali			
a. Struttura con due corpi lampada preferibilmente in combinazione gemellare, con elevate prestazioni per qualunque tipo di chirurgia	X		
b. Dotate di quanto necessario (piastre, contropiastre, ancoraggi, etc...) per il montaggio a soffitto, per la corretta installazione e il funzionamento sicuro (trasformatori di alimentazione, commutazione automatica sulla linea di sicurezza, pacco batterie ausiliarie d'emergenza)	X		
c. Design ottimale per non interferire con i flussi di aereazione della sala operatoria	X		
d. Tecnologia a LED, con moduli illuminanti/LED sostituibili singolarmente	X		
e. Predisposizione per telecamera (video) su tutte le lampade	X		
f. Possibilità di successiva integrazione di almeno un ulteriore braccio e/o stativo per carichi leggeri su tutte le lampade	X		
g. Ampia possibilità di movimentazione dei bracci e dei corpi lampada			
- rotazioni e movimentazioni non devono interferire e collidere con la strumentazione presente in sala,	X		
- la manovrabilità del corpo illuminante deve essere possibile da parte di un solo operatore, sia dal manipolo centrale che da impugnature laterali.	X		
h. N. 2 lampade (delle 7 complessive) devono essere dotate di sistema di visualizzazione e registrazione di immagini di sala operatoria, composto indicativamente			
- videocamera, preferibilmente utilizzabile anche sulle altre lampade	X		
- monitor (montato su apposito braccio aggiuntivo)	X		
- sistema di registrazione di tipo medicale.	X		

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - MARTIN ITALIA S.r.l
Caratteristiche della fornitura

Caratteristiche illuminotecniche		SI	NO	Note
a.	Intensità luminosa centrale massima non inferiore a 150.000 lux per l'unità principale e di 130.000 lux per la secondaria	X		
b.	Luce bianca, con temperatura di colore non inferiore a 3500°K e preferibilmente regolabile su più livelli	X		
c.	Basso aumento della temperatura nella zona testa, preferibilmente non superiore a 2°C;	X		
d.	Indice di resa cromatica (Ra) almeno 95	X		
e.	Adeguate ampiezza del campo luminoso, con D10 di almeno 16 cm;	X		
f.	Possibilità di variare il diametro del campo, mantenendo la stessa intensità luminosa del punto centrale			Al punto 2.4 della Scheda Tecnica è definita la variabilità del campo senza specificare se l'intensità luminosa rimane costante al variare del campo (questo n.1)
g.	Dotate di una adeguata profondità di campo: L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm e preferibilmente a 120 cm;	X		
h.	Adeguate distanza operativa: area di lavoro senza necessità di rifocalizzazione preferibilmente nel range 90 ÷ 110 cm o superiore	X		
a.	Comandi su corpo lampada che permettano almeno le seguenti regolazioni: accensione/spegnimento, intensità luminosa e temperatura colore	X		
b.	Preferibilmente regolazione dei parametri principali anche da manipolo	X		
c.	Pannello di comandi a parete (o altra soluzione fuori dall'area paziente)	X		

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCIALTICHE PER SALA OPERATORIA - MARTIN ITALIA S.r.l
 Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Caratteristiche aggiuntive			
a. Elevata durata delle lampade (almeno 40000 h)	X		
b. Dotato di sistemi e/o funzioni per l'utilizzo durante le procedure endoscopiche	X		
c. Preferibilmente dotato di sistemi per la regolazione del fuoco e di altri sistemi per la gestione automatica della luce/ombra	X		
d. Preferibilmente fascio luminoso che consenta di variare la geometria del campo		X	L'assenza di tale requisito non costituisce motivo di in quanto esclusione richiesto "preferibilmente"
Videocamera			
a. Preferibilmente integrata nel corpo lampada o nel manipolo, deve essere di peso contenuto in modo da non inficiare la maneggevolezza della lampada	X		
b. Ad alta risoluzione, per formato HD o preferibilmente superiore	X		
c. Dotata di zoom ottico e digitale, preferibilmente regolabile anche da pannello di controllo a bordo lampada		X	L'assenza di tale requisito non costituisce motivo di in quanto esclusione richiesto "preferibilmente"
d. Preferibilmente dotata di messa a fuoco automatica	X		
e. Distanza ottimale di visualizzazione/focalizzazione (range)			Caratteristica non evincibile dalla documentazione tecnica (questo n. 2)
f. Possibilità di trasmettere il segnale sia HD che SD a monitor e a al sistema di registrazione			Caratteristica non evincibile dalla documentazione tecnica (questo n. 3)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 1 – N. 7 LAMPADE SCALITICHE PER SALA OPERATORIA - MARTIN ITALIA S.R.I
Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Monitor			
a. Diagonale almeno 21"	X		
b. Risoluzione massima preferibilmente in Full HD	X		
c. Ampio angolo di visione, preferibilmente non inferiore a 170°	X		
d. Adatto alla ricezione/replica dei segnali video della telecamera, in diversi formati (es. VGA, S-Video, DVI)	X		
e. Movibile tramite impugnatura sterilizzabile			Caratteristica non evincibile dalla documentazione tecnica (questo n. 4)
Sistema di registrazione			
a. Capacità di archiviazione di un numero elevato di immagini e video in alta risoluzione (hard disk interno di dimensioni non inferiori a 100 GB)	X		
b. Diverse risoluzioni/formati di registrazione (almeno SD e HD)	X		
c. Preferibilmente dotato di dispositivo di comando a distanza	X		
d. Possibilità di (successiva) connessione alla rete dati e di comunicazione con altri sistemi aziendali (es. PACS)	X		
Accessori			
Ogni corpo lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili			Chiarire se la fornitura include due manipoli sterilizzabili per ogni corpo lampada come richiesto negli atti di gara – (questo n. 5)

Lotto N. 2 – N. 18 Lampade Ambulatoriali Carrellate - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.

Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note	
Caratteristiche generali	a. basata su tecnologia a led, in grado di garantire elevate prestazioni illuminotecniche e di consentire ridotta emissione di calore;	X		
	b. struttura a stativo su ruote, articolata, in grado di consentire ampia movimentazione e manovrabilità. La struttura dovrà garantire stabilità in ogni posizione possibile della lampada	X		
	c. per uso diagnostico e piccola chirurgia	X		
	d. durata elevata della lampade/moduli illuminanti: almeno 30.000 h di funzionamento	X		
Caratteristiche illuminotecniche	a. intensità luminosa centrale massima non inferiore a 55.000 lux e preferibilmente fino a 100.000 lux;	X		
	b. tastierino su corpo lampada per accensione/spegnimento e regolazione dell'intensità di luce;	X		
	c. preferibile la possibilità di regolazione del fuoco, da manipolo o da tastierino su corpo lampada		X	L'assenza di tale requisito non costituisce motivo di in quanto esclusione richiesto "preferibilmente"
	d. dimensione del campo luminoso (D10) non inferiore a 12 cm	X		
	e. profondità di campo L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm;	X		
Facilmente sanificabile	X			
Ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento				
			Chiarire se la fornitura include due manipoli sterilizzabili per ogni corpo lampada come richiesto negli atti di gara – (questo n. 1)	

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scintille per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 2 – N. 18 Lampade Ambulatoriali Carrellate - F.A.S.E. S.r.l.
Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Caratteristiche generali			
a. basata su tecnologia a led, in grado di garantire elevate prestazioni illuminotecniche e di consentire ridotta emissione di calore;	X		
b. struttura a stativo su ruote, articolata, in grado di consentire ampia movimentazione e manovrabilità. La struttura dovrà garantire stabilità in ogni posizione possibile della lampada	X		
c. per uso diagnostico e piccola chirurgia	X		
d. durata elevata della lampade/moduli illuminanti: almeno 30.000 h di funzionamento	X		
a. intensità luminosa centrale massima non inferiore a 55.000 lux e preferibilmente fino a 100.000 lux;	X		
b. tastierino su corpo lampada per accensione/spegnimento e regolazione dell'intensità di luce;	X		
c. preferibile la possibilità di regolazione del fuoco, da manipolo o da tastierino su corpo lampada	X		
d. dimensione del campo luminoso (D10) non inferiore a 12 cm			Non si evincono dalla documentazione i valori di D10 e di D50, da esplicitare (quesito n. 1)
e. profondità di campo L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm;	X		
Facilmente sanificabile	X		
Ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento	X		
Caratteristiche illuminotecniche			

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 2 – N. 18 Lampade Ambulatoriali Carrellate - MARTIN ITALIA S.r.l
Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note	
Caratteristiche generali	a. basata su tecnologia a led, in grado di garantire elevate prestazioni illuminotecniche e di consentire ridotta emissione di calore;	X		
	b. struttura a stativo su ruote, articolata, in grado di consentire ampia movimentazione e manovrabilità. La struttura dovrà garantire stabilità in ogni posizione possibile della lampada	X		
	c. per uso diagnostico e piccola chirurgia	X		
	d. durata elevata della lampade/moduli illuminanti: almeno 30.000 h di funzionamento	X		
	a. intensità luminosa centrale massima non inferiore a 55.000 lux e preferibilmente fino a 100.000 lux;	X		
Caratteristiche illuminotecniche	b. tastierino su corpo lampada per accensione/spengimento e regolazione dell'intensità di luce;	X		
	c. preferibile la possibilità di regolazione del fuoco, da manipolo o da tastierino su corpo lampada		X L'assenza di tale requisito non costituisce motivo di in quanto esclusione richiesto "preferibilmente"	
	d. dimensione del campo luminoso (D10) non inferiore a 12 cm	X		
	e. profondità di campo L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm;	X		
	Facilmente sanificabile	X		
	X		Ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento	

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialtiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 3 – N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.

Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Caratteristiche generali			
a. basata su tecnologia a LED, in grado di garantire elevate prestazioni illuminotecniche per ottenere il massimo effetto illuminante in tutte le condizioni di lavoro	X		
b. struttura con 1 corpo lampada, dotata di quanto necessario (e.g. piastre, contropiastre) per l'installazione a soffitto o a parete	X		
c. adatta all'uso per la chirurgia minore	X		
d. struttura articolata, in grado di consentire ampia movimentazione e manovrabilità	X		
e. durata elevata delle lampade/moduli illuminanti: almeno 30.000 h di funzionamento e preferibilmente superiore	X		
a. ridotta emissione di calore e basso aumento temperatura in zona testa	X		
b. intensità luminosa centrale massima non inferiore a 80.000 lux e preferibilmente fino a 130.000 lux	X		
c. dimensione del campo luminoso (D10) non inferiore a 15 cm	X		
d. preferibile la possibilità di variare il diametro del campo	X		
e. profondità di campo L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm e preferibilmente di 120 cm o superiore	X		
f. tastierino su corpo lampada per almeno: accensione/spengimento e regolazione dell'intensità di luce	X		
g. preferibile la possibilità di regolazione del fuoco, da manipolo o da tastierino su corpo lampada	X		
h. preferibile la possibilità di regolare la temperatura di colore		X	L'assenza di tale requisito non costituisce motivo di in quanto esclusione richiesto "preferibilmente"
Caratteristiche illuminotecniche			
facilmente sanificabile	X		

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Lotto N. 3 – N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso - HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.

Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento			Chiarire se la fornitura include due manipoli sterilizzabili per ogni corpo lampada come richiesto negli atti di gara – (quesito n. 1)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Lotto N. 3 – N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso - F.A.S.E. Srl
Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Caratteristiche generali			
a. basata su tecnologia a LED, in grado di garantire elevate prestazioni illuminotecniche per ottenere il massimo effetto illuminante in tutte le condizioni di lavoro	X		
b. struttura con 1 corpo lampada, dotata di quanto necessario (e.g. piastre, contropiastre) per l'installazione a soffitto o a parete	X		
c. adatta all'uso per la chirurgia minore	X		
d. struttura articolata, in grado di consentire ampia movimentazione e manovrabilità	X		
e. durata elevata delle lampade/moduli illuminanti: almeno 30.000 h di funzionamento e preferibilmente superiore	X		
a. ridotta emissione di calore e basso aumento temperatura in zona testa	X		
b. intensità luminosa centrale massima non inferiore a 80.000 lux e preferibilmente fino a 130.000 lux	X		
c. dimensione del campo luminoso (D10) non inferiore a 15 cm	X		
d. preferibile la possibilità di variare il diametro del campo	X		
e. profondità di campo L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm e preferibilmente di 120 cm o superiore	X		
f. tastierino su corpo lampada per almeno: accensione/spengimento e regolazione dell'intensità di luce	X		
g. preferibile la possibilità di regolazione del fuoco, da manipoło o da tastierino su corpo lampada	X		
h. preferibile la possibilità di regolare la temperatura di colore	X		
facilmente sanificabile	X		
ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipołi sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento	X		

Lotto N. 3 - N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso - MARTIN ITALIA S.r.l
Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
Caratteristiche generali			
a. basata su tecnologia a LED, in grado di garantire elevate prestazioni illuminotecniche per ottenere il massimo effetto illuminante in tutte le condizioni di lavoro	X		
b. struttura con 1 corpo lampada, dotata di quanto necessario (e.g. piastre, contropiastre) per l'installazione a soffitto o a parete	X		
c. adatta all'uso per la chirurgia minore	X		
d. struttura articolata, in grado di consentire ampia movimentazione e manovrabilità	X		
e. durata elevata delle lampade/moduli illuminanti: almeno 30.000 h di funzionamento e preferibilmente superiore	X		
a. ridotta emissione di calore e basso aumento temperatura in zona testa	X		
b. intensità luminosa centrale massima non inferiore a 80.000 lux e preferibilmente fino a 130.000 lux	X		
c. dimensione del campo luminoso (D10) non inferiore a 15 cm	X		
d. preferibile la possibilità di variare il diametro del campo	X		
e. profondità di campo L1 + L2 al 20% non inferiore ai 100 cm e preferibilmente di 120 cm o superiore	X		
f. tastierino su corpo lampada per almeno: accensione/spengimento e regolazione dell'intensità di luce	X		
g. preferibile la possibilità di regolazione del fuoco, da manipolo o da tastierino su corpo lampada	X		
h. preferibile la possibilità di regolare la temperatura di colore	X		
facilmente sanificabile	X		
Caratteristiche illuminotecniche			

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Lotto N. 3 – N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso - MARTIN ITALIA S.r.l

Caratteristiche della fornitura

	SI	NO	Note
ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento			Chiarire se la fornitura include due manipoli sterilizzabili per ogni corpo lampada come richiesto negli atti di gara – (questo n. 1)

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Verbale n. 8 del 21 giugno 2019 della Commissione Giudicatrice

Sessione dimostrativa (DEMO) Lotto n. 1

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno ventuno del mese di giugno, alle ore 11:04 presso il Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie, sito in Contrada Cattedra Ambulante a Matera, si è tenuta, come previsto al paragrafo 21 del Disciplinare di gara la sessione dimostrativa (DEMO) relativa alle offerte del Lotto n. 1 della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera - ID gara SIMOG n. 7156389", giusta convocazione dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto aggregatore della SUA-RB n. 95773/20AB del 05/06/2019, alla presenza della Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

Sono altresì presenti per conto dei concorrenti partecipanti al Lotto n. 1:

Rappresentante	Concorrente
Edoardo Coletti	TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
Marco Di Vittorio	TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
Emanuele Contemi	TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
Daniela Capetti	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
Alessandro Loglisci	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
Marco Usardi	MARTIN ITALIA S.r.l
Fabrizio Garufi	MARTIN ITALIA S.r.l

Vista la nota della Commissione giudicatrice n.73881/20A2 del 02/05/2019, agli atti, con la quale la stessa ha posto, in esito all'attività di verifica dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato di gara, dei quesiti in merito ad alcuni elementi dell'offerta non chiaramente evincibili dalla documentazione prodotta.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Vista la nota dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 83880/20AB del 17/05/2019, agli atti, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato che tali aspetti possono trovare compiuta definizione nel corso delle sessioni dimostrative previste dal paragrafo 21 del Disciplinare di gara.

Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito all'art.21 del Disciplinare di gara, nel corso della DEMO è stato chiesto ai concorrenti, seguendo l'ordine di arrivo delle offerte, di illustrare le funzionalità dei sistemi offerti, in modo da poter verificare:

- a. Rispondenza ai requisiti minimi richiesti;
- b. Performance dei sistemi offerti, correlandole in particolare agli elementi di valutazione, al fine di consentire alla commissione giudicatrice una valutazione esaustiva ed oggettiva rispetto alle caratteristiche esemplificate nella griglia di valutazione.

TRUMPF MED ITALIA S.r.l

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, con particolare riguardo a quelli necessitanti di chiarimenti, giusta verbale n. 7 del 30.04.2019, indicati nella tabella sottostante:

Caratteristiche della fornitura		SI	NO	NOTE
Videocamera	Distanza ottimale di visualizzazione/focalizzazione (range)	X		Non necessaria in quanto dotata di sistema di focalizzazione automatica (autofocus).
Videocamera	Possibilità di trasmettere il segnale sia HD che SD a monitor e al sistema di registrazione	X		Sistema capace di gestire il segnale sia in HD che SD.
Monitor	Movibile tramite impugnatura sterilizzabile	X		Il manipolo sia della telecamera che della lampada scialitica è sterilizzabile
Accessori	Ogni corpo lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili	X		La fornitura standard comprende un set di 3 ricambi completi.

Conclusa positivamente la suddetta fase di verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.1, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione, dichiara, alle ore 11:50, conclusa la fase dimostrativa per l'offerente Trumpf Med Italia S.r.l.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, con particolare riguardo a quelli necessitanti di chiarimenti, giusta verbale n. 7 del 30.04.2019, indicati nella tabella sottostante:

Caratteristiche della fornitura		SI	NO	NOTE
Caratteristiche illuminotecniche	Possibilità di variare il diametro del campo, mantenendo la stessa intensità luminosa del punto centrale	X		E' possibile variare il diametro del campo luminoso mantenendo la stessa intensità luminosa del punto centrale
Videocamera	Distanza ottimale di visualizzazione/focalizzazione (range)	X		Non necessaria in quanto dotata di sistema di focalizzazione automatica (autofocus).
Monitor	Movibile tramite impugnatura sterilizzabile	X		L'operatore economico dichiara che il monitor ha la stessa impugnatura della lampada e quindi ha un manipolo.
Accessori	Ogni corpo lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili	X		E' confermata la dotazione di n. 2 manipoli.

Conclusa positivamente la suddetta fase di verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.1, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione, dichiara, alle ore 12:33, conclusa la fase dimostrativa per l'offerente Hospital Scientific Consulting S.r.l.

MARTIN ITALIA S.r.l

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, con particolare a quelli necessitanti di chiarimenti, giusta verbale n. 7 del 30.04.2019, indicati nella tabella sottostante:

Caratteristiche della fornitura		SI	NO	NOTE
Caratteristiche illuminotecniche	Possibilità di variare il diametro del campo, mantenendo la stessa intensità luminosa del punto centrale	X		Al variare del diametro, l'intensità luminosa sul punto centrale rimane costante
Videocamera	Distanza ottimale di visualizzazione/focalizzazione (range)	X		Non necessaria in quanto dotata di sistema di focalizzazione automatica (autofocus).

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Videocamera	Possibilità di trasmettere il segnale sia HD che SD a monitor e al sistema di registrazione	X		Sistema capace di gestire il segnale sia in HD che SD.
Monitor	Movibile tramite impugnatura sterilizzabile	X		L'impugnatura del monitor è sterilizzabile.
Accessori	Ogni corpo lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili	X		I manipoli offerti sono pari al numero richiesto.

Conclusa positivamente la suddetta fase di verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richieste, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.1, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione, dichiara, alle ore 13:35, conclusa la fase dimostrativa per l'offerente Hospital Scientific Consulting S.r.l.

Alle ore 13:38 la Commissione giudicatrice, esaurite le operazioni odierne dichiara chiusa la sessione dimostrativa relativa al Lotto n. 1, autoconvocandosi per il giorno 5 luglio 2019 presso il medesimo Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie in occasione delle sessioni dimostrative programmate per i lotti n. 2 e n.3.


Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente

ing. Giuseppe SPERA – Componente

dott. Rocco CARBONELLA – Componente

dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario

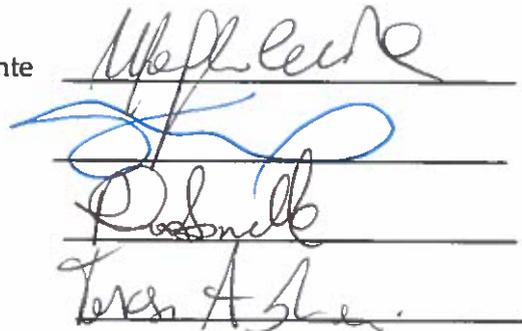

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Verbale n. 9 del 05 luglio 2019 della Commissione Giudicatrice

Sessione dimostrativa (DEMO) Lotti n. 2 e 3

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno cinque del mese di luglio, alle ore 10:50 presso il Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie, sito in Contrada Cattedra Ambulante a Matera, si è tenuta, come previsto al paragrafo 21 del Disciplinare di gara la sessione dimostrativa (DEMO) relativa alle offerte dei Lotti n. 2 e n. 3 della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera - ID gara SIMOG n. 7156389", giusta convocazione dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto aggregatore della SUA-RB n.103217/20AB del 18/06/2019, alla presenza della Commissione giudicatrice nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

Sono altresì presenti per conto dei concorrenti partecipanti ai Lotti n. 2 e n. 3:

Rappresentante	Concorrente
Marco Usardi	MARTIN ITALIA S.r.l
Vincenzo Braia	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
Nicola Cantatore	FASE S.r.l.

Vista la nota della Commissione giudicatrice n.73881/20A2 del 02/05/2019, agli atti, con la quale la stessa ha posto, in esito all'attività di verifica dei requisiti minimi richiesti dal Capitolato di gara, dei quesiti in merito ad alcuni elementi dell'offerta non chiaramente evincibili dalla documentazione prodotta.

Vista la nota dell'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore n. 83880/20AB del 17/05/2019, agli atti, con la quale il Responsabile del Procedimento ha comunicato che tali aspetti possono trovare compiuta definizione nel corso delle sessioni dimostrative previste dal paragrafo 21 del Disciplinare di gara.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Tutto ciò premesso, ai sensi di quanto stabilito all'art.21 del Disciplinare di gara, nel corso della DEMO è stato chiesto ai concorrenti di illustrare le funzionalità dei sistemi offerti, in modo da poter verificare:

- a. Rispondenza ai requisiti minimi richiesti;
- b. Performance dei sistemi offerti, correlandole in particolare agli elementi di valutazione, al fine di consentire alla commissione giudicatrice una valutazione esaustiva ed oggettiva rispetto alle caratteristiche esemplificate nella griglia di valutazione.

Su richiesta dell'offerente Martin Italia S.r.l., con l'assenso degli altri operatori economici concorrenti, la Commissione giudicatrice accorda allo stesso la possibilità di poter anticipare la propria sessione dimostrativa per esigenze logistiche collegate al rientro in sede del personale tecnico. Per i restanti operatori economici è stato seguito, come previsto, l'ordine di arrivo delle offerte.

MARTIN ITALIA S.r.l

Lotto n. 2 - N. 18 Lampade Ambulatoriali Carrellate

Non sussistendo quesiti specifici relativi alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.2, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione, ritiene conclusa la fase dimostrativa relativa al prodotto offerto per il Lotto n. 2.

Lotto n. 3 - N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, con particolare riguardo a quello necessitante di chiarimento, giusta verbale n. 7 del 30.04.2019, indicato nella tabella sottostante:

Caratteristiche della fornitura	SI	NO	NOTE
ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento	X		I manipoli offerti sono pari al numero richiesto

Conclusa positivamente la suddetta fase di verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richieste, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.3, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione per il lotto n. 3, dichiara, alle ore 11:11, conclusa la fase dimostrativa per l'offerente Martin Italia Italia S.r.l.

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.

Lotto n. 2 - N. 18 Lampade Ambulatoriali Carrellate

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, con particolare riguardo a quello necessitante di chiarimento, giusta verbale n. 7 del 30.04.2019, indicato nella tabella sottostante:

Caratteristiche della fornitura	SI	NO	NOTE
ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento	X		Nella scheda tecnica i manipoli sono previsti come opzionali, su dichiarazione dell'operatore economico gli stessi sono stati previsti e quotati nell'offerta economica.

Conclusa positivamente la suddetta fase di verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richieste, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.2, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione, ritiene conclusa la fase dimostrativa relativa al prodotto offerto per il Lotto n. 2.

Lotto n. 3 - N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, con particolare riguardo a quello necessitante di chiarimento, giusta verbale n. 7 del 30.04.2019, indicato nella tabella sottostante:

Caratteristiche della fornitura	SI	NO	NOTE
ogni lampada deve essere dotata di n. 2 manipoli sterilizzabili e di tutti gli accessori necessari per garantire la corretta e sicura installazione ed il corretto, sicuro ed immediato funzionamento	X		Il modello presentato in DEMO ha il manipolo fisso, su dichiarazione dell'operatore economico i manipoli offerti, nel numero richiesto, sono del tipo sterilizzabile.

Conclusa positivamente la suddetta fase di verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richieste, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.3, una illustrazione delle caratteristiche del prodotto offerto.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Il modello di lampada presentato in demo, del tipo uguale a quello offerto, è stato montato su stativo e non sui bracci previsti per questo tipo di lampada, pertanto la Commissione giudicatrice non ha potuto apprezzare alcune delle caratteristiche oggetto di valutazione, con particolare riferimento ai criteri di valutazione n. 1, per quanto concerne le caratteristiche della struttura portante, e n. 4 riguardante ergonomia e maneggevolezza per i quali si farà esclusivo riferimento alla documentazione tecnica prodotta in busta B.

La Commissione giudicatrice terminata la dimostrazione da parte dell'operatore economico, dichiara, alle ore 11:25 conclusa la fase dimostrativa relativa al prodotto offerto per il Lotto n. 3.

F.A.S.E. S.r.l.

Lotto n. 2 - N. 18 Lampade Ambulatoriali Carrellate

La Commissione procede, preliminarmente, alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, con particolare riguardo a quello necessitante di chiarimento, giusta verbale n. 7 del 30.04.2019, indicato nella tabella sottostante:

Caratteristiche della fornitura		SI	NO	NOTE
Caratteristiche illuminotecniche	dimensione del campo luminoso (D10) non inferiore a 12 cm	X		Il dato richiesto, indicato nella scheda tecnica, è meglio specificato nel Manuale d'uso del modello offerto.

Conclusa positivamente la suddetta fase di verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.2, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione, ritiene conclusa la fase dimostrativa relativa al prodotto offerto per il Lotto n. 2

Lotto n. 3 - N. 9 Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso

Non sussistendo quesiti specifici relativi alla verifica della rispondenza del prodotto offerto ai requisiti minimi richiesti, l'operatore economico effettua, con riferimento alla griglia di valutazione dell'offerta tecnica del Lotto n.3, una illustrazione completa delle caratteristiche del prodotto offerto.

La Commissione giudicatrice ritenendo esaustiva la dimostrazione, ritiene conclusa la fase dimostrativa relativa al prodotto offerto per il Lotto n. 3

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Alle ore 12:06 la Commissione giudicatrice, esaurite le operazioni odierne dichiara chiusa la sessione dimostrativa relativa ai Lotti n. 2 e n. 3, autoconvocandosi per il giorno 9 luglio 2019 presso la SUA-RB alle ore 15:30.


Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA - Presidente

ing. Giuseppe SPERA - Componente

dott. Rocco CARBONELLA - Componente

dott.ssa Teresa ANDRIANI - Segretario

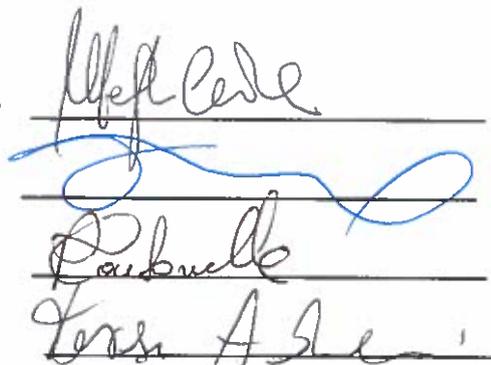

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the names listed to the left: Maria Gelsomina Lauletta, Giuseppe Spera, Rocco Carbonella, and Teresa Andriani.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Verbale n.10 del 09 luglio 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 16:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

Terminate le sessioni dimostrative effettuate ai sensi dell'art. 21 del disciplinare di gara, la Commissione procede, quindi, alla disamina delle offerte tecniche finalizzata all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

Prima di procedere all'assegnazione dei punteggi, la Commissione, all'unanimità, decide di attribuire un numero ad ogni commissario. Il risultato degli abbinamenti sarà inserito, unitamente alle schede di valutazione, in busta sigillata da consegnare al Responsabile del Procedimento.

La Commissione giudicatrice, quindi, prende in esame il **Lotto n. 1**, per il quale hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:

- TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
- HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
- MARTIN ITALIA S.r.l

Si procede, quindi, collegialmente ad un'attenta attività di analisi della documentazione tecnica che compone le offerte tecniche degli operatori economici partecipanti alla luce dei criteri di valutazione. Ciascun commissario, individualmente, annota su un brogliaccio, non costituente documento ufficiale, gli elementi di rilievo emersi nel corso dei lavori svolti.


COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"


La Commissione giudicatrice, alle ore 19:10, sospende le attività della seduta odierna autoconvocandosi per la prosecuzione delle stesse per il giorno 17 luglio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente

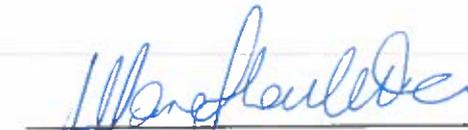

ing. Giuseppe SPERA – Componente



dott. Rocco CARBONELLA – Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario



Verbale n.11 del 17 luglio 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADIE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 15:44, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

In prosecuzione delle attività svolte nella seduta precedente del 09 luglio 2019, la Commissione procede con l'attività di disamina delle offerte tecniche relative al Lotto n. 1 finalizzata all'assegnazione dei punteggi secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.

La Commissione giudicatrice assegna, per ciascuna offerta, il punteggio relativo all'unico elemento di valutazione tabellare (T) dell'offerta tecnica (criterio di valutazione n. 4).

Terminata tale attività, ogni commissario procede quindi, individualmente, all'attribuzione dei coefficienti relativi a ciascun criterio qualitativo riportandoli su una scheda all'uopo predisposta. I valori riportati nelle schede cartacee compilate da ogni singolo componente della Commissione giudicatrice, agli atti, vengono trasferiti per essere elaborati su apposito foglio elettronico, di cui agli allegati n. 1 e n.2 del presente verbale, per il calcolo dei relativi punteggi e, se il caso, delle relative riparametrazioni.

Esaurite le attività della seduta odierna, la Commissione, alle ore 19:05, dichiara la seduta conclusa autoconvocandosi per la prosecuzione dei lavori per il giorno 23 luglio 2019 alle ore 15:30.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente

ing. Giuseppe SPERA – Componente

COMMISSIONE GIUDICATRICE


"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

dott. Rocco CARBONELLA - Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI - Segretario



COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

ALLEGATO N.1
 LOTTO N.1 - Lampade Scialitliche per sala operatoria

N	Criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max	Coefficienti Giudizio	Coefficiente Commissario n.1	Coefficiente Commissario n.2	Coefficiente Commissario n.3	Media Coefficienti
1	Caratteristiche generali e costruttive (struttura, dimensioni corpi lampade, n° moduli illuminanti/LED, durata lampade, design che consenta di creare unico pannello luminoso, altre peculiarità costruttive)	14		1 E 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,7	0,9	0,9	0,833
2	Ampiezza e facilità della movimentazione (snodi, ampiezza movimenti, freni/stabilità della posizione)	3		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,9	0,9	1	0,933
3	Caratteristiche illuminotecniche (intensità luminosa e regolazione, regolazione temperatura di colore, indici di resa cromatica, ampiezza campo luminoso e regolazione, profondità di campo e range distanza operativa, efficienza luminosa, energia irradiata ed aumento temperatura in zona testa)	20		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,9	1	0,9	0,933
4	Funzione luce endoscopica		2	1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV				
5	Comandi (comandi a su corpo lampada, comandi attivabili da manipolo, altri dispositivi di comando offerti e relative funzioni)	5		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,8	0,8	0,7	0,767
6	Altre funzionalità/peculiarità (es: sincronizzazione corpi lampada, auto regolazione fuoco, sistemi gestione automatica illuminamento, etc.)	10		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,9	1	1	0,967
7	Videocamera (caratteristiche e funzionalità)	4		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,8	0,9	0,7	0,800
8	Monitor (caratteristiche e funzionalità)	3		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,9	0,9	0,8	0,867
9	Sistema di registrazione (caratteristiche e funzionalità)	4		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,6	0,6	0,6	0,600
10	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio	5		1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV 1 E 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0 NV	0,7	0,7	0,7	0,700
			70					

TRMPF MED ITALIA S.r.l. - Plico n. 1

ALLEGATO N. 1
 LOTTON. 1 - Lampade Scialitliche per sala operatoria

N	Criteri di valutazione	Punti D	Punti T	Coefficien Giudizio	Coefficiente	Coefficiente	Coefficiente	Media						
									1	0,9	O	0,8	B	0,7
1	Caratteristiche generali e costruttive (struttura, dimensioni corpi lampade, n° moduli illuminanti/LED, durata lampade, design che consenta di creare unico pannello luminoso, altre peculiarità costruttive)	14			0,9	0,9	1	0,933						
2	Ampiezza e facilità della movimentazione (snodi, ampiezza movimenti, freni/stabilità della posizione)	3			1	1	1	1,000						
3	Caratteristiche illuminotecniche (intensità luminosa e regolazione, regolazione temperatura di colore, indici di resa cromatica, ampiezza campo luminoso e regolazione, profondità di campo e range distanza operativa, efficienza luminosa, energia irradiata ed aumento temperatura in zona testa)	20			0,9	0,9	1	0,933						
4	Funzione luce endoscopica	2			1	1								
5	Comandi (comandi a su corpo lampada, comandi attivabili da manipolo, altri dispositivi di comando offerti e relative funzioni)	5			1	1	1	1,000						
6	Altre funzionalità/peculiarità (es: sincronizzazione corpi lampada, auto regolazione fuoco, sistemi gestione automatica illuminamento, etc.)	10			0,7	0,7	0,7	0,700						
7	Videocamera (caratteristiche e funzionalità)	4			1	1	1	0,967						
8	Monitor (caratteristiche e funzionalità)	3			0,8	0,8	0,7	0,767						
9	Sistema di registrazione (caratteristiche e funzionalità)	4			0,6	0,6	0,7	0,633						
10	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio	5			1	1	1	1,000						
								70						

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l. - Plico n. 3

N	Criteri di valutazione	Punti D	Punti I	Coefficien	Cuidio	Coefficiente			Media	
						Coefficiente	Coefficiente	Coefficiente		
1	Caratteristiche generali e costruttive (struttura, dimensioni corpi lampade, n° moduli illuminanti/LED, durata lampade, design che consenta di creare unico pannello luminoso, altre peculiarità costruttive)	14				0,9 D 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	0,8	0,8	0,8	0,800
2	Ampiezza e facilità della movimentazione (snodi, ampiezza movimenti, freni/stabilità della posizione)	3				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	0,8	0,8	0,8	0,800
3	Caratteristiche ibuminotecniche (intensità luminosa e regolazione, regolazione temperatura di colore, indici di resa cromatica, ampiezza campo luminoso e regolazione, profondità di campo e range distanza operativa, efficienza luminosa, energia irradiata ed aumento temperatura in zona testa)	20				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	0,8	0,8	0,8	0,800
4	Funzione luce endoscopica	2				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV				
5	Comandi (comandi a su corpo lampada, comandi attivabili da manipolo, altri dispositivi di comando offerti e relative funzioni)	5				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	0,9	0,8	0,9	0,867
6	Altre funzionalità/peculiarità (es: sincronizzazione corpi lampada, auto regolazione fuoco, sistemi gestione automatica illuminamento, etc.)	10				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	0,9	0,7	0,7	0,767
7	Videocamera (caratteristiche e funzionalità)	4				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	0,7	0,7	0,6	0,667
8	Monitor (caratteristiche e funzionalità)	3				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	1	1	1	1,000
9	Sistema di registrazione (caratteristiche e funzionalità)	4				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	1	1	1	1,000
10	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio	5				0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV 1 E 0,9 O 0,8 B 0,7 D 0,6 S 0,5 M 0,3 SC 0 NV	0,6	0,5	0,5	0,533
		70								

ALLEGATO N. 2

LOTTO N. 1 - Lampade scialitiche per sala operatoria

Valutazione Qualitativa		Media coefficienti commissari					Coefficienti I riparazione					Punteggi I Riparametrazione				
Criteria di valutazione	Punti D max	Plico n. 1	Plico n. 3	Plico n. 5	Plico n. 1	Plico n. 3	Plico n. 5	Plico n. 1	Plico n. 3	Plico n. 5	Plico n. 1	Plico n. 3	Plico n. 5	Plico n. 1	Plico n. 3	Plico n. 5
1	14	0,833	0,933	0,800	0,893	1,000	0,857	0,893	1,000	0,857	12,500	14,000	12,000	12,500	14,000	12,000
2	3	0,933	1,000	0,800	0,933	1,000	0,800	0,933	1,000	0,800	2,800	3,000	2,400	2,800	3,000	2,400
3	20	0,933	0,933	0,800	1,000	1,000	0,857	1,000	1,000	0,857	20,000	20,000	17,143	20,000	20,000	17,143
5	5	0,767	1,000	0,867	0,767	1,000	0,867	0,767	1,000	0,867	3,833	5,000	4,333	3,833	5,000	4,333
6	10	0,967	0,700	0,767	1,000	0,724	0,793	1,000	0,724	0,793	10,000	7,241	7,931	10,000	7,241	7,931
7	4	0,800	0,967	0,667	0,828	1,000	0,690	0,828	1,000	0,690	3,310	4,000	2,759	3,310	4,000	2,759
8	3	0,867	0,767	1,000	0,867	0,767	1,000	0,867	0,767	1,000	2,600	2,300	3,000	2,600	2,300	3,000
9	4	0,600	0,633	1,000	0,600	0,633	1,000	0,600	0,633	1,000	2,400	2,533	4,000	2,400	2,533	4,000
10	5	0,700	1,000	0,533	0,700	1,000	0,533	0,700	1,000	0,533	3,500	5,000	2,667	3,500	5,000	2,667
TOTALE D	68										60,944	63,075	56,233	60,944	63,075	56,233
4	2										2	2	2	2	2	2
TOTALE (D+T)	70										62,944	65,075	58,233	62,944	65,075	58,233

	Plico n.1	Plico n. 3	Plico n. 5
PUNTEGGIO I RIPARAMETRAZIONE	62,944	65,075	58,233
SOGLIA DI SBARRAMENTO	42		
PUNTEGGIO II RIPARAMETRAZIONE	67,708	70,000	62,640

Verbale n.12 del 23 luglio 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADIE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA –N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno ventitrè del mese di luglio, alle ore 16:00, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

Risultando assente il Segretario dott. Teresa Andriani, titolare di funzioni di supporto alla commissione che non concorrono alla formazione dei giudizi tecnico-amministrativi propri della Commissione, l'attività di verbalizzazione viene assunta dal Presidente che dichiara aperta la seduta.

In prosecuzione delle attività svolte nella seduta precedente del 17 luglio 2019, la Commissione giudicatrice prende, quindi, in esame il Lotto n. 3, per il quale hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:

- HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
- F.A.S.E. S.r.l.
- MARTIN ITALIA S.r.l.

Si procede, quindi, collegialmente ad un'attenta attività di analisi della documentazione tecnica che compone le offerte tecniche degli operatori economici partecipanti alla luce delle caratteristiche della fornitura richiesta e dei criteri di valutazione. Ciascun commissario, individualmente, annota su un brogliaccio, non costituente documento ufficiale, gli elementi di rilievo emersi nel corso dei lavori svolti.

Terminata tale attività, ogni commissario procede quindi, individualmente, all'attribuzione dei coefficienti relativi a ciascun criterio qualitativo riportandoli su una scheda all'uopo predisposta.

I valori riportati nelle schede cartacee compilate da ogni singolo componente della Commissione giudicatrice, agli atti, vengono trasferiti per essere elaborati su apposito foglio elettronico, di cui

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

agli allegati n. 1 e n.2 del presente verbale, per il calcolo dei relativi punteggi e, se il caso, delle relative riparametrazioni.

Esaurite le attività della seduta odierna, la Commissione alle ore 19:00, dichiara la stessa chiusa fissando per il giorno 27 agosto 2019 la seduta riservata per la prosecuzione delle attività.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente

ing. Giuseppe SPERA – Componente

dott. Rocco CARBONELLA – Componente

LOTTO N. 3 - Lampade Scialitiche ambulatoriali di tipo fisso

N	Criteri di valutazione	Punti D max	Coefficienti		Giudizio	Coefficiente Commissario n.1	Coefficiente Commissario n.2	Coefficiente Commissario n.3	Media Coefficienti
			1	2					
1	Caratteristiche generali costruttive (caratteristiche corpo lampada, n° moduli illuminanti/lampade, caratteristiche struttura portante, durata lampade, altre peculiarità)	18	0.9	D	E	0.8	0.9	0.9	0.866666667
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
2	Caratteristiche illuminotecniche (intensità luminosa, regolazioni possibili, ampiezza del campo, profondità di campo/distanza operativa, efficienza luminosa, energia irradiata, emissione calore, indice resa cromatica, altre caratteristiche)	25	0.7	D	E	0.7	0.8	0.6	0.7
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
3	Focalizzazione, regolazione temperatura di colore, regolazione del diametro del campo	12	0.6	S	E	0.7	0.7	0.6	0.666666667
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
4	Ergonomia e maneggevolezza (comandi/indicatori disponibili, capacità/ampiezza di movimentazione, freni/stabilità della posizione)	10	0.9	D	E	0.7	0.8	0.6	0.7
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
5	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica")	5	0.9	O	E	1	0.9	1	0.966666667
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. - Plico n. 3

N	Criteri di valutazione	Punti D max	Coefficienti		Giudizio	Coefficiente Commissario n.1	Coefficiente Commissario n.2	Coefficiente Commissario n.3	Media Coefficienti
			1	2					
1	Caratteristiche generali costruttive (caratteristiche corpo lampada, n° moduli illuminanti/lampade, caratteristiche struttura portante, durata lampade, altre peculiarità)	18	0.9	E	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
			0	O					
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
2	Caratteristiche illuminotecniche (intensità luminosa, regolazioni possibili, ampiezza del campo, profondità di campo/distanza operativa, efficienza luminosa, energia irradiata, emissione calore, indice resa cromatica, altre caratteristiche)	25	0.8	B	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
			0.7	D					
3	Focalizzazione, regolazione temperatura di colore, regolazione del diametro del campo	12	0.9	O	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
4	Ergonomia e maneggevolezza (comandi/indicatori disponibili, capacità/ampiezza di movimentazione, freni/stabilità della posizione)	10	0.9	O	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
5	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica")	5	0.9	O	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
			0.8	B					
			0.7	D					
			0.6	S					
			0.5	M					
			0.3	SC					
			0	NV					
			1	E					
			0.9	O					
			0.8	B					
F.A.S.E. S.r.l. - Plico n. 4									
70									

N	Criteri di valutazione	Punt D max	Coefficien ti	Giudizio	Coefficiente Commissario n.1	Coefficiente Commissario n.2	Coefficiente Commissario n.3	Media Coefficienti
1	Caratteristiche generali costruttive (caratteristiche corpo lampada, n° moduli illuminanti/lampade, caratteristiche struttura portante, durata lampade, altre peculiarità)	18	1	E	1	1	1	1
			0,9	O				
			0,8	B				
			0,7	D				
			0,6	S				
			0,5	M				
			0,3	SC				
			0	NV				
			1	E				
			0,9	O				
2	Caratteristiche illuminotecniche (intensità luminosa, regolazioni possibili, ampiezza del campo, profondità di campo/distanza operativa, efficienza luminosa, energia irradiata, emissione calore, indice resa cromatica, altre caratteristiche)	25	0,8	B	1	1	1	1
			0,7	D				
			0,6	S				
			0,5	M				
			0,3	SC				
			0	NV				
			1	E				
			0,9	O				
			0,8	B				
			0,7	D				
3	Focalizzazione, regolazione temperatura di colore, regolazione del diametro del campo	12	0,6	S	1	1	1	1
			0,5	M				
			0,3	SC				
			0	NV				
			1	E				
			0,9	O				
			0,8	B				
			0,7	D				
			0,6	S				
			0,5	M				
4	Ergonomia e maneggevolezza (comandi/indicatori disponibili, capacità/ampiezza di movimentazione, freni/stabilità della posizione)	10	0,3	SC	1	1	1	1
			0	NV				
			1	E				
			0,9	O				
			0,8	B				
			0,7	D				
			0,6	S				
			0,5	M				
			0,3	SC				
			0	NV				
5	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica")	5	0,9	O	0,9	1	1	0,966666667
			0,8	B				
			0,7	D				
			0,6	S				
			0,5	M				
			0,3	SC				
			0	NV				
			1	E				
			0,9	O				
			0,8	B				
70								

MARTIN ITALIA S.r.l. - Plico n. 5

LOTTO N. 2 - Lampade Scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato

Valutazione Qualitativa Lotto n. 2		Media coefficienti commissari					Coefficienti def. I riparametrazione					Punteggi definitivi				
Criteria di valutazione	Punti D max	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5
1	20	0,87	0,80	0,93	0,93	0,86	1,00	0,93	0,86	1,00	18,57	17,14	20,00	18,57	17,14	20,00
2	28	0,70	0,97	0,80	0,72	1,00	0,83	0,72	1,00	0,83	20,28	28,00	23,17	20,28	28,00	23,17
4	12	0,77	0,93	0,77	0,82	1,00	0,82	0,82	1,00	0,82	9,86	12,00	9,86	9,86	12,00	9,86
5	5	0,97	0,87	0,70	1,00	0,90	0,72	1,00	0,90	0,72	5,00	4,48	3,62	5,00	4,48	3,62
TOTALE D	65										53,70	61,63	56,65	53,70	61,63	56,65
3	5										0	5	0	0	5	0
TOTALE (D+T)	70										53,70	66,63	56,65	53,70	66,63	56,65

	Plico n.3	Plico n. 4	Plico n. 5
PUNTEGGIO I RIPARAMETRAZIONE	53,704	66,626	56,650
SOGLIA DI SBARRAMENTO		42	
PUNTEGGIO II RIPARAMETRAZIONE	56,424	70,000	59,519

Verbale n.13 del 27 agosto 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta riservata

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno ventisette del mese di agosto, alle ore 16:10, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera - ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

In prosecuzione delle attività svolte nella seduta precedente del 23 luglio 2019, la Commissione giudicatrice prende, quindi, in esame il **Lotto n. 2**, per il quale hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:

- HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
- F.A.S.E. S.r.l.
- MARTIN ITALIA S.r.l.

Si procede, quindi, collegialmente ad un'attenta attività di analisi della documentazione tecnica che compone le offerte tecniche degli operatori economici partecipanti alla luce delle caratteristiche della fornitura richiesta e dei criteri di valutazione. Ciascun commissario, individualmente, annota su un brogliaccio, non costituente documento ufficiale, gli elementi di rilievo emersi nel corso dei lavori svolti.

La Commissione giudicatrice assegna, per ciascuna offerta, il punteggio relativo all'unico elemento di valutazione tabellare (T) dell'offerta tecnica (criterio di valutazione n. 3).

Terminata tale attività, ogni commissario procede quindi, individualmente, all'attribuzione dei coefficienti relativi a ciascun criterio qualitativo riportandoli su una scheda all'uopo predisposta. I valori riportati nelle schede cartacee compilate da ogni singolo componente della Commissione giudicatrice, agli atti, vengono trasferiti per essere elaborati su apposito foglio elettronico, di cui agli

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

allegati n. 1 e n.2 del presente verbale, per il calcolo dei relativi punteggi e, se il caso, delle relative riparametrazioni.

Esaurite le attività della seduta odierna, la Commissione, alle ore 18:00, dichiara la stessa conclusa fissando per il giorno 5 settembre 2019 alle ore 16:00, la seduta pubblica relativa all'apertura della Busta C contenete l'offerta economica. Pertanto la Commissione giudicatrice da mandato al Responsabile del procedimento di pubblicare il relativo avviso sul portale appalti SUA-RB delegandolo ad ogni altro adempimento conseguente.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina LAULETTA - Presidente



ing. Giuseppe SPERA - Componente



dott. Rocco CARBONELLA - Componente



dott.ssa Teresa ANDRIANI - Segretario



LOTTO N. 2 - Lampade Scialtiche ambulatoriali di tipo carrellato

N	Criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max	Coefficien ti	Giudizio	Coefficiente Commissario n.1	Coefficiente Commissario n.2	Coefficiente Commissario n.3	Media Coefficienti
1	Caratteristiche generali costruttive (Caratteristiche corpo lampada, n° moduli illuminanti/lampade, caratteristiche struttura portante, durata lampade, altre peculiarità)	20		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E B D S M SC NV	0.8	0.8	1	0.866666667
2	Caratteristiche illuminotecniche (intensità luminosa, dimensioni del campo luminoso, profondità di campo/distanza di lavoro, regolazioni possibili, energia irradiata/emissione calore, indice resa cromatica, altre caratteristiche)	28		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E B D S M SC NV	0.8	0.7	0.6	0.7
3	Possibilità di focalizzazione	5		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E B D S M SC NV	0.8	0.8	0.9	0.766666667
4	Ergonomia e maneggevolezza (comandi/indicatori disponibili, capacità di movimentazione, freni/stabilità della posizione)	12		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E B D S M SC NV	0.8	0.8	0.9	0.766666667
5	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica")	5		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E B D S M SC NV	1	0.9	1	0.966666667
70									

HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L. - P.Ico n. 3

N	Criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max	Coefficien		Giudizio	Coefficiente Commissario n.1	Coefficiente Commissario n.2	Coefficiente Commissario n.3	Media Coefficienti
				il	di					
1	Caratteristiche generali costruttive (caratteristiche corpo lampada, n° moduli illuminanti/lampade, caratteristiche struttura portante, durata lampade, altre peculiarità)	20		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E D B D S M SC NV		0.7	0.7	1	0.8
2	Caratteristiche Illuminotecniche (intensità luminosa, dimensioni del campo luminoso, profondità di campo/distanza di lavoro, regolazioni possibili, energia irradiata/emissione calore, indice resa cromatica, altre caratteristiche)	28		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E D B D S M SC NV		0.9	1	1	0.966666667
3	Possibilità di focalizzazione		5			NO				
4	Ergonomia e maneggevolezza (comandi/indicatori disponibili, capacità di movimentazione, freni/stabilità della posizione)	12		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E B B D S M SC NV					0.933333333
5	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica")	5		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	E B D S M SC NV		0.8	1	1	0.866666667
70										

F.A.S.E. S.r.l. - Plico n. 4

N	Criteri di valutazione	Punti D max	Punti T max	Coefficienti		Giudizio	Coefficiente Commissario n.1	Coefficiente Commissario n.2	Coefficiente Commissario n.3	Media Coefficienti
				1	2					
1	Caratteristiche generali costruttive (caratteristiche corpo lampada, n° moduli illuminanti/lampade, caratteristiche struttura portante, durata lampade, altre peculiarità)	20		0.9 0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0	1	E O B D S M SC NV	0.9	0.9	1	0.9333333333
2	Caratteristiche illuminotecniche (intensità luminosa, dimensioni del campo luminoso, profondità di campo/distanza di lavoro, regolazioni possibili, energia irradiata/emissione calore, indice resa cromatica, altre caratteristiche)	28		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0			0.8	0.8	0.8	0.8
3	Possibilità di focalizzazione		5	1						
4	Ergonomia e maneggevolezza (comandi/indicatori disponibili, capacità di movimentazione, freni/stabilità della posizione)	12		0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0			0.6	0.8	0.9	0.7566666667
5	Servizio di assistenza tecnica (valutato secondo quanto riportato nell'allegato "Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica")	5		1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0			0.6	0.8	0.7	0.7
70										

MARTIN ITALIA S.r.l. - Plico n.5

ALLEGATO N. 2

LOTTO N. 3 - Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso

Valutazione Qualitativa		Media coefficienti commissari					Coefficienti I riparimetrazione					Punteggi I Riparimetrazione				
Criteria di valutazione	Punti D max	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5	Plico n. 3	Plico n. 4	Plico n. 5
1	18	0,867	0,800	1,000	0,867	0,800	1,000	0,867	0,800	1,000	15,600	14,400	18,000	15,600	14,400	18,000
2	25	0,700	0,833	1,000	0,700	0,833	1,000	0,700	0,833	1,000	17,500	20,833	25,000	17,500	20,833	25,000
3	12	0,667	0,800	1,000	0,667	0,800	1,000	0,667	0,800	1,000	8,000	9,600	12,000	8,000	9,600	12,000
4	10	0,700	0,833	0,967	0,724	0,862	1,000	0,724	0,862	1,000	7,241	8,621	10,000	7,241	8,621	10,000
5	5	0,967	0,867	0,700	1,000	0,897	0,724	1,000	0,897	0,724	5,000	4,483	3,621	5,000	4,483	3,621
TOTALE D	70										53,341	57,937	68,621	53,341	57,937	68,621

	Plico n.3	Plico n. 4	Plico n. 5
PUNTEGGIO I			
RIPARAMETRAZIONE	53,341	57,937	68,621
SOGLIA DI SBARRAMENTO		42	
PUNTEGGIO II			
RIPARAMETRAZIONE	54,414	59,101	70,000

Verbale n.14 del 05 settembre 2019 della Commissione Giudicatrice

Seduta pubblica

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA –N. 7156389

L'anno duemila diciannove, il giorno cinque del mese di settembre, alle ore 16:19, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta pubblica per l'apertura delle buste telematiche C, contenenti l'offerta economica, la Commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera – ID gara SIMOG n. 7156389" nominata con Determina Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito indicata:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

L'avviso della seduta pubblica odierna è stato pubblicato sul profilo del committente in data 28/08/2019. È presente il Responsabile del procedimento ing. Giuseppe Bianchini.

La Commissione giudicatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento, procede in seduta riservata per ciascun Lotto e ciascun operatore economico partecipante al caricamento dei coefficienti nel Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB raggiungibile al Link <https://www.sua-rb.it>, alla riparametrazione dei coefficienti ed al calcolo del punteggio tecnico e della relativa riparametrazione.

Alle ore 17,10 vengono inviati a partecipare alla seduta pubblica i rappresentanti degli operatori economici concorrenti di seguito riportati:

RAPPRESENTANTE	OPERATORE ECONOMICO
Vincenzo Braia	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
Giovanni Spagnoletta	F.A.S.E. Srl
Francesco Pesari	TRUMPF MED ITALIA S.r.l.
Daniele de Giovanni	MARTIN ITALIA S.r.l

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

La Commissione giudicatrice da lettura, per ciascun lotto in gara, dei punteggi relativi alle offerte tecniche, come da prospetti seguenti:

LOTTO N. 1	PLICO N.1 TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L.
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	67,708	70,000	62,640

LOTTO N.2	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N: 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	56,424	70,000	59,519

LOTTO N. 3	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA	54,414	59,101	70,000

Successivamente la Commissione giudicatrice, per il tramite del Responsabile del procedimento ed attraverso il Portale della piattaforma di E-procurement della SUA-RB procede al download dei documenti elettronici relativi alle offerte economiche "Busta C", di ciascun offerente per ciascun lotto ed alla verifica, che da esito positivo, dell'integrità e della correttezza formale della documentazione contenuta in tali buste telematiche.

In seguito, la Commissione giudicatrice procede, per ciascuna offerta economica, a dare lettura dei parametri necessari per il calcolo del Costo di gestione **CG(Pd)** - prezzo offerto per la fornitura del dispositivo (inclusa la garanzia offerta), **GDO** - durata in mesi della garanzia offerta (compresa nel prezzo della fornitura) e **Pma** - costo annuale della manutenzione "full-risk") che sarà utilizzato, a sua volta, per il calcolo del coefficiente da attribuire all'elemento economico e del relativo punteggio secondo le modalità riportate al paragrafo 18.3 del Disciplinare di gara.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

LOTTO N. 1	PLICO N.1 TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L.
Pd	€ 173.311,00	€ 171.956,36	€ 165.779,00
Pma	€ 8.500,00	€ 6.865,74	€ 11.583,00
GDO	48 mesi	60 mesi	48 mesi
CG	€ 207.311,00	€ 192.553,58	€ 212.111,00

LOTTO N.2	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N: 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
Pd	€ 30.012,70	€ 44.872,60	€ 40.335,16
Pma	€ 1.197,11	€ 85,80	€ 4.026,60
GDO	60 mesi	48 mesi	48 mesi
CG	€ 33.604,03	€ 45.215,20	€ 56.441,56

LOTTO N. 3	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
Pd	€ 34.623,39	€ 39.721,80	€ 54.380,00
Pma	€ 1.380,86	€ 151,80	€ 5.428,80
GDO	60 mesi	48 mesi	48 mesi
CG	€ 38.765,97	€ 40.329,00	€ 76.105,20

Data lettura dei suddetti parametri, la Commissione si riunisce in seduta riservata per il calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica e, dunque, dei punteggi complessivi:

LOTTO N. 1	PLICO N.1 TRUMPF MED ITALIA S.R.L.	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	27,864	30,000	27,234

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

LOTTO N. 2	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L.	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L.
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	30,000	22,296	17,861

LOTTO N. 3	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L.	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L.
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	30,000	28,837	15,281

Alle ore 18.10 i rappresentanti degli operatori economici presenti vengono nuovamente riammessi alla seduta.

La Commissione giudicatrice comunica, quindi, per ciascun lotto i punteggi complessivi conseguiti da ciascun operatore economico come da prospetti riepilogativi riportati di seguito:

LOTTO 1 - Lampade Scialitiche per Sala Operatoria					
OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO QUALITÀ	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	ANOMALIA
TRUMPF MED ITALIA S.r.l.	67,708	€ 173.311,00	27,864	95,572	SI
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	70,000	€ 171.956,36	30,000	100,00	SI
MARTIN ITALIA S.r.l.	62.640	€ 165.779,00	27,234	89,874	SI

LOTTO 2 - Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato					
OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO QUALITÀ	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	ANOMALIA
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	56.424	€ 30.012,70	30,000	86,424	SI
F.A.S.E. Srl	70.00	€ 44.872,60	22,296	92.296	NO
MARTIN ITALIA S.r.l.	59,519	€ 40.335,16	17,861	77,380	NO

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

LOTTO 3 - Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso					
OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO QUALITÀ	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	ANOMALIA
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	54,414	€ 34.623,39	30,000	84,414	NO
F.A.S.E. Srl	59,101	€ 39.721,80	28,837	87,939	SI
MARTIN ITALIA S.r.l	70,00	€ 54.390,00	15,281	85,281	NO

La Commissione giudicatrice da, altresì, comunicazione circa le offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 18:15 la Commissione giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica e decide di consegnare, per il tramite del Segretario, il presente verbale, nonché tutti i verbali della Commissione giudicatrice, la documentazione di gara contenente le offerte degli operatori economici ricevuta in data 12/03/2019 su supporto elettronico, al Responsabile del procedimento per i seguiti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.


ing. Maria Gelsomina LAULETTA – Presidente

ing. Giuseppe SPERA – Componente

dott. Rocco CARBONELLA – Componente

dott.ssa Teresa ANDRIANI – Segretario

ing. Giuseppe BIANCHINI – Responsabile del Procedimento

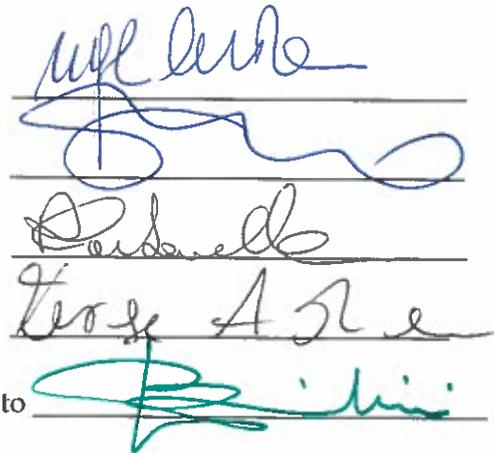

COMMISSIONE GIUDICATRICE

“Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera”

Verbale n.16 del 18 ottobre 2019

Seduta pubblica di rettifica dei punteggi delle offerte economiche

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE PER SALAOPERATORIA E PER USO DIAGNOSTICO E CHIRURGIA MINORE OCCORRENTI ALLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA -N. 7156389

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 12:15, presso la SUA-RB, sita in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice della "Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera - ID gara SIMOG n. 7156389", nominata con Determinazione Dirigenziale 20A2.2019/D.00039 del 23/02/2019 e di seguito costituita:

Componente	Ruolo
LAULETTA Maria Gelsomina	Presidente
SPERA Giuseppe	Componente - assente
CARBONELLA Rocco	Componente
ANDRIANI Teresa	Segretario

con la partecipazione del R.U.P. della gara di che trattasi, ing. Giuseppe BIANCHINI.
Premesso che:

- nel corso della seduta pubblica del 05/09/2018, la commissione giudicatrice, dopo avere comunicato ai concorrenti presenti i punteggi delle offerte tecniche ha provveduto all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche, all'attribuzione dei punteggi economici, alla comunicazione dei punteggi complessivi riportati dai singoli concorrenti per ciascun Lotto ed alla individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'Art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici;
- nel corso della seduta riservata di verifica dell'anomalia delle offerte del 10/10/2018 è emerso che il concorrente F.A.S.E. S.r.l., nella relazione giustificativa dell'offerta, ha dichiarato, in riferimento alle offerte economiche per il Lotto n. 2 e per il Lotto n. 3, che il valore del costo annuo per la manutenzione full-risk inserito nell'offerta economica è riferito a ciascuna lampada e non al complesso di tutte le lampade costituenti il Lotto, come interpretato nel corso della seduta pubblica del 05/09/2019;
- il R.U.P. e la commissione giudicatrice hanno concordato sull'esigenza di operare, in seduta pubblica, le doverose correzioni ai punteggi assegnati alle offerte economiche;

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Alle ore 12,35, preso atto dell'assenza del componente la commissione giudicatrice ing. Giuseppe SPERA a causa di un improvviso impedimento, vengono invitati a partecipare alla seduta pubblica i rappresentanti degli operatori economici concorrenti di seguito riportati:

RAPPRESENTANTE	OPERATORE ECONOMICO
Vincenzo Braia	HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.
Giovanni Spagnoletta	F.A.S.E. Srl
Daniele De Giovanni	MARTIN ITALIA S.r.l

Il Presidente della commissione giudicatrice comunica ai presenti quanto riportato in premessa.
Successivamente il R.U.P. accede al portale della piattaforma di e-procurement della SUA-RB e provvede ad annullare i punteggi già attribuiti alle offerte economiche dei Lotti n. 2 e n. 3.

Il Presidente della commissione giudicatrice, relativamente ai Lotti n. 2 e n. 3, procede, per ciascuna offerta economica, a dare lettura dei parametri necessari per il calcolo del *Costo di gestione CG (Pd - prezzo offerto per la fornitura del dispositivo (inclusa la garanzia offerta), GDO - durata in mesi della garanzia offerta (compresa nel prezzo della fornitura) e Pma - costo annuale della manutenzione "full-risk")* come rettificati nel senso sopra descritto.

LOTTO N.2	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
<i>Pd</i>	€ 30.012,70	€ 44.872,60	€ 40.335,16
<i>Pma</i>	€ 1.197,11	<u>€ 1.544,40</u>	€ 4.026,60
<i>GDO</i>	60 mesi	48 mesi	48 mesi
<i>CG</i>	€ 33.604,03	€ 51.049,60	€ 56.441,56

LOTTO N. 3	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
<i>Pd</i>	€ 34.623,39	€ 39.721,80	€ 54.380,00
<i>Pma</i>	€ 1.380,86	<u>€ 1.366,20</u>	€ 5.428,80
<i>GDO</i>	60 mesi	48 mesi	48 mesi
<i>CG</i>	€ 38.765,97	€ 45.186,60	€ 76.105,20

Conseguentemente il calcolo dei punteggi da attribuire alle offerte economiche risulta così rettificato:

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

LOTTO N. 2	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	30,000	<u>19,748</u>	17,861

LOTTO N. 3	PLICO N. 3 HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.R.L.	PLICO N. 4 F.A.S.E. S.R.L	PLICO N. 5 MARTIN ITALIA S.R.L
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	30,000	<u>25,737</u>	15,281

Alla luce di tali modifiche, fermi restando i punteggi già assegnati ai concorrenti relativamente al Lotto n. 1, i punteggi complessivi conseguiti da ciascun concorrente relativamente ai Lotti n. 2 e n. 3 sono riportati nei prospetti seguenti:

LOTTO 2 - Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo carrellato					
CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITÀ	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	ANOMALIA
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	56.424	€ 30.012,70	30,000	86,424	SI
F.A.S.E. Srl	70.00	€ 44.872,60	<u>19,748</u>	89,748	NO
MARTIN ITALIA S.r.l	59,519	€ 40.335,16	17,861	77,380	NO

LOTTO 3 - Lampade scialitiche ambulatoriali di tipo fisso					
OPERATORE ECONOMICO	PUNTEGGIO QUALITÀ	PREZZO OFFERTO	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	ANOMALIA
HOSPITAL SCIENTIFIC CONSULTING S.r.l.	54.414	€ 34.623,39	30,000	84,414	NO
F.A.S.E. Srl	59,101	€ 39.721,80	<u>25,737</u>	84,839	SI
MARTIN ITALIA S.r.l	70,00	€ 54.390,00	15,281	85,281	NO

COMMISSIONE GIUDICATRICE


"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"

Pertanto, la commissione giudicatrice dà atto che:

- relativamente al Lotto n. 2 e per effetto delle rettifiche operate, l'offerta del concorrente F.A.S.E. S.r.l. ha ottenuto il più alto punteggio complessivo, l'offerta non risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- relativamente al Lotto n. 3 e per effetto delle rettifiche operate, l'offerta del concorrente MARTIN ITALIA S.r.l. ha ottenuto il più alto punteggio, l'offerta non risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Esaurite le attività della seduta odierna, la commissione giudicatrice, alle ore 13:00, dichiara conclusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto

ing. Maria Gelsomina	LAULETTA	Presidente	
dott. Rocco	CARBONELLA	Componente	
dott.ssa Teresa	ANDRIANI	Segretario	
ing. Giuseppe	BIANCHINI	R.U.P. della SUA-RB	

COMMISSIONE GIUDICATRICE

"Gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura di lampade scialitiche per sala operatoria e per uso diagnostico e chirurgia minore occorrenti alla Azienda Sanitaria Locale di Matera"