

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL’ AOR
SAN CARLO DI POTENZA E ALL’ AZIENDA SANITARIA DI MATERA -
Edizione II - ID: G00421 -

COMMISSIONE GIUDICATRICE

VERBALE N. 3 DEL 13-12-2024

3ª SEDUTA RISERVATA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **13** del mese di **dicembre (13-12-2024)**, alle ore **14:55** circa, presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, in Via Vincenzo Verrastro n. 4 a Potenza, **in seduta riservata** si è riunita, per la procedura di affidamento in questione, la Commissione giudicatrice ex art. 93 del codice dei contratti pubblici.

La Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale n. **20BA.2024/D.00130** del **24-07-2024**, è così composta:

- *dott.ssa* **Angela BAIANO** – Dirigente medico dell’A.O.R. San Carlo di Potenza – **Presidente**;
- *dott.* **Danilo MENNA** – Dirigente medico dell’A.O.R. San Carlo di Potenza – **Componente**;
- *dott.ssa* **Ripalta PAGLIONE** – Dirigente medico del P.O. Madonna delle Grazie di Matera – **Componente**;

svolge le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, il sig. **Pietro Rota** - dipendente regionale in servizio c/o la SUA-RB - individuato con la medesima Determinazione Dirigenziale n. **20BA.2024/D.00130** del **24-07-2024**.

Il Presidente, dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione nonché del Segretario, dichiara aperta la seduta.

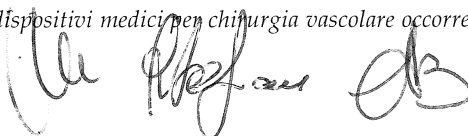
Il Presidente, dato atto della presenza di tutti i componenti della Commissione nonché del Segretario, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da lettura del verbale:

- n. 1 della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, svoltasi il 19 novembre 2024;

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all’A.O.R. San Carlo di Potenza e all’Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.



- n. 2 della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, svoltasi il 02 dicembre 2024.

I Commissari procedono quindi alla lettura delle offerte tecniche e all'esame, ove presente, della campionatura pervenuta, come previsto nel prospetto "Allegato 2A" rettificato per il solo LOTTO 21 dalla COMUNICAZIONE a sistema del 02-05-2024.

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

CATETERI PER PTA

LOTTO n. 61: catetere per PTA semicompiante su guida .035 con diametro fino a 12mm

Concorrono per il lotto n. 61 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
7	Cordis Italy S.r.l.
15	VIOLATECH SRL
21	CARDIO.TEK s.r.l.
23	Aetos Medical Srl
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 61 il capitolato tecnico richiede un "Catetere a Palloncino per PTA Semi-Compiante OTW e compatibile con guida 0.035". Diametri del palloncino da 3 a 12 mm, Lunghezze del palloncino da 20 a 300 mm e lunghezze dello shaft 75 e 130 cm, compatibile con introduttore da 5 a 7 Fr. Catetere del palloncino con centimetratura non radiopaca. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche e il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole artero-venose (AV) native o sintetiche."

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, VIOLATECH SRL e CARDIO.TEK s.r.l., offrono un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "Lunghezza richiesta 300 mm offrono, rispettivamente, 250 mm, 280 mm e 220 mm ...".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 1 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N. 62: catetere per PTA semicompiante su guida .035 disponibile in diametro oltre i 12mm

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Concorrono per il lotto n. 62 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	<u>New Medical Solutions srl</u>
27	<u>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.</u>

Per quanto concerne il prodotto del lotto 62 il capitolato tecnico richiede un *“Catetere a Palloncino per PTA Semi-Compiante OTW e compatibile con guida 0.035”*. *Diametri del palloncino da 3 a 12 mm, Lunghezze del palloncino da 20 a 300 mm e lunghezze dello shaft 75 e 130 cm, compatibile con introduttore da 5 a 7 Fr. Catetere del palloncino con centimetratura non radiopaca. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche e il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole artero-venose (AV) native o sintetiche.”*

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, VIOLATECH SRL e CARDIO.TEK s.r.l., offrono un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "Lunghezza richiesta 300 mm offrono, rispettivamente, 250 mm, 280 mm e 220 mm ...".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 2 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N. 63: catetere per PTA non compliante di lunghezza fino a 10cm

Concorrono per il lotto n. 62 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 03 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N. 64: catetere per PTA non compliante di lunghezza superiore a 10cm

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Concorrono per il lotto n. 64 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 04 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N. 65: catetere per PTA non conforme di lunghezza superiore a 10cm

Concorrono per il lotto n. 65 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 65 il capitolato tecnico richiede un *"Pallone per PTA vascolare periferica OTW e fistole artero-venose, compatibile con filo guida 0.035", 0.018" e 0.014", disponibilità di lunghezza catetere da circa 50 a circa 180 cm, diametro dei palloncini da 1,5mm a 8mm con lunghezza da 15 a 220 mm.."*

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "... Diametro del palloncino offerto 2 mm, richiesto 1,5 mm, inoltre manca la lunghezza del palloncino richiesta 220 offre 150 mm ...".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 5 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N. 66: catetere per PTA scarsamente conforme su guida .018" di lunghezza fino a 300mm

Concorrono per il lotto n. 66 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
19	AB MEDICA SPA
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 66 il capitolato tecnico richiede un *“Catetere a palloncino periferico a doppio lume coassiale OTW compatibile con filo guida 0.018”*. *Diametri da 2 a 7.0 mm e lunghezze da 20 a 300 mm. Corpo catetere in Poliammide con lunghezza utile di 90, 130 e 180cm. Compatibili con introduttori 4F e 5F. RBP fino a 22 atm. Presenza della tecnologia “three/six folding” che consente un avvolgimento più serrato del palloncino attorno al corpo del catetere*”

L'operatore economico AB MEDICA SPA, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...lunghezza del palloncino richiesto 300 offre 250 mm ...".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 6 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N.67: catetere per PTA scarsamente compliant su guida .018” di lunghezza fino a 200mm

Concorrono per il lotto n. 67 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
7	Cordis Italy S.r.l.
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
19	AB MEDICA SPA
23	Aetos Medical Srl
26	New Medical Solutions srl
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 67 il capitolato tecnico richiede un *“Cateteri a palloncino per PTA, OTW compatibili con guida 0.018”, shaft con tecnologia co-axial design, dotato di due marker radiopachi. Rivestimento in Jet coating. Lunghezza dello shaft da 90 a 150cm. Lunghezze da 20 a 200mm. Alta resistenza al kinking ed eccellente pushability e trackability. RBP a 22 atm.”*

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, Cordis Italy S.r.l., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., AB MEDICA SPA, New Medical Solutions srl, e ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l., offrono un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...**RBP a 22 atm**... offrono rispettivamente RBP 15 atm, 18 atm,

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

14 atm, 18 atm, 20 atm e 14 atm".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 7 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N.68: catetere per PTA dei piccoli vasi da .014 e 0.18"

Concorrono per il lotto n. 68 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
19	AB MEDICA SPA
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 08 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N. 69: catetere per PTA dei piccoli vasi da .014"

Concorrono per il lotto n. 69 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
15	VIOLATECH SRL
23	Aetos Medical Srl
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 69 il capitolato tecnico richiede un "Catetere OTW compatibile con filo guida da 0,014". Pallone in FLEXITEC Ultra™ disponibile nei diametri da 1.5 a 4.0 mm. Lunghezze da 20 a 210 mm e disponibilità di configurazioni tapered. Presenza di 2 Marker in platino

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera – Edizione II.

iridio a profilo zero. Compatibili con introduttore 4F."

Gli operatori economici **BIOTRONIK ITALIA SPA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., VIOLATECH SRL e New Medical Solutions srl**, offrono un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a ".....**Mancano palloni a conformazione conica....**".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 9 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA

LOTTO N. 70: catetere per litotrissia intravscolare

Concorrono per il lotto n. 70 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 10 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA A RILASCIO DI FARMACI

LOTTO N. 71: catetere per PTA a rilascio di farmaco Paclitaxel

Concorrono per il lotto n. 71 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
15	VIOLATECH SRL

Per quanto concerne il prodotto del lotto 71 il capitolato tecnico richiede un "Catetere a Palloncino OTW per PTA a rilascio di farmaco Paclitaxel in concentrazione 2 µg/mm² con polimero formato da Polisorbato+Sorbitolo. Compatibilità con guida 0.014", 0.018" 0.035" e introduttori da 4 e 5 Fr fino a 7mm di diametro del pallone. Diametri del palloncino da 2 a 12 mm e lunghezze da 40 a 220 mm. Lunghezza dello shaft da 75 a 150 cm. Indicato per la dilatazione di lesioni vascolari stenotiche o ostruttive nelle estremità inferiori e nelle fistole artero-venose, allo scopo di migliorarne la perfusione e ridurre l'incidenza di restenosi".

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

L'operatore economico **BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.** offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "...**diametro richiesto del pallone medicato**..." che deve essere da 2mm a 12mm, viene offerto da 2mm a 8mm".

L'operatore economico New Medical Solutions srl., offre prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "...farmaco Paclitaxel in concentrazione 2 µg/mm² con polimero formato da Polisorbato+Sorbitolo ...", viene offerta una concentrazione di farmaco maggiore cioè 3 microgrammi per mm²".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 11 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA A RILASCIO DI FARMACI

LOTTO N. 72: catetere per PTA a rilascio di farmaco Sirolimus

Concorrono per il lotto n. 72 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione prodotta, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 12 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER PTA A RILASCIO DI FARMACI




LOTTO N. 73: catetere per PTA a rilascio di farmaco Paclitaxel a concentrazione superiore a 2 µg/mm²

Concorrono per il lotto n. 73 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 73 il capitolato tecnico richiede un "Palloni per PTA a rilascio di Paclitaxel, distribuito uniformemente lungo la sua lunghezza di lavoro con concentrazione di 3 µg/mg, compatibile con filo guida 0.014", 0.018" e 0.035. Lunghezza catetere 75, 100, 110, 130, 140, 150 e 180 cm, diametro dei palloni da 1,25 mm a 12,00mm con lunghezze da 15 a 220mm."

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Aggiunta N.   

L'operatore economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "...diametro dei palloni..." manca diametro minimo da 1, 25 mm ...

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza di requisiti minimi.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 13 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MICROCATETERI

LOTTO N. 74: Microcatetere armato in acciaio con punta distale preformabile.

Concorrono per il lotto n. 74 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	CARDIO.TEK s.r.l.
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 74 il capitolato tecnico richiede un "Microcatetere con marker distale, costituito da 4 zone di differente consistenza, rivestimento idrofilo, armato in acciaio, rivestimento interno in PTFE. Pressione di rottura 300 PSI. Punta distale preformabile. Compatibile con DMSO. Diametro esterno da 1,7 a 2,8 Fr, compatibile con guida 0.014" e 0.018", lunghezze 135 e 160cm circa".

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...la punta del catetere non è preformabile...".

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza di requisiti minimi.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 14 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

MICROCATETERI

LOTTO N. 75: Microcatetere armato in acciaio con punta distale preformabile.

Concorrono per il lotto n. 75 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
12	CROSSMED
21	CARDIO.TEK s.r.l.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 75 il capitolato tecnico richiede un "Microcatetere High Flow con lume interno da 0.025", dedicato per il rilascio di spirali da 0.020". Diametro esterno prossimale 2.95 F e diametro esterno distale 2.6 F. Presenta nella parte distale, due marker, distanti 3 cm l'uno dall'altro per una sicurezza maggiore durante il rilascio delle spirali. Disponibile in 3 configurazioni: a punta dritta, a 45° e a 90°".

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "....la punta del catetere non è preformabile...".

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza di requisiti minimi.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 15 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE

LOTTO N. 76: Microcatetere armato in acciaio con punta distale preformabile.

Concorrono per il lotto n. 76 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
12	CROSSMED
21	CARDIO.TEK s.r.l.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 16 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE

LOTTO N. 77: Catetere da infusione con diametro esterno fino a 3Fr.

Concorrono per il lotto n. 77 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 17 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE

LOTTO N. 78: Catetere da infusione con diametro esterno fino a 3Fr.

Concorrono per il lotto n. 78 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 18 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE

LOTTO N. 79: Catetere per tromboaspirazione meccanica di diametro fino ad 8 Fr.

Concorrono per il lotto n. 79 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
12	CROSSMED
19	AB MEDICA SPA

Per quanto concerne il prodotto del lotto 79 il capitolato tecnico richiede un *"Sistema completo di tromboaspirazione meccanica continua indicato per la rivascolarizzazione dei distretti periferici arteriosi e venosi, con indicazione per embolia polmonare; il sistema deve comprendere cateteri da aspirazione per grossi vasi (varie curve e lunghezze) diametro esterno fino a 8 Fr., microguida dedicata per frammentare e aiutare l'aspirazione del trombo. Pompa di aspirazione da fornire in comodato d'uso gratuito e relativi accessori dedicati"*.

L'operatore economico AB MEDICA SPA, offre un prodotto che non rispetta i requisiti di capitolato relativo a *"....diametro massimo"* richiesto 8 Fr offerto max 6 Fr..., e perché non indicato per embolia polmonare.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza di requisiti minimi.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 19 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE

LOTTO N. 80: Catetere per tromboaspirazione meccanica di diametro superiore ad 8 Fr.

Concorrono per il lotto n. 80 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
12	CROSSMED

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera – Edizione II.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 20 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

PALLONI PER DILATAZIONE ENDOPROTESI AORTICHE

LOTTO N. 81: Catetere con pallone da distensione aortica.

Concorrono per il lotto n. 81 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.
15	VIOLATECH SRL
21	CARDIO.TEK s.r.l.
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 81 il capitolato tecnico richiede un "Pallone per dilatazione di endoprotesi aortiche complianti, di diametro massimo fino a 46mm, compatibile con guida da 0,038". Compatibile con introduttore 12F."

L'operatore economico W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L. offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "Pallone di diametro massimo fino a 46mm, compatibile con guida da 0,038...", offre pallone di diametro massimo 37 mm.....".

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l. offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "Pallone compatibile con guida da 0,038"...", ovvero offre solo compatibilità da 0.035".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 21 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

PALLONI PER DILATAZIONE ENDOPROTESI AORTICHE

LOTTO N. 82: Catetere con pallone da distensione aortica di diametro fino a 50 mm.

Concorrono per il lotto n. 82 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
15	VIOLATECH SRL
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 82 il capitolato tecnico richiede un "Pallone per dilatazione di endoprotesi aortiche complianti in poliuretano, di diametro massimo fino a 50mm, compatibile con guida da 0.035". Catetere

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

a doppio lume 8 Fr lungo 100 cm compatibile con introduttore massimo 12 Fr. ”.

L'operatore economico VIOLATECH SRL offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " diametro massimo fino a 50 mm, offre diametro massimo 46 mm".

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza di requisiti minimi.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 22 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE

LOTTO N. 83: Palloni per dilatazione endoprotesi aortiche

Concorrono per il lotto n. 83 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 23 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI DI RIENTRO

LOTTO N. 84: Sistema di rientro per ricanalizzazioni subintimali con ecografia intravascolare

Concorrono per il lotto n. 84 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
20	EVASCULAR SRL

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 24 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI DI RIENTRO

LOTTO N. 85: Sistema di rientro per ricanalizzazioni subintimali con ecografia intravascolare

Concorrono per il lotto n. 85 i seguenti operatori economici:

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Plico	Operatore Economico
18	CARDIO VASCULAR SRL

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 25 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI PER ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE

LOTTO N. 86: Catetere per ecografia intravascolare

Concorrono per il lotto n. 86 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 26 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI PER ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE

LOTTO N. 87: Catetere per ecografia intravascolare

Concorrono per il lotto n. 87 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
20	EVASCULAR SRL

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 27 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI PER ATERECTOMIA

LOTTO N. 88: Catetere con pallone da distensione aortica di diametro fino a 50 mm.

Concorrono per il lotto n. 88 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
20	EVASCULAR SRL
21	CARDIO.TEK Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 88 il capitolato tecnico richiede un *“Catetere per aterectomia a doppio lume contenente un albero di torsione collegato a una struttura tagliente in metallo a livello della punta distale del catetere. Lume centrale compatibile con filo guida standard da 0,014”. sezione distale del catetere radiopaca per consentire la visualizzazione fluoroscopica della posizione del catetere e l’orientamento della punta. Disponibile con punte aterotome di diverse dimensioni: 1.5, 1.8, 2.2, 2.4 mm. Motore funzionante a batteria che aziona la fresa del catetere per aterectomia ad una velocità nominale compresa fra 10.000 e 12.000 giri/min.”.*

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto di diametro minimo 1.6 mm che non rispetta i requisiti di capitolato relativo a *“...punte aterotome di diverse dimensioni: 1.5, 1.8, 2.2, 2.4 mm ...”.* La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza dei requisiti richiesti.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza di requisiti minimi.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell’Allegato 3 *“Griglia di valutazione”.*

L’esito dell’attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell’Allegato 28 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

SISTEMI PER ATERECTOMIA

LOTTO N. 89: Sistema per aterectomia orbitale

Concorrono per il lotto n. 89 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell’Allegato 3 *“Griglia di valutazione”.*

L’esito dell’attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell’Allegato 29 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 90: Stent premontati in acciaio

Concorrono per il lotto n. 90 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	CORDIS ITALY SRL
20	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
23	AETOS MEDICAL SRL
24	COOK ITALIA SRL

Per quanto concerne il prodotto del lotto 90 il capitolato tecnico richiede un *“Stent in acciaio premontato su pallone in nylon minimamente compliant. Dotato di markers radiopachi alle due estremità dello stent. Elevata forza radiale*

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

associata ad una notevole flessibilità longitudinale. Diametri da 5 a 10mm. Lunghezze da 12mm a 57mm. Lunghezza dal catetere di rilascio 80 e 135cm. Compatibili con introduttore da 6Fr e 7 Fr.”.

L'operatore economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "...lunghezze minima.....", richiesta 12 mm, offerta 17 mm.

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 30 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 91: Stent premontati in cromocobalto per arterie iliache.

Concorrono per il lotto n. 91 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 91 il capitolato tecnico richiede un *"Stent in CoCr premontato su pallone rivestito in carbofilm dedicato al trattamento delle arterie iliache. Dotato di marker alle estremità. Elevata forza radiale. Diametro nominale di espansione da 6,0 mm a 10 mm. Lunghezza da 19 a 59 mm. Lunghezza catetere 75 e 135cm. Compatibile con introduttore da 6F per tutte le misure."*

L'operatore economico BIOTRONIK ITALIA SPA, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "...manca della Lunghezza catetere 75 cm...".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 31 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 92: Stent premontati in cromocobalto ad elevata flessibilità.

Concorrono per il lotto n. 92 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
20	EVASCULAR SRL

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

21	CARDIO.TEK Srl
----	----------------

Per quanto concerne il prodotto del lotto 92 il capitolato tecnico richiede un *“Stent premontato su palloncino in lega di cromo-cobalto con disegno della maglia a zig-zag ad anelli corrugati per una elevatissima flessibilità ed alta forza radiale. Diametri da circa 5 mm a 10 mm, lunghezze da 18 a 58mm. Lunghezza catetere 75 e 120cm. Compatibile con introduttore da 6F per tutte le misure.”*

L'operatore economico BIOTRONIK ITALIA SPA, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: *“....manca Lunghezza catetere 75 cm...”*.

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: *“....disegno della maglia a zig-zag, offre maglia ad “S”...”*.

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e della campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 32 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 93: Stent premontati in cromobalto disponibile con sistema monorail.

Concorrono per il lotto n. 93 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 93 il capitolato tecnico richiede un *“Stent premontato su palloncino periferico vascolare in lega di cromo-cobalto con disegno multi-link. Configurazione monorail compatibile con guida 0.014” e over-the-wire con guida 0.035”. Diametri da 4 a 10 mm, lunghezza da 12 a 59 mm. Lunghezza del catetere 80 e 135cm. Compatibile con introduttore da 6F per tutte le misure.”*.

L'operatore economico New Medical Solutions srl, offre un prodotto NON COMPATIBILE con *“....manca sistema monorail, oltre a: 1) diametro minimo dello stent richiesto 4mm offerto 6mm e 2) lunghezza minima richiesta 12mm, offerta 19 mm...”*.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione e la campionatura prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 33 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE PER ARTERIE RENALI

LOTTO N. 95: Stent premontato per arterie renali compatibile con introduttore $\leq 5F$.

Concorrono per il lotto n. 95 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 34 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE PER ARTERIE RENALI

LOTTO N. 96: Stent premontato per arterie renali compatibile con introduttore $\leq 7F$.

Concorrono per il lotto n. 96 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 75 il capitolato tecnico richiede un "Stent per arteria renale in acciaio inox a maglie aperte, dotato di estremità rinforzate con alta resistenza alla compressione. Premontato su catetere a palloncino monorail a lungo 90 e 150cm circa, compatibile con guida 0.018". Diametri da 4 a 7mm. Lunghezza 15 e 19mm circa. Compatibile con cateteri-guida da 6 e 7F".

L'operatore economico New Medical Solutions srl, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "...Lunghezze dello stent richieste 15 e 19, offerta 12 e 17, inoltre il diametro minimo richiesto è 4mm offerto 5 mm.....".

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 35 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT AUTOESPANDIBILE

LOTTO N. 97: Stent periferico autoespandibile lunghezza fino a 15 cm.

Concorrono per il lotto n. 97 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
15	VIOLATECH SRL
23	Aetos Medical Srl
26	New Medical Solutions srl
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 97 il capitolato tecnico richiede un *“Stent self-expandable in nitinol per arteria femorale superficiale compatibile con filo guida 0.035”, delimitato da 12 markers radiopachi in tantalio. Sistema di rilascio ergonomico per una corretta apposizione, lunghezza catetere da 80 e 125 cm, diametro dello stent da 4 a 9 mm con lunghezze da 20 a 150 mm.”*.

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., Aetos Medical Srl e VIOLATECH SRL, offrono un prodotto che non rispetto al requisito minimo relativo al diametro minimo richiesto 4 mm. offerto 5 mm, inoltre, gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. e Aetos Medical Srl, mancano anche del diametro massimo richiesto 9mm offerto rispettivamente 7mm, 8mm e 8 mm..

La Commissione NON procede alla valutazione dello stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell’Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L’esito dell’attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell’Allegato 36 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT AUTOESPANDIBILE

LOTTO N. 98: Stent periferico autoespandibile lunghezza fino a 15 cm.

Concorrono per il lotto n. 98 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
3	BIOTRONIK ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
23	Aetos Medical Srl
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 98 il capitolato tecnico richiede un *“Stent autoespandibile in nitinol indicato per il trattamento delle arterie periferiche. Disponibile nelle lunghezze da 20 a 200 mm e diametri da 5 ad 8mm. Compatibile con introduttore 5 e 6Fr e guida 0.035”. Presenza sullo stent di 4 markers radiopachi in tantalio posizionati alle due estremità. lunghezza dello shaft da 80, 120 e 150cm con design triassiale composto da un corpo interno, un introduttore esterno ritraibile e una guaina di isolamento che agevola il rilascio. Impugnatura ergonomica con rotella di rilascio. Punta del catetere flessibile”*.

L'operatore economico BIOTRONIK ITALIA SPA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., e New Medical Solutions srl, offrono un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a: *“....shaft lungo.....”* richiesto 150

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

cm offerto rispettivamente 135 cm, 130 cm e 125 cm. Inoltre, BIOTRONIK ITALIA SPA manca del diametro massimo richiesto 8 mm offerti 7 mm. oltre che per la lunghezza minima offerto 30 mm richiesti 20 mm e in più gli operatori BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., e New Medical Solutions srl, non hanno il requisito della compatibilità richiesto anche 5F offerti 6F.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 37 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT AUTOESPANDIBILE

LOTTO N. 99: Stent periferico autoespandibile con struttura a fili intrecciati.

Concorrono per il lotto n. 99 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
19	AB MEDICA SPA
26	New Medical Solutions srl
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 99 il capitolato tecnico richiede un "Stent femorale autoespandibile ad elevatissima forza radiale e capacità di resistenza agli sforzi di compressione, torsione, trazione e flessione. Struttura realizzata con 6 filamenti, indipendenti e saldati tra loro in unico punto, in lega superelastica di nitinolo disposti in modo elicoidale a maglia intrecciata. Dispositivo di rilascio OTW per filo guida da 0.018" con rivestimento idrofilico e punta flessibile ed atraumatica. Il prodotto offerto dovrà essere supportato adeguata letteratura su riviste medico-scientifiche nazionali ed internazionali."

L'operatore economico AB MEDICA SPA, offrono un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "...compatibilità con filo guida da 0.018.....", viene offerto compatibilità con filo guida da 0.035".

L'operatore economico New Medical Solutions srl., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "... filamenti intrecciati.....", offre unico filamento, richiesti 6 filamenti.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 38 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT AUTOESPANDIBILE

LOTTO N. 100: Stent periferico autoespandibile di diametro oltre i 12 mm.

Concorrono per il lotto n. 100 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 100 il capitolato tecnico richiede un *“Stent vascolare autoespandibile in nitinolo con disegno a maglie romboidali senza punti di saldatura ed estremità svasate di 2 mm, indicato per il trattamento di lesioni dell’arteria iliaca e femorale superficiale. Dotato di marker radiopachi su entrambe le estremità dello stent. Diametri dello stent da 4 a 14 mm e lunghezze da 20 a 120 mm, lunghezza dello shaft da 80 cm e 135cm Sistema di rilascio OTW compatibile con guida da 0.035” e introduttore da 6F, “tipless”, con manipolo a tripla opzione di rilascio.”*.

L'operatore economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a *“...Diametri dello stent”* richiesti 4 mm offerti 5 mm, manca anche della lunghezza dello shaft richiesto 135 cm. offerto 120 cm.

L'operatore economico New Medical Solutions srl., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo *“... Diametro minimo e massimo dello stent”* richiesto 4 mm e 14 mm, offerto 6 mm e 12 mm.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall’Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell’Allegato 3 *“Griglia di valutazione”*.

L’esito dell’attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell’Allegato 39 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT AUTOESPANDIBILE

LOTTO N. 101: Stent periferico autoespandibile di diametro fino a 12 mm.

Concorrono per il lotto n. 101 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.
24	COOK ITALIA SRL

Per quanto concerne il prodotto del lotto 101 il capitolato tecnico richiede un *“Stent self-expandable in Nitinol Piattaforma indicato per il trattamento di lesioni dell’arteria iliaca. Diametro nominale di espansione da 6 a 12 mm. Lunghezza dello stent da 20 a 150mm. Coating con bio inducer surface. “Single hand” delivery system con doppio sistema di rilascio: micrometrico e pull-back”*.

L'operatore economico Aetos Medical Srl, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a *“....manca diametri minimi e lunghezza massima....”*. richiesti 6, 7 e 8 mm offerto 9 mm mentre la lunghezza richiesta 150 mm, offerta 80 mm.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 40 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT AUTOESPANDIBILI A RILASCIO DI FARMACI

LOTTO N. 102: Stent periferico autoespandibile a rilascio di farmaco sirolimus

Concorrono per il lotto n. 102 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 41 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

BARE STENT AUTOESPANDIBILI A RILASCIO DI FARMACI

LOTTO N. 103: Stent periferico autoespandibile di diametro fino a 12 mm.

Concorrono per il lotto n. 103 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
23	Aetos Medical Srl
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 103 il capitolato tecnico richiede un "Stent auto-espandibile in Nitinol a rilascio di farmaco Paclitaxel (3 µg/mm²), per il trattamento di vasi periferici (arteria femorale superficiale e poplitea sopra il ginocchio), senza rivestimento polimerico. Sistema di rilascio triassiale disponibile in tutte le misure, compatibile con introduttore da 6 Fr. Presenza di 4 markers d'oro posti su ognuna delle estremità dello stent. Lunghezza dello shaft: 80 e 125 cm Diametri dello stent: da 5 mm a 8 mm. Lunghezze dello stent: da 4 cm a 14 cm".

L'operatore economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "....diametro minimo e massimo....", richiesti 5 mm e 8 mm offerti 6 mm e 7 mm.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 42 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera – Edizione II.

STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 104: Stent in acciaio ricoperti premontati.

Concorrono per il lotto n. 104 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
16	MAQUET Italia
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 104 il capitolato tecnico richiede un *“Stent in acciaio con design a celle aperte, totalmente incapsulato in tessuto in PTFE ultrasottile, espandibile mediante gonfiaggio con palloncino non compliant. Indicato per il trattamento delle arterie iliache e renali. Possibilità di essere dilatato per la sua intera lunghezza o parzialmente oltre il diametro nominale. Dotato di shaft lungo 80 o 120 cm. Compatibili con filo guida da 0.035” ed introduttori da 6 a 7 Fr. Misure: tutti i diametri e le lunghezze disponibili”*.

L'operatore economico Aetos Medical Srl, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " lunghezza dello shaft ..." richiesto uno shaft corto da 80 cm offerto solo uno da 120 cm. .

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 43 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 105: Stent in cromocobalto ricoperti premontati.

Concorrono per il lotto n. 105 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
16	MAQUET Italia
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 105 il capitolato tecnico richiede un *“Stent in cromocobalto ricoperto in ePTFE premontato su pallone OTW o monorail utilizzabile per il trattamento di aneurismi, fistole, dissezioni o rotture dei vasi del distretto periferico. Maglie dello stent ad anelli corrugati con elevata forza radiale. Diametri compresi tra circa 2,5 mm e 10 mm. Lunghezze comprese tra circa 8 mm 58 mm. Disponibilità doppio shaft 75 e 120 cm. Compatibilità con introduttore di diametro massimo 6F fino al diametro di 8mm. Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.”*.

L'operatore economico Aetos Medical Srl, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "....mancanza di Stent in cromocobalto...." offerto in acciaio inossidabile 316L. .

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 44 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 106: Stent in cromocobalto ricoperti per il trattamento delle coartazioni aortiche.

Concorrono per il lotto n. 106 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
18	CARDIO VASCULAR SRL
19	AB MEDICA SPA

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 45 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 107: Stent premontati ricoperti in ptfe con legame covalente di eparina

Concorrono per il lotto n. 107 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 46 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE

LOTTO N. 108: Stent in cromocobalto ricoperti premontati.

Concorrono per il lotto n. 108 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
23	Aetos Medical Srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 108 il capitolato tecnico richiede un "Stent in acciaio inossidabile espandibile su pallone non compliant a spalle corte, incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE. Diametro dello stent da 5 mm a 12 mm e lunghezza da 16 a 58 mm. Sistema di rilascio compatibile con guida da 0.035" e introduttore da 6, 7 e 8 F a seconda della misura. Lunghezza del catetere da 80 e 135 cm. Indicato per il trattamento di lesioni aterosclerotiche in arterie iliache comuni ed esterne".

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

L'operatore economico Aetos Medical Srl, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " lunghezza e diametro minimo e massimo ...", diametri richiesti da 5 a 11 mm, offerti 6 e 7 mm. Inoltre la lunghezza richiesta da 15 a 79 mm offerti da 22 a 59 mm. .

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 47 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT COPERTI AUTOESPANDIBILI

LOTTO N. 109: Stent premontati ricoperti in ptfe con legame covalente di eparina

Concorrono per il lotto n. 109 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 48 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT COPERTI AUTOESPANDIBILI

LOTTO N. 110: Stent coperto autoespandibile in nitinol incapsulato in due strati di PTFE.

Concorrono per il lotto n. 110 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 110 il capitolato tecnico richiede un "Stent vascolare ricoperto autoespandibile in nitinol incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE con lume interno impregnato al Carbonio. 4 marker radiopachi in Tantalio su ciascuna estremità dello stent. Diametro dello stent da 5 mm a 13,5 mm e lunghezza da 20 a 120 mm. Sistema di rilascio OTW compatibile con guida 0.035" e introduttori da 8 a 10F. Lunghezza sistema di rilascio da 80 e 117 cm. Indicato per uso nelle arterie iliache e femorali."

L'operatore economico New Medical Solutions srl, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " assenza grandi diametri e lunghezza minima e massima ...", richiesti diametri da 5 mm a 13,5 mm, offerti da 5 a 9 mm, mentre la lunghezza richiesta è da 20 a 120 cm, offerti da 40 a 100 cm. .

La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 49 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT COPERTI AUTOESPANDIBILI

LOTTO N. 111: Stent coperto autoespandibile in nitinol incapsulato in due strati di ptfe impregnato al carbonio.

Concorrono per il lotto n. 111 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA
21	CARDIO.TEK s.r.l.
26	New Medical Solutions srl

Per quanto concerne il prodotto del lotto 111 il capitolato tecnico richiede un "Stent vascolare ricoperto autoespandibile in Nitinol, interamente incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE con lume interno impregnato al Carbonio. Disponibile in versione retta e conica. Diametri dello stent da 6 a 10 mm e lunghezze da 30 a 100 mm. Sistema di Rilascio Triassiale OTW con guaina esterna di supporto e Manipolo Ergonomico a doppia opzione di velocità per il rilascio dello stent. Compatibilità con filo guida da 0,035" e introduttore da 8 e 9 Fr. Lunghezza dello shaft da 80 e 120 cm. Indicato per il trattamento di stenosi nel tratto di efflusso delle fistole artero-venose protesiche o native e per il trattamento di lesioni aterosclerotiche delle arterie iliache e femorali".

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " lume interno non è impregnato al Carbonio ..." e " non è Disponibile in versione conica ...".

L'operatore economico New Medical Solutions srl, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " Manca il diametro da 10 ..." e " manca la lunghezza minima 30 mm".

La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 50 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT CAROTIDEI

LOTTO N. 112: Stent carotideo in nitinol a celle aperte.

Concorrono per il lotto n. 112 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
7	Cordis Italy S.r.l.
23	Aetos Medical Srl

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

26	New Medical Solutions srl
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Per quanto concerne il prodotto del lotto 112 il capitolato tecnico richiede un *“Stent in Nitinolo autoespandibile a celle aperte, disponibile nelle forme cilindrica o conica. Markers prossimali e distali sullo stent. Sistema di ritenzione dello stent per eliminare l'effetto jumping in seguito a rilascio. Sistema di rilascio a semplice pull-back. Lunghezza del catetere di rilascio 135cm. Compatibilità con introduttore 6Fr e filoguida 0.014”*. Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili”.

L'operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " Lunghezza del catetere di rilascio 135 cm ...", offerto 132 cm.

La Commissione NON procede alla valutazione dello stessi per carenza del requisito minimo.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 50 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT CAROTIDEI

LOTTO N. 113: Stent carotideo in nitinol a celle aperte.

Concorrono per il lotto n. 113 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 52 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT CAROTIDEI

LOTTO N. 114: Stent carotideo in nitinol a celle chiuse.

Concorrono per il lotto n. 114 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 “Griglia di valutazione”.

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 53 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II

STENT CAROTIDEI

LOTTO N. 115: Stent carotideo ricoperto a copertura di placca ad elevata flessibilita'.

Concorrono per il lotto n. 115 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
13	TERUMO ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 54 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

STENT CAROTIDEI

LOTTO N. 116: Stent carotideo in nitinol a celle chiuse ad alta forza radiale per lesioni calcifiche.

Concorrono per il lotto n. 116 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 55 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE

LOTTO N. 117: Endoprotesi aortica bimodulare in dacron con aggancio soprarenale.

Concorrono per il lotto n. 117 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 56 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE

LOTTO N. 118: Endoprotesi aorto-uniliaca in dacron con aggancio soprarenale.

Concorrono per il lotto n. 118 i seguenti operatori economici:

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024
Procedura aperta per l'aggiudicazione della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Plico	Operatore Economico
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 57 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENAL

LOTTO N. 119: Endoprotesi aortica retta in dracon.

Concorrono per il lotto n. 119 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
23	Aetos Medical Srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 58 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENAL

LOTTO N. 120: Endoprotesi aortica trimodulare in dacron con agganccio soprarenale per colletti angolati fino a 60°.

Concorrono per il lotto n. 120 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 59 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENAL

LOTTO N. 121: Branca endoprotesica iliaca in dacron.

Concorrono per il lotto n. 121 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 60 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENAL

LOTTO N. 122: Endoprotesi per conversione da impianto bisiliaco a monoiliaco.

Concorrono per il lotto n. 122 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 61 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENAL

LOTTO N. 123: Endoprotesi trimodulare ultra-low-profile per accessi vascolari ostili e/o di piccolo calibro.

Concorrono per il lotto n. 123 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 62 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENAL

LOTTO N. 124: Endoprotesi aortica trimodulare con aggancio soprarenale per colletti angolati fino a 75°.

Concorrono per il lotto n. 124 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo

COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 63 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE

LOTTO N. 125: Endoprotesi aortica trimodulare con aggancio soprarenale per colletti angolati fino a 75°.

Concorrono per il lotto n. 125 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
26	New Medical Solutions srl

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 64 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE

LOTTO N. 126: Endoprotesi aortica trimodulare con aggancio soprarenale per colletti angolati fino a 75° con meccanismo di recupero del puntale facilitato per anatomie tortuose.

Concorrono per il lotto n. 126 i seguenti operatori economici:

Plico	Operatore Economico
2	Serom Medical Technology SRL

Valutata la documentazione prodotta dei restanti operatori in gara, la Commissione procede all'attribuzione dei punteggi previsti per ciascun criterio di aggiudicazione previsto dall'Art. 16 del disciplinare di gara e secondo le modalità descritte nell'Allegato 3 "Griglia di valutazione".

L'esito dell'attività di attribuzione dei punteggi è riportato nell'Allegato 65 del presente verbale e ne costituisce pertanto parte integrante.

Alle ore 17:55 il Presidente della Commissione giudicatrice, ultimate le operazioni odierne, dichiara conclusa la seduta riservata.

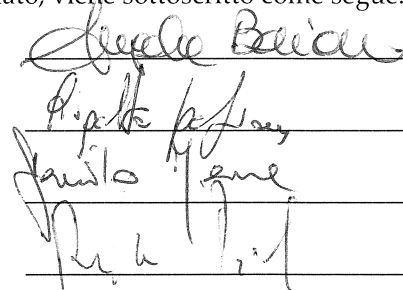
Della riunione viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE dott.ssa Angela BAIANO

I COMPONENTI dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

IL SEGRETARIO sig. Pietro ROTA



COMMISSIONE GIUDICATRICE – SEDUTA RISERVATA VERBALE N. 3 DEL 13/12/2024

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per chirurgia vascolare occorrenti all'A.O.R. San Carlo di Potenza e all'Azienda Sanitaria di Matera - Edizione II.

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

CATETERI PER PTA

Lotto 61 - CATETERE PER PTA SEMICOMPIANTE SU GUIDA .035 CON DIAMETRO FINO A 12MM. - CIG : B14C291980

Descrizione: Catetere a Palloncino per PTA Semi-Compiante OTW e compatibile con guida 0.035". Diametri del palloncino da 3 a 12 mm, Lunghezze del palloncino da 20 a 300 mm e lunghezze dello shaft 75 e 130 cm, compatibile con introduttore da 5 a 7 Fr. Catetere del palloncino con centimetrazione non radiopaca. Indicato per la dilatazione delle stenosi di arterie periferiche e il trattamento di lesioni ostruttive delle fistole artero-venose (AV) native o sintetiche.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	0,90	1,00	0,97	1,00	10,00
7	Cordis Italy S.r.l.	0,80	0,70	0,70	0,73	0,76	7,59
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	-	-
23	Aetos Medical Srl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,83	8,28
26	New Medical Solutions srl	0,70	0,80	0,70	0,73	0,76	7,59

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,90	0,90	1,00	0,93	1,00	10,00
7	Cordis Italy S.r.l.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,75	7,50
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	-	-
23	Aetos Medical Srl	0,80	0,80	0,80	0,80	0,86	8,57
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,70	0,70	0,67	0,71	7,14

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
7	Cordis Italy S.r.l.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	10,50
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	-	-
23	Aetos Medical Srl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,6	9,00
26	New Medical Solutions srl	0,70	0,60	0,60	0,63	0,633333333	9,50

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
7	Cordis Italy S.r.l.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	10,50
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	-	-
23	Aetos Medical Srl	0,60	0,60	0,60	0,60	0,6	9,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,60	0,50	0,57	0,566666667	8,50

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO		
3	BIOTRONIK ITALIA SPA		0,00	-	0,00	0,00	0,00
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	DIAMETRI	12,00	-	0,86	8,57	
7	Cordis Italy S.r.l.	DIAMETRI	9,00	-	0,64	6,43	
15	VIOLATECH SRL		0	-	0,00	0,00	
21	CARDIO.TEK s.r.l.		0	-	0,00	0,00	
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI	9	-	0,64	6,43	
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI	14	-	1,00	10,00	

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO		
3	BIOTRONIK ITALIA SPA		0,00	-	0,00	0,00	
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	LUNGHEZZE	10,00	-	0,91	9,09	
7	Cordis Italy S.r.l.	LUNGHEZZE	10,00	-	0,91	9,09	
15	VIOLATECH SRL		0	-	0,00	0,00	
21	CARDIO.TEK s.r.l.		0	-	0,00	0,00	
23	Aetos Medical Srl	LUNGHEZZE	10	-	0,91	9,09	
26	New Medical Solutions srl	LUNGHEZZE	11	-	1,00	10,00	

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO			
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	67,66	-	Soglia sbarramento superata
7	Cordis Italy S.r.l.	51,61	-	Soglia sbarramento superata
15	VIOLATECH SRL	-	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-
23	Aetos Medical Srl	50,37	-	Soglia sbarramento superata
26	New Medical Solutions srl	52,73	-	Soglia sbarramento superata

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE			
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	67,66	-	1,00 70,00
7	Cordis Italy S.r.l.	51,61	-	0,76 53,39
15	VIOLATECH SRL	-	-	-
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-
23	Aetos Medical Srl	50,37	-	0,74 52,11
26	New Medical Solutions srl	52,73	-	0,78 54,55

NOTE

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, VIOLATECH SRL e CARDIO.TEK s.r.l., offrono un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "Lunghezza richiesta 300 mm offrono, rispettivamente, 250 mm, 280 mm e 220 mm ... ". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

CATETERI PER PTA

Lotto 62 - CATETERE PER PTA SEMICOMPIANTE SU GUIDA .035 CON DIAMETRO OLTRE A 12MM. - CIG : B14C2CEC06

Descrizione: Catetere a palloncino per PTA, OTW, lunghezza dello shaft 80 e 135 cm, in nylon/pebax doppio strato e rivestito in silicone, semicompiante, compatibile con guida 0.035", con markers radiopachi, diametri da 3 a 14 mm e lunghezze da 20 a 250 mm. Compatibilità introduttori fino a 6F per le misure fino a 12 mm di diametro. RBP da 7 a 28 atm.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 10,00

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 10,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	9,00	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	DIAMETRI			9,00		1,00 10,00

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	10,00	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	LUNGHEZZE			10,00		1,00 10,00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	-	42,00	-			
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	-	70,00	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico New Medical Solutions srl., offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "...offre RBP da 7 a 28 atm. richiesto da 6 a 16 atm ...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER PTA**

Lotto 63 - CATETERE PER PTA NON COMPLIANTE DI LUNGHEZZA FINO A 10 CM - CIG : B14C29A120

Descrizione: Catetere a Palloncino per PTA ad alta pressione OTW ultra non compliant, compatibile con filo guida 0.035". Diametri da 4 a 12 mm e lunghezze da 2 a 10 cm. Lunghezza Corpo del Catetere 50, 75 e 120 cm e compatibile con introduttori da 6 a 8 Fr. Pressione di rottura (RBP) massima fino a 40 ATM. Indicato per la PTA di arterie renali, iliache e femorali e per il trattamento delle lesioni occlusive a carico delle fistole artero-venose.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,90	0,90	1,00	0,93	0,93	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,60	0,60	0,57		0,61 6,07

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,90	0,90	1,00	0,93	0,93	1,00 10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60		0,64 6,43

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,47	0,53	0,60	0,53		0,53 8,00

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,47	0,53	0,60	0,53		0,53 8,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	DIAMETRI			7,00	8,00	0,88 8,75
21	CARDIO.TEK s.r.l.	DIAMETRI			8,00		1,00 10,00


06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	LUNGHEZZE			5,00	6,00	0,83 8,33
21	CARDIO.TEK s.r.l.	LUNGHEZZE			6,00		1,00 10,00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	67,08	42,00	Soglia sbarramento superata			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,50		Soglia sbarramento superata			


08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	67,08	67,08	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,50		0,72	50,61

NOTE


dott.ssa Angela BAIANO




dott. Danilo MENNA



dott.ssa Ripalta PAGLIONE



geom. Pietro ROTA





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 004 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L064

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****CATETERI PER PTA****Lotto 64 - CATETERE PER PTA NON COMPLIANTE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10 CM - CIG : B14C2D1E7F**

Descrizione: Catetere a Palloncino per PTA in materiale composito multistrato brevettato (PET con fibre di molecole di Polietilene e Pebax) ad alta pressione OTW ultra non compliant, compatibile con filo guida 0.035". Pressione di rottura compresa tra 20 e 24 ATM. Diametri da 3 a 10 mm e lunghezze da 20 a 200 mm. Lunghezza dello shaft da 40 a 135 cm, compatibile con introduttore da 5 a 7Fr. Indicato per la PTA delle arterie renale, iliaca, femorale, poplitea, tibiale, peroneale e succlavia e per il trattamento di lesioni occlusive di fistole artero-venose per dialisi native o sintetiche.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,80	0,80	0,60	0,73	0,73
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,80	0,60	0,67	0,67

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,90	1,00	1,00	0,97	1,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,50	0,60	0,60	0,57	0,59
26	New Medical Solutions srl	0,50	0,60	0,60	0,57	0,59

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,53	0,53	0,47	0,51	0,51
26	New Medical Solutions srl	0,47	0,53	0,47	0,49	0,49

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,47	0,53	0,47	0,49	0,49
26	New Medical Solutions srl	0,70	0,70	0,60	0,67	0,67

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta		diametri	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA		DIAMETRI	8,00	9,00	0,89 8,89
21	CARDIO.TEK s.r.l.		DIAMETRI	9,00		1,00 10,00
26	New Medical Solutions srl		DIAMETRI	8,00		0,89 8,89

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta		lunghezze	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA		LUNGHEZZE	7,00	10,00	0,70 7,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.		LUNGHEZZE	10,00		1,00 10,00
26	New Medical Solutions srl		LUNGHEZZE	10,00		1,00 10,00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento	
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	65,89	42,00	Soglia sbarramento superata	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,20		Soglia sbarramento superata	
26	New Medical Solutions srl	48,77		Soglia sbarramento superata	

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	65,89	65,89	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	48,20		0,73	51,20
26	New Medical Solutions srl	48,77		0,74	51,81

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER PTA**

Lotto 65 - CATETERE PER PTA NON COMPIANTE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 10 CM - CIG : B14C282D4E

Descrizione: Pallone per PTA vascolare periferica OTW e fistole artero-venose, compatibile con filo guida 0.035", 0.018" e 0.014", disponibilità di lunghezza catetere da circa 50 a circa 180 cm, diametro dei palloncini da 1,5mm a 8mm con lunghezza da 15 a 220 mm.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 10,00

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 10,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta		diametri	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO	
21	CARDIO.TEK s.r.l.		-	-	10,00	-	-
26	New Medical Solutions srl		DIAMETRI	10,00		1,00	10,00

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta		lunghezze	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO	
21	CARDIO.TEK s.r.l.		-	-	10,00	-	-
26	New Medical Solutions srl		LUNGHEZZE	10,00		1,00	10,00



07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	42,00	-			
26	New Medical Solutions srl	70,00		Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE		
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	70,00	-	-		
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00		

NOTE



L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "... **Diametro del palloncino offerto 2 mm, richiesto 1,5 mm, inoltre manca la lunghezza del palloncino richiesta 220 offre 150 mm** ...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER PTA**

Lotto 66 - CATETERE PER PTA SCARSAMENTE COMPLIANTE SU GUIDA .018" DI LUNGHEZZA FINO A 300MM - CIG : B14C2AE1A1

Descrizione: Catetere a palloncino periferico a doppio lume coassiale OTW compatibile con filo guida 0.018". Diametri da 2 a 7.0 mm e lunghezze da 20 a 300 mm. Corpo catetere in Poliammide con lunghezza utile di 90, 130 e 180cm. Compatibili con introduttori 4F e 5F. RBP fino a 22 atm. Presenza della tecnologia "three/six folding" che consente un avvolgimento più serrato del palloncino attorno al corpo del catetere.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 10,00

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	0,93	-
23	Aetos Medical Srl	0,90	0,90	1,00	0,93		1,00 10,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-			-	8,00	-
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI			8,00		1,00 10,00

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-			-	9,00	-
23	Aetos Medical Srl	LUNGHEZZE			9,00		1,00 10,00


07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
19	AB MEDICA SPA	-	42,00	-			
23	Aetos Medical Srl	70,00		Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
19	AB MEDICA SPA	-	70,00	-	-
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00


NOTE

L'operatore economico AB MEDICA SPA, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "...lunghezza del palloncino richiesto 300 offre 250 mm ...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.


dott.ssa Angela BAIANO



dott. Danilo MENNA



dott.ssa Ripalta PAGLIONE



geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER PTA**

Lotto 67 - CATETERE PER PTA SCARSAMENTE COMPLIANTE SU GUIDA .018" DI LUNGHEZZA FINO A 200MM - CIG : B14C2CA8BA

Descrizione: Cateteri a palloncino per PTA, OTW compatibili con guida 0.018", shaft con tecnologia co-axial design, dotato di due marker radiopachi. Rivestimento in Jet coating. Lunghezza dello shaft da 90 a 150cm. Lunghezze da 20 a 200mm. Alta resistenza al kinking ed eccellente pushability e trackability. RBP a 22 atm.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio			Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)			Criterio: QL		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-

03-	Parametro: Navigabilità			Criterio: QL		punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)			Criterio: QL		punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-

05-	Parametro: Disponibilità di diametri			Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	8,00	-	-
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI			8,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze			Criterio: QT1		punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	9,00	-	-
7	Cordis Italy S.r.l.	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	LUNGHEZZE			9,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-	-	-	-

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00		-			
7	Cordis Italy S.r.l.	-			-			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-			
19	AB MEDICA SPA	-			-			
23	Aetos Medical Srl	70,00			Soglia sbarramento superata			
26	New Medical Solutions srl	-			-			
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-			-			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00	-	-
7	Cordis Italy S.r.l.	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-	-
19	AB MEDICA SPA	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-

NOTE

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, Cordis Italy S.r.l., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., AB MEDICA SPA, New Medical Solutions srl, e ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l., offrono un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "...RBP a 22 atm ... offrono rispettivamente RBP 15, 18, 14, 18, 20 e 14 atm". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 008 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L068

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER PTA****Lotto 68 - CATETERE PER PTA DEI PICCOLI VASI DA 0,14 E 0,18" - CIG : B14C2CFCD9**

Descrizione: Cateteri a palloncino per PTA, OTW, in nylon, compatibili con guida 0.014 - 018", provvisti di due markers radiopachi. Diametri da 1.2 a 6mm e lunghezze da 20 a 200 cm. Compatibilità introduttori da 4F e 5fr. Pressione nominale di 8 atm e RBP di 14 atm. Catetere con disegno co-axial, lunghezza dello shaft da 90 e 150 cm. Punta e parte interna a struttura unificata. Profilo della punta ≤ 0.5mm e lunghezza della punta di 4.5 mm

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio			Criterio: QL		punteggio:	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	0,90	0,80	0,90	0,87	1,00	0,87	8,67
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,90	0,90	0,90	0,90		0,90	9,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,80	0,90	0,90	0,87		0,87	8,67
19	AB MEDICA SPA	0,90	0,80	0,90	0,87		0,87	8,67
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,70	0,70	0,70	0,70		0,70	7,00
26	New Medical Solutions srl	0,90	0,80	0,80	0,83		0,83	8,33
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	0,80	0,70	0,70	0,73	1,00	0,73	7,33
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,80	0,70	0,80	0,77		0,77	7,67
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,70	0,60	0,60	0,63		0,63	6,33
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,50	0,57		0,57	5,67
26	New Medical Solutions srl	0,80	0,80	0,80	0,80		0,80	8,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio:	punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	0,80	0,70	0,80	0,77	1,00	0,77	7,67
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,60	0,70	0,70	0,67		0,67	6,67
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,50	0,60	0,60	0,57		0,57	5,67
19	AB MEDICA SPA	0,70	0,50	0,60	0,60		0,60	6,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00
26	New Medical Solutions srl	0,80	0,80	0,80	0,80		0,80	8,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL				punteggio:	punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	0,70	0,60	0,60	0,63	1,00	0,63	6,33
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	0,70	0,70	0,60	0,67		0,67	6,67
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,60	0,60	0,60		0,60	6,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,60	0,60	0,70	0,63		0,63	6,33
26	New Medical Solutions srl	0,80	0,80	0,80	0,80		0,80	8,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta		diametri	valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA		DIAMETRI	8,00	14,00	0,57 5,71
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA		DIAMETRI	10,00		0,71 7,14
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.		DIAMETRI	11,00		0,79 7,86
19	AB MEDICA SPA		DIAMETRI	13,00		0,93 9,29
21	CARDIO.TEK s.r.l.		DIAMETRI	14,00		1,00 10,00
26	New Medical Solutions srl		DIAMETRI	10,00		0,71 7,14
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.		DIAMETRI	7,00		0,50 5,00

06- Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1	punteggio: 10			
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze	valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	LUNGHEZZE	8,00	12,00	0,67	6,67
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	LUNGHEZZE	9,00		0,64	6,43
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	LUNGHEZZE	10,00		0,71	7,14
19	AB MEDICA SPA	LUNGHEZZE	9,00		0,64	6,43
21	CARDIO.TEK s.r.l.	LUNGHEZZE	12,00		0,86	8,57
26	New Medical Solutions srl	LUNGHEZZE	8,00		0,57	5,71
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	LUNGHEZZE	9,00		0,64	6,43

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO			
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	42,38	42,00	Soglia sbarramento superata
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	42,90		Soglia sbarramento superata
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	42,33		Soglia sbarramento superata
19	AB MEDICA SPA	42,38		Soglia sbarramento superata
21	CARDIO.TEK s.r.l.	43,57		Soglia sbarramento superata
26	New Medical Solutions srl	45,19		Soglia sbarramento superata
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	51,43		Soglia sbarramento superata

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	42,38	51,43	0,82	57,69
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	42,90		0,83	58,40
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	42,33		0,82	57,62
19	AB MEDICA SPA	42,38		0,82	57,69
21	CARDIO.TEK s.r.l.	43,57		0,85	59,31
26	New Medical Solutions srl	45,19		0,88	61,51
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	51,43		1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER PTA
Lotto 69 - CATETERE PER PTA DEI PICCOLI VASI DA 0.14" - CIG : B14C2F5C35**

Descrizione: Catetere OTW compatibile con filo guida da 0,014". Pallone in FLEXITECH Ultra™ disponibile nei diametri da 1.5 a 4.0 mm. Lunghezze da 20 a 210 mm e disponibilità di configurazioni tapered. Presenza di 2 Marker in platino iridio a profilo zero. Compatibili con introduttore 4F.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio			Criterio: QL		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)			Criterio: QL		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

03-	Parametro: Navigabilità			Criterio: QL		punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)			Criterio: QL		punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-

05-	Parametro: Disponibilità di diametri			Criterio: QT1		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-			-	4,00	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-		-
15	VIOLATECH SRL	-			-		-
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI			4,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-			-		-



06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze			Criterio: QT1		punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze			valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-			-	6,00	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-		-
15	VIOLATECH SRL	-			-		-
23	Aetos Medical Srl	LUNGHEZZE			6,00		10,00
26	New Medical Solutions srl	-			-		-


07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00		-		
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-		
15	VIOLATECH SRL	-			-		
23	Aetos Medical Srl	70,00			Soglia sbarramento superata		
26	New Medical Solutions srl	-			-		

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE					
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-	-
15	VIOLATECH SRL	-			-	-
23	Aetos Medical Srl	70,00			1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	-			-	-

NOTE

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., VIOLATECH SRL e New Medical Solutions srl, offrono un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " Mancano palloni a conformazione **conica**..... ". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO 
dott. Danilo MENNA 

dott.ssa Ripalta PAGLIONE 
geom. Pietro ROTA 



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 010 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L070

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****CATETERI PER PTA****Lotto 70 - CATETERE PER LITOTRISSIA INTRAVASCOLARE - CIG : B14C2D0DAC**

Descrizione: Catetere a palloncino semicompiante, OTW, dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla lunghezza utile del palloncino per l'erogazione di energia meccanica pulsatile (onde d'urto), dedicato al trattamento delle lesioni calcifiche. Generatore d'impulsi fornito in comodato d'uso.

01-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	DIAMETRI		9,00	9,00	1,00	10,00

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta		lunghezze	Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.		LUNGHEZZE	2.00	2.00	1.00	10.00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

CATETERI PER PTA A RILASCIO DI FARMACI

Lotto 71 - CATETERE PER PTA A RILASCIO DI FARMACO PACLITAXEL - CIG : B14C2C898D

Descrizione: Catetere a Palloncino OTW per PTA a rilascio di farmaco Paclitaxel in concentrazione 2 µg/mm2 con polimero formato da Polisorbato+Sorbitolo. Compatibilità con guida 0.014", 0.018" 0.035" e introduttori da 4 e 5 Fr fino a 7mm di diametro del pallone. Diametri del palloncino da 2 a 12 mm e lunghezze da 40 a 220 mm. Lunghezza dello shaft da 75 a 150 cm. Indicato per la dilatazione di lesioni vascolari stenotiche o ostruttive nelle estremità inferiori e nelle fistole artero-venose, allo scopo di migliorarne la perfusione e ridurre l'incidenza di restenosi.

01-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		- -
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		- -

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		- -
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		- -

03-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		- -
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		- -

04-	Parametro: Disponibilità di studi clinici in Letteratura a supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		- -
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		- -

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	DIAMETRI			8,00	8,00	1,00 10,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-		- -
26	New Medical Solutions srl	-			-		- -

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	LUNGHEZZE			7,00	7,00	1,00 10,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-		- -
26	New Medical Solutions srl	-			-		- -

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-			
26	New Medical Solutions srl	-		-			

089-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	70,00	1,00	70,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico BOSTON SCIENTIFIC SPA, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a diametro richiesto del pallone medicato da 2mm a 12mm, offerto da 2mm a 8mm ". L'operatore economico New Medical Solutions srl, offre prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo mentre farmaco Paclitaxel in concentrazione 2 µg/mm2 con polimero formato da Polisorbato+Sorbitolo ... viene offerta una concentrazione di farmaco maggiore cioè 3 microgrammi per mm2". La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza di requisiti.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER PTA A RILASCIO DI FARMACI
Lotto 72 - CATETERE PER PTA A RILASCIO DI FARMACO SIROLIMUS - CIG : B14C289318**

Descrizione: Catetere a palloncino a rilascio di farmaco Sirolimus. Compatibilità con guide da 0.014", 0.018" e 0.035". Tutti i diametri e tutte le lunghezze.

01-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00 10,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00 15,00

03-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Disponibilità di studi clinici in Letteratura a supporto		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta		diametri	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO	
21	CARDIO.TEK s.r.l.		DIAMETRI	14,00	14,00	1,00	10,00

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta		lunghezze	Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO	
21	CARDIO.TEK s.r.l.		LUNGHEZZE	8,00	8,00	1,00	10,00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			

08-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE		
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00		

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****CATETERI PER PTA A RILASCIO DI FARMACI****Lotto 73 - CATETERE PER PTA A RILASCIO DI FARMACO PACLITAXEL A CONCENTRAZIONE SUPERIORE A 2NG/MM - CIG : B14C283E21**

Descrizione: Palloni per PTA a rilascio di Paclitaxel, distribuito uniformemente lungo la sua lunghezza di lavoro con concentrazione di 3 µg/mg, compatibile con filo guida 0.014", 0.018" e 0.035. Lunghezza catetere 75, 100, 110, 130, 140, 150 e 180 cm, diametro dei palloni da 1,25 mm a 12,00mm con lunghezze da 15 a 220mm.

01-	Parametro: Capacità di attraversamento della lesione (Profilo)		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	- -
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 10,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio: 15	punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	- -
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

03-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL		punteggio: 15	punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	- -
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 15,00

04-	Parametro: Disponibilità di studi clinici in Letteratura a supporto		Criterio: QL		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	- -
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 10,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri		Criterio: QT1		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-	14,00	- -
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI			14,00		1,00 10,00

06-	Parametro: Disponibilità di lunghezze		Criterio: QT1		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-	10,00	- -
26	New Medical Solutions srl	LUNGHEZZE			10,00		1,00 10,00

07-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	42,00	-			
26	New Medical Solutions srl	70,00		Soglia sbarramento superata			

089-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	70,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a ".....manca diametro minimo da 1,25 mm". La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza di requisiti minimi.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 014 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L074

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
MICROCATETERI****Lotto 74 - MICROCATETERE ARMATO IN ACCIAIO CON PUNTA DISTALE PREFORMABILE - CIG : B14C2D302A**

Descrizione: Microcatetere con marker distale, costituito da 4 zone di differente consistenza, rivestimento idrofilo, armato in acciaio, rivestimento interno in PTFE. Pressione di rottura 300 PSI. Punta distale preformabile. Compatibile con DMSO. Diametro esterno da 1,7 a 2,8 Fr, compatibile con guida 0.014" e 0.018", lunghezze 135 e 160cm circa.

01-	Parametro: Resistenza all'ingincchiamento		Criterio: QL		punteggio: 20	punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	- -
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 20,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL		punteggio: 20	punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	- -
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 20,00

03-	Parametro: Navigabilità in anatomie complesse		Criterio: QL		punteggio: 20	punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-	1,00	- -
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00 20,00

04-	Parametro: Gamma di configurazioni e lunghezze		Criterio: QT1		punteggio: 10	punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma configurazioni e lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-			-	3,00	- -
23	Aetos Medical Srl	configurazioni multiple + 3 LUNGHEZZE			3,00		1,00 10,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
10	CARDIO.TEK s.r.l.	-	42,00	-			
26	Aetos Medical Srl	70,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
10	CARDIO.TEK s.r.l.	-	70,00	-	-
26	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "...la punta del catetere non è preformabile...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito richiesto.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 015 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L075

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
MICROCATETERI
Lotto 75 - MICROCATETERE PER EMBOLIZZAZIONI - CIG : B14C267708**

Descrizione: Microcatetere High Flow con lume interno da 0.025", dedicato per il rilascio di spirali da 0.020". Diametro esterno prossimale 2.95 F e diametro esterno distale 2.6 F. Presenta nella parte distale, due marker, distanti 3 cm l'uno dall'altro per una sicurezza maggiore durante il rilascio delle spirali. Disponibile in 3 configurazioni: a punta dritta, a 45° e a 90°.

01-	Parametro: Resistenza all'inginocchiamento		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00	20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Navigabilità in anatomie complesse		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00	20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Gamma di configurazioni e lunghezze		Criterio: QT1		punteggio:	punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma configurazioni e lunghezze		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	LUNGHEZZE		6,00	6,00	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-		-	-

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
12	CROSSMED	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-				

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
12	CROSSMED	70,00	70,00	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-

NOTE

L'operatore economico CARDIO.TEK s.r.l., offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "....la punta del catetere non è preformabile...". La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito richiesto.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE
Lotto 76 - CATETERE MULTIFORATO PER INFUSIONE DI FARMACI TROMBOLITICI - CIG : B14C27EA02**

Descrizione: Catetere per l'infusione di agenti farmacologici o mezzi di contrasto radiopachi, punta distale, un meccanismo a valvola per consente un'infusione "weep" o "pulse-spray". La pressione massima di 350psi. I cateteri in poliuretano/nylon coestruso con valvola in poliuretano (PU). 4 Fr e 5f. Lunghezze 40, 65, 100 e 135cm.

01-	Parametro: Capacità di spinta		Criterio: QL			punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Ampiezza gamma diametri		Criterio: QT1			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI		2,00	2,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Ampiezza gamma lunghezze		Criterio: QT1			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	LUNGHEZZE		4,00	4,00	1,00	15,00

05-	Parametro: Capacità di resistenza alla pressione di infusione		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	resistenza alla pressione di infusione		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	pressione		350,00	350,00	1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
23	Aetos Medical Srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

ott.ssa Ripalta PAGLIONE

eom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE
Lotto 77 - CATETERE DA INFUSIONE CON DIAMETRO ESTERNO FINO A 3Fr - CIG : B14C2D2F52**

Descrizione: Catetere a lume singolo per infusione di farmaci o mdc, compatibilità filo guida 0.014", .016", 0.018", 0.021", 0.025". Copertura dello shaft idrofilica, rinforzo della struttura con maglia metallica a 16 fili intrecciati, resistenza massima alla pressione di esercizio di 1200 psi. Lunghezza di esercizio di 105, 130 e 150 cm, diametro esterno da 1.7 a 3.0 Fr.

01-	Parametro: Capacità di spinta		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Ampiezza gamma diametri		Criterio: QT1			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri		MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI		6,00	6,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Ampiezza gamma lunghezze		Criterio: QT1			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze		MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	LUNGHEZZE		4,00	4,00	1,00	15,00

05-	Parametro: Capacità di resistenza alla pressione di infusione		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	resistenza alla pressione di infusione		MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	pressione		1200,00	1200,00	1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 18 AL VERBALE N.03 DEL 13.12.2024 - L0078

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE
Lotto 78 - CATETERE DA INFUSIONE ANTIREFLUSSO - CIG : B14C27B789**

Descrizione: Catetere a lume singolo per infusione di farmaci o mdc. Shaft collegato ad un connettore luer-lock costituito da uno strato interno in PTFE ed un rinforzo della struttura con maglia metallica a 16 fili intrecciati, presenza di markers radiopachi e fessure laterali sulle estremità distali. Resistenza massima alla pressione di esercizio di 1200 psi. Lunghezza di esercizio di 105, 130 e 155 cm, diametro esterno da 1.7 a 3.0 F.

01-	Parametro: Capacità di spinta		Criterio: QL				punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Ampiezza gamma diametri		Criterio: QT1			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI		6,00	6,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Ampiezza gamma lunghezze		Criterio: QT1			punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	lunghezze		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	LUNGHEZZE		4,00	4,00	1,00	15,00

05-	Parametro: Capacità di resistenza alla pressione di infusione		Criterio: QT1			punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	resistenza alla pressione di infusione		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	pressione		1200,00	1200,00	1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura: G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE**

Lotto 79 - CATETERE PER TROMBOASPIRAZIONE MECCANICA DI DIAMETRO FINO AD 8 Fr - CIG : B14C2D40FD

Descrizione: Sistema completo di tromboaspirazione meccanica continua indicato per la rivascolarizzazione dei distretti periferici arteriosi e venosi, con indicazione per embolia polmonare; il sistema deve comprendere cateteri da aspirazione per grossi vasi (varie curve e lunghezze) diametro esterno fino a 8 Fr., microguida dedicata per frammentare e aiutare l'aspirazione del trombo. Pompa di aspirazione da fornire in comodato d'uso gratuito e relativi accessori dedicati.

01-	Parametro: Capacità di spintà		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Ampiezza gamma diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma diametri e lunghezze		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	DIAMETRI + LUNGHEZZE		9,00	9,00	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	-		-		-	-

04-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Possibilità di gestione dell'aspirazione da parte dell'operatore		Criterio: SI/No			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	20,00
19	AB MEDICA SPA	-				-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
12	CROSSMED	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
19	AB MEDICA SPA	-		-				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
12	CROSSMED	70,00	70,00	1,00	70,00
19	AB MEDICA SPA	-		-	-

NOTE

L'operatore economico AB MEDICA SPA, offre un prodotto che non rispetta i requisiti di capitolato relativo a "....**diametro massimo richiesto 8 Fr offerti max 6 Fr**...., e perchè non **indicato per embolia polmonare**...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza dei requisiti richiesti.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 20 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0080

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura: G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
CATETERI PER INFUSIONE DI FARMACI E TROMBOASPIRAZIONE**

Lotto 80 - CATETERE PER TROMBOASPIRAZIONE MECCANICA DI DIAMETRO SUPERIORE AD 8 Fr - CIG : B14C2C7641

Descrizione: SSistema di tromboaspirazione continuo, intelligente, indicato per la rivascolarizzazione del sistema vascolare arterioso, venoso periferico ed embolia polmonare in presenza di trombosi o emboli in fase acuta o subacuta. Il sistema deve essere costituito da:

- cateteri ad ampio lume, armati in acciaio, resistenti al kinking, con ottima capacità di torsione; disponibili in diversi diametri fino a 12Fr, lunghezze e tipologia di punte. Il catetere deve essere fornito in kit con il tubo di aspirazione.
- microguida dedicata per frammentare e aiutare l'aspirazione del trombo
- pompa di aspirazione con relativi accessori.

01-	Parametro: Capacità di spinta		Criterio: QL			punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

03-	Parametro: Ampiezza gamma diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	gamma diametri e lunghezze		Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	DIAMETRI + LUNGHEZZE		3,00	3,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL			punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	Parametro: Possibilità di gestione dell'aspirazione da parte dell'operatore		Criterio: SI/No			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
12	CROSSMED	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
12	CROSSMED	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE			
12	CROSSMED	70,00	70,00	1,00	70,00			

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****PALLONI PER DILATAZIONE ENDOPROTESI AORTICHE****Lotto 81 - CATETERE CON PALLONE DA DISTENSIONE AORTICA - CIG : B14C2D51D0**

Descrizione: Pallone per dilatazione di endoprotesi aortiche complianti, di diametro massimo fino a 46mm, compatibile con guida da 0,038". Compatibile con introduttore 12F.

01-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	-	-	-	-	1,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	0,60	0,70	0,70	0,67		0,67	6,67
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1.00	1.00	1.00	1.00		1	10.00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	-	-	-	-	1,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	0,50	0,70	0,80	0,67		0,67	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

03-	Parametro: Resistenza al Kinking		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	-	-	-	-	0,97	-	-
15	VIOLATECH SRL	0,60	0,50	0,60	0,57		0,59	5,86
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,90	1,00	0,97		1,00	10,00

04-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	-	-	-	-	0,93	-	-
15	VIOLATECH SRL	0,53	0,67	0,67	0,62		0,67	10,02
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	0,87	0,93	1,00	0,93		1,00	15,00

05-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	-	-	-	-	0,68	-	-
15	VIOLATECH SRL	0,60	0,75	0,70	0,68		0,69	13,90
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,95	1,00	0,98		1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	-	42,00	-				
15	VIOLATECH SRL	46,44		Soglia sbarramento superata				
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-				
23	Aetos Medical Srl	70,00		Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	-	70,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	46,44		0,66	46,44
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico **W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.** offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "Pallone di diametro massimo fino a 46mm, compatibile con guida da 0,038, offre pallone massimo 37 mm.....", mentre l'operatore economico **CARDIO.TEK s.r.l.** manca requisito di compatibilità ".... con guida da 0,038" ovvero offre solo compatibilità da 0.035"". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

t.ssa Ripatta PAGLIONE

m. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
PALLONI PER DILATAZIONE ENDOPROTESI AORTICHE**

Lotto 82 - CATETERE CON PALLONE DA DISTENSIONE AORTICA DI DIAMETRO FINO A 50 MM - CIG : B14C2D7376

Descrizione: Pallone per dilatazione di endoprotesi aortiche complianti in poliuretano, di diametro massimo fino a 50mm, compatibile con guida da 0.035". Catetere a doppio lume 8 Fr lungo 100 cm compatibile con introduttore massimo 12 Fr.

01-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL			punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	PUNTEGGIO
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	PUNTEGGIO
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Resistenza al Kinking		Criterio: QL			punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	PUNTEGGIO
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL			punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	PUNTEGGIO
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

05-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL			punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	PUNTEGGIO
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento	
15	VIOLATECH SRL	-	42,00	-	
26	New Medical Solutions srl	70,00		Soglia sbarramento superata	

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE
15	VIOLATECH SRL	-	70,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico **VIOLATECH SRL** offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " diametro massimo fino a 50 mm, offre 46 mm". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

tt.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

gm. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 023 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0083

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
PALLONI PER DILATAZIONE ENDOPROTESI AORTICHE****Lotto 83 - CATETERE CON PALLONE TRILOBATO DA DISTENSIONE AORTICA - CIG : B14C2D62A3**

Descrizione: Catetere a palloncino trilobato in poliuretano per dilatazione di endoprotesi addominali e toraciche, con struttura a tre lobi che consente il mantenimento del flusso ematico, punta e markers radiopachi, su guida 0.035", lunghezza utile catetere 104 cm, diametri 16-34 e 26-45 mm

01-	Parametro: Capacità di spinta (rigidità dello shaft)		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Resistenza al Kinking		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Atraumaticità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

05-	Parametro: Velocità di sgonfiaggio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

tt.ssa Ripalta PAGLIONE

om. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 024 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0084

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****SISTEMI DI RIENTRO****Lotto 84 - SISTEMA DI RIENTRO PER RICANALIZZAZIONI SUBINTIMALI CON ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE - CIG : B14C2D84490**

Descrizione: Catetere di rientro per il trattamento delle occlusioni croniche. Catetere a doppio filo guida che con lume da 6F posizionabile nel suo sito di destinazione nel sistema vascolare attraverso un filo guida RX 0,014". Dotato alla sua estremità di un ago cavo in nitinol estensibile compatibile con fili guida da 0,014". Posizionamento ed orientamento dell'ago ottenibile attraverso l'uso di un trasduttore ecografico intravascolare (IVUS) montato sull'estremità distale del catetere. L'ago deve poter essere esteso con incrementi di 1 mm o a una distanza predeterminata utilizzando l'anello di arresto. Lunghezza catetere 120 cm, rivestito in silicone e provvisto di markers nella punta e nell'alloggiamento dell'ago in nitinol.

01-	Parametro: Presenza di più markers distali per l'orientamento		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Compatibilità con guide di diverso calibro		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Radiovisibilità dell'ago		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
20	EVASCULAR SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATI	PUNTEGGIO FINALE
20	EVASCULAR SRL	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 025 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0085

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
SISTEMI DI RIENTRO****Lotto 85 - SISTEMA DI RIENTRO PER RICANALIZZAZIONI SUBINTIMALI - CIG : B14C2D951C**

Descrizione: Catetere di rientro per il trattamento delle occlusioni croniche. La sezione metallica del corpo centrale del catetere termina con una punta di polimero; all'estremità dello stesso è presente una sezione per l'uscita della cannula (ago) ed è presente un marker di platino per l'orientamento del dispositivo. Lunghezza utile del catetere fino a 120cm e compatibile con introduttore da 6F.

01-	Parametro: Presenza di più markers distali per l'orientamento		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Compatibilità con guide di diverso calibro		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Radiovisibilità dell'ago		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
18	CARDIO VASCULAR SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
18	CARDIO VASCULAR SRL	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 026 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0086

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
SISTEMI PER ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE****Lotto 86 - CATETERE PER ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE - CIG : B14C2F6D08**

Descrizione: Catetere per ecografia intravascolare periferica ad alta risoluzione compatibile con filo guida da 0.035" e 0.018" con diametri massimi di immagine rispettivamente di 70mm e 22 mm. Lunghezza fino a 135 cm. Frequenze da 15 e 30 MHz. Deve consentire di visualizzare la sezione intraluminale del vaso mediante ritiro manuale del catetere a velocità controllata. Console in comodato d'uso.

01-	Parametro: Presenza di più markers distali per l'orientamento		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Compatibilità con guide di diverso calibro		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Radiovisibilità dell'ago		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 027 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0087

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
SISTEMI PER ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE
Lotto 87 - CATETERE PER ECOGRAFIA INTRAVASCOLARE - CIG : B14C2DA5EF**

Descrizione: Catetere elettronico monouso per rilevazione di immagini ad ultrasuoni. Indicato per la valutazione della morfologia vascolare nei vasi sanguigni del sistema vascolare periferico in ausilio alle normali procedure angiografiche. Disponibile nelle versioni 035, 018, 014. Deve permettere di visualizzare il lume, il vaso e la struttura della parete con un diametro immagine che può arrivare fino a 20, 24 e 60 mm a seconda della versione. Lunghezze catetere di 90, 135, 150 cm a seconda della versione, lume interno di 8.5F, 6F, 5F a seconda della versione.

01-	Parametro: Presenza di più markers distali per l'orientamento		Criterio: QL				punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Compatibilità con guide di diverso calibro		Criterio: QL				punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

03-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Radiovisibilità dell'ago		Criterio: QL			punteggio:	punteggio:	20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
20	EVASCULAR SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
20	EVASCULAR SRL	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 028 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0088

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****SISTEMI PER ATERECTIONIA****Lotto 88 - SISTEMA PER ATERECTIONIA IBRIDA - CIG : B14C26448F**

Descrizione: Catetere per aterectomia a doppio lume contenente un albero di torsione collegato a una struttura tagliente in metallo a livello della punta distale del catetere. Lume centrale compatibile con filo guida standard da 0,014". sezione distale del catetere radiopaca per consentire la visualizzazione fluoroscopica della posizione del catetere e l'orientamento della punta. Disponibile con punte aterotome di diverse dimensioni: 1.5, 1.8, 2.2, 2.4 mm. Motore funzionante a batteria che aziona la fresa del catetere per aterectomia ad una velocità nominale compresa fra 10.000 e 12.000 giri/min.

01-	Parametro: Versatilità nel trattamento della tipologia delle lesioni (calcio, trombo)		Criterio: QL			punteggio: 25		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Versatilità nel trattamento della tipologia delle lesioni (occlusioni, restenosi)		Criterio: QL			punteggio: 25		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
20	EVASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Gamma forme a misura		Criterio: QT1			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta				Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
20	EVASCULAR SRL	DIAMETRI + LUNGHEZZE			7,00	7,00	1,00	20,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-			-		-	-

05-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento	
20	EVASCULAR SRL	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-	

06-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	OEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE
20	EVASCULAR SRL	70,00	70,00	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **CARDIO.TEK s.r.l.**, offre un prodotto di diametro minimo **1.6 mm** che non rispetta i requisiti di capitolato relativo a "...**punte aterotome di diverse dimensioni: 1.5, 1.8, 2.2, 2.4 mm** ...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza dei requisiti richiesti.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
SISTEMI PER ATERECTOMIA
Lotto 89 - SISTEMA PER ATERECTOMIA ORBITALE - CIG : B14C265562**

Descrizione: Sistema per aterectomia orbitale per il trattamento di lesioni aterosclerotiche delle arterie periferiche. Dispositivo composto da una corona eccentrica diamantata, disponibile in tre tipologie, che fresano il calcio superficiale, bidirezionalmente ed indeboliscono quello intramurale, contribuendo alla modifica della compliance del vaso, attraverso la forza pulsatile, generata dalla massa eccentrica della fresa stessa. La guida dedicata 0.014", la soluzione lubrificante e la pompa peristaltica, completano il materiale necessario per effettuare la procedura. Disponibilità di 5 corone per il trattamento di vasi con calibri da 2 a 10 mm, attraverso un introduttore 6 Fr; in particolare, per vasi da 2 a 4 mm di diametro, la compatibilità dovrà essere di 4 Fr.

01-	Parametro: Versatilità nel trattamento della tipologia delle lesioni (calcio, trombo)		Criterio: QL				punteggio: 25
-----	---	--	--------------	--	--	--	---------------

N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00

02-	Parametro: Versatilità nel trattamento della tipologia delle lesioni (occlusioni, restenosi)		Criterio: QL				punteggio: 25
-----	--	--	--------------	--	--	--	---------------

N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25,00

03-	Parametro: Gamma forme a misura		Criterio: QT1				punteggio: 20
-----	---------------------------------	--	---------------	--	--	--	---------------

N.pl	Rag. sociale ditta				Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	DIAMETRI + LUNGHEZZE			11,00	1,00	20,00

04- TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO


N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata

05- TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE


N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO



dott.ssa Ripalta PAGLIONE

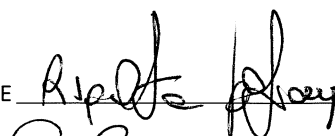

dott. Danilo MENNA



geom. Pietro ROTA





REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 030 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0090

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura: G00421**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE
Lotto 90 - STENT PREMONTATI IN ACCIAIO - CIG : B14C2C8714**

Descrizione: Stent in acciaio premontato su pallone in nylon minimamente compliant. Dotato di markers radiopachi alle due estremità dello stent. Elevata forza radiale associata ad una notevole flessibilità longitudinale. Diametri da 5 a 10mm. Lunghezze da 12mm a 57mm. Lunghezza dal catetere di rilascio 80 e 135cm. Compatibili con introduttore da 6Fr e 7 Fr.

01-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,60	0,50	0,60	0,57	0,93	0,61	9,11
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,90	0,90	0,93		1,00	15,00
24	COOK ITALIA SRL	0,50	0,60	0,60	0,57		0,61	9,11
02-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,50	0,70	0,60	0,60	0,93	0,64	9,64
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,90	0,90	0,93		1,00	15,00
24	COOK ITALIA SRL	0,50	0,60	0,60	0,57		0,61	9,11
03-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			Valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	DIAMETRI + LUNGHEZZE			17,00	17,00	1,00	10,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-		-	-
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI + LUNGHEZZE			11,00		0,65	6,47
24	COOK ITALIA SRL	DIAMETRI + LUNGHEZZE			11,00		0,65	6,47
04-	Parametro: Comformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,50	0,70	0,60	0,60	0,93	0,64	9,64
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,90	0,90	0,93		1,00	15,00
24	COOK ITALIA SRL	0,50	0,70	0,60	0,60		0,64	9,64
05-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,50	0,70	0,60	0,60	0,97	0,62	9,31
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	0,90	0,97		1,00	15,00
24	COOK ITALIA SRL	0,50	0,70	0,60	0,60		0,62	9,31
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
7	Cordis Italy S.r.l.	47,70	42,00		Soglia sbarramento superata			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-			
23	Aetos Medical Srl	66,47			Soglia sbarramento superata			
24	COOK ITALIA SRL	43,64			Soglia sbarramento superata			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
7	Cordis Italy S.r.l.	47,70	66,47		0,72		50,24	
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-			-		-	
23	Aetos Medical Srl	66,47			1,00		70,00	
24	COOK ITALIA SRL	43,64			0,66		45,96	

NOTE

L'operatore economico **BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "....lunghezze minima richiesta 12 mm offerta 17 mm....". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura: G00421

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE

Lotto 91 - STENT PREMONTATI IN CROMOCOBALTO PER ARTERIE ILIACHE - CIG : B14C27FAD5

Descrizione: Stent in CoCr premontato su pallone rivestito in carbofilm dedicato al trattamento delle arterie iliache. Dotato di marker alle estremità. Elevata forza radiale. Diametro nominale di espansione da 6,0 mm a 10 mm. Lunghezza da 19 a 59 mm. Lunghezza catetere 75 e 135cm. Compatibile con introduttore da 6F per tutte le misure.

01-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

02-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

03-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-		-	10,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI + LUNGHEZZE		10,00		1,00	10,00

04-	Parametro: Comformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

05-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00



06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00		-			
26	New Medical Solutions srl	70,00			Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00



NOTE

L'operatore economico **BIOTRONIK ITALIA SPA**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "....manca della Lunghezza catetere 75 cm...". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO


dott. Danilo MENNA 

dott.ssa Ripalta PAGLIONE


geom. Pietro ROTA 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura: G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE
Lotto 92 - STENT PREMONTATI IN CROMOCOBALTO AD ELEVATA FLESSIBILITA' - CIG : B14C2B9AB2**

Descrizione: Stent premontato su palloncino in lega di cromo-cobalto con disegno della maglia a zig-zag ad anelli corrugati per una elevatissima flessibilità ed alta forza radiale. Diametri da circa 5 mm a 10 mm, lunghezze da 18 a 58mm. Lunghezza catetere 75 e 120cm. Compatibile con introduttore da 6F per tutte le misure.

01- Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,98	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
18	CARDIO VASCULAR SRL	0,60	0,60	0,60	0,60		0,61 9,22
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	0,93	1,00	0,98		1,00 15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-
		0,60	0,60	0,60	0,60		0,61 9,22

02- Parametro: Forza radiale		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,98	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
18	CARDIO VASCULAR SRL	0,60	0,60	0,60	0,60		0,61 9,22
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	0,93	1,00	0,98		1,00 15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-
		0,60	0,60	0,60	0,60		0,61 9,22

03- Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QT1				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO	
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-			11,00	-	
15	VIOLATECH SRL	-				-	
18	CARDIO VASCULAR SRL	DIAMETRI + LUNGHEZZE 10,00				0,91 9,09	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	DIAMETRI + LUNGHEZZE 11,00				1,00 10,00	
26	New Medical Solutions srl	-				-	
		DIAMETRI + LUNGHEZZE 10,00				0,91 9,09	

04- Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,98	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
18	CARDIO VASCULAR SRL	0,47	0,40	0,47	0,45		0,46 6,86
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	0,93	1,00	0,98		1,00 15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-
		0,53	0,33	0,47	0,44		0,45 6,81

05- Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	0,98	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-
18	CARDIO VASCULAR SRL	0,47	0,67	0,53	0,56		0,57 8,55
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	0,93	1,00	0,98		1,00 15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-
		0,47	0,67	0,6	0,58		0,59 8,91

06- TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00	Soglia sbarramento superata
15	VIOLATECH SRL	42,93		Soglia sbarramento superata
18	CARDIO VASCULAR SRL	70,00		Soglia sbarramento superata
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		Soglia sbarramento superata
26	New Medical Solutions srl	43,24		Soglia sbarramento superata

07- TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE					
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00	-	-
15	VIOLATECH SRL	42,93		0,61	42,93
18	CARDIO VASCULAR SRL	70,00		1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	43,24		0,62	43,24

NOTE

L'operatore economico **BIOTRONIK ITALIA SPA**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "....manca Lunghezza catetere 75 cm...". L'operatore economico **CARDIO.TEK s.r.l.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "....disegno della maglia a zig-zag, offre maglia ad S...". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minino.



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 033 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L093

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura:**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE**

Lotto 93 - STENT PREMONTATI IN CROMOBALTO DISPONIBILE CON SISTEMA MONORAIL - CIG : B14C28D664

Descrizione: Stent premontato su palloncino periferico vascolare in lega di cromo-cobalto con disegno multi-link. Configurazione monorail compatibile con guida 0.014" e over-the-wire con guida 0.035". Diametri da 4 a 10 mm, lunghezza da 12 a 59 mm. Lunghezza del catetere 80 e 135cm. Compatibile con introduttore da 6F per tutte le misure.

01-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

02-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

03-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze		MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-		-	13,00	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	DIAMETRI + LUNGHEZZE		13,00		1,00	10,00

04-	Parametro: Comformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

05-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-	1,00	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	-	42,00		-			
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00			Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	-	70,00	-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico **New Medical Solutions srl**, offre un prodotto **NON COMPATIBILE** con "....manca sistema monorail oltre al diametro minimo dello stent richiesto 4 offre 6 e la lunghezza minima richiesta 12mm, offerta 19 mm...". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito

dott.ssa Angela BAIANO

t.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

m. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 034 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L095

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE PER ARTERIE RENALI****Lotto 95 - STENT PREMONTATO PER ARTERIE RENALI COMPATIBILE CON INTRODUTTORE <ø= 5F - CIG : B14C280BA8**

Descrizione: Stent periferico ritagliato a mezzo laser da un tubo in Cromo Cobalto espandibile con palloncino in Duralyn. Disponibile sia con sistema a scambio rapido che OTW. Lunghezza del catetere 80 e 140cm circa. Lunghezza dello stent da 12 a 24mm. Compatibile con guide da 0,014 e 0,018" e con introduttori 4 e 5 F.

01-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze		MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	DIAMETRI + LUNGHEZZE		16,00	16,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Comformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

05-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
7	Cordis Italy S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 035 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L096

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT PREMONTATI SU PALLONE PER ARTERIE RENALI****Lotto 96 - STENT PREMONTATO PER ARTERIE RENALI COMPATIBILE CON INTRODUTTORE <= 7F - CIG : B14C2DC795**

Descrizione: Stent per arteria renale in acciaio inox a maglie aperte, dotato di estremità rinforzate con alta resistenza alla compressione. Premontato su catetere a palloncino monorail a lungo 90 e 150cm circa, compatibile con guida 0.018". Diametri da 4 a 7mm. Lunghezza 15 e 19mm circa. Compatibile con cateteri-guida da 6 e 7F.

01-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze		MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	DIAMETRI + LUNGHEZZE		6,00	6,00	1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-		-		-	-

04-	Parametro: Comformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
26	New Medical Solutions srl	-			-			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	70,00	70,00	1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **New Medical Solutions srl**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "...Lunghesse dello stent richieste 15 e 19, offerta 12 e 17, inoltre il diametro minimo richiesto è 4mm offerto 5 mm.....". La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT AUTOESPANDIBILE
Lotto 97 - STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE LUNGHEZZA FINO A 15 CM - CIG : B14C2DB6C2**

tantalo. Sistema di rilascio ergonomico per una corretta apposizione, lunghezza catetere da 80 e 125 cm, diametro dello stent da 4 a 9 mm con lunghezze da 20 a 150 mm.

01-	Parametro: Flessibilità e resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Precisione del meccanismo di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-	-	-	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
15	VIOLATECH SRL	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO			
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-		-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-
15	VIOLATECH SRL	-		-
23	Aetos Medical Srl	-		-
26	New Medical Solutions srl	70,00		Soglia sbarramento superata
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-		-

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATI	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00	-	-
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	-		-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-	-
15	VIOLATECH SRL	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-		-	-

NOTE

Gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, BECTON DICKINSON ITALIA SPA, ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., Aetos Medical Srl e VIOLATECH SRL, offrono un prodotto che non rispetto al requisito minimo relativo al diametro minimo richiesto 4 mm. offerto 5 mm, inoltre, gli operatori economici BIOTRONIK ITALIA SPA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. e Aetos Medical Srl, mancano anche del diametro massimo richiesto 9mm offerto rispettivamente 7mm, 8mm e 8 mm.. La Commissione NON procede alla valutazione dello stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

BARE STENT AUTOESPANDIBILE

Lotto 98 - STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE LUNGHEZZA OLTRE A 15 CM - CIG : B14C2C97E7

Descrizione: Stent autoespandibile in nitinol indicato per il trattamento delle arterie periferiche. Disponibile nelle lunghezze da 20 a 200 mm e diametri da 5 ad 8mm. Compatibile con introduttore 5 e 6Fr e guida 0.035". Presenza sullo stent di 4 markers radiopachi in tantalio posizionati alle due estremità. lunghezza dello shaft da 80, 120 e 150cm con design triassiale composto da un corpo interno, un introduttore esterno ritraibile e una guaina di isolamento che agevola il rilascio. Impugnatura ergonomica con rotella di rilascio. Punta del catetere flessibile.

01-	Parametro: Flessibilità e resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Precisione del meccanismo di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	42,00	-				
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-				
23	Aetos Medical Srl	70,00		Soglia sbarramento superata				
26	New Medical Solutions srl	-		-				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE
3	BIOTRONIK ITALIA SPA	-	70,00	-	-
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-	-
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico BIOTRONIK ITALIA SPA, BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., e New Medical Solutions srl, offrono un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a: "....shaft lungo....." richiesto 150 cm offerto rispettivamente 135 cm, 130 cm e 125 cm. Inoltre, BIOTRONIK ITALIA SPA manca del diametro massimo richiesto 8 mm offerti 7 mm. oltre che per la lunghezza minima offerta 30 mm richiesti 20 mm e in più gli operatori BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., e New Medical Solutions srl, non hanno il requisito della compatibilità richiesto anche 5F offerti 6F. La Commissione NON procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 038 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0099

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****BARE STENT AUTOESPANDIBILE****Lotto 99 - STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE CON STRUTTURA A FILI INTRECCIATI - CIG : B14C2DD868**

Descrizione: Stent femorale autoespandibile ad elevatissima forza radiale e capacità di resistenza agli sforzi di compressione, torsione, trazione e flessione. Struttura realizzata con 6 filamenti, indipendenti e saldati tra loro in unico punto, in lega superelastica di nitinolo disposti in modo elicoidale a maglia intrecciata. Dispositivo di rilascio OTW per filo guida da 0.018" con rivestimento idrofilico e punta flessibile ed atraumatica. Il prodotto offerto dovrà essere supportato adeguata letteratura su riviste medico-scientifiche nazionali ed internazionali.

01-	Parametro: Flessibilità e resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

04-	Parametro: Precisione del meccanismo di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
19	AB MEDICA SPA	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
19	AB MEDICA SPA	-	42,00		-			
26	New Medical Solutions srl	-			-			
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00			Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRAT		PUNTEGGIO FINALE	
19	AB MEDICA SPA	-	70,00		-		-	
26	New Medical Solutions srl	-			-		-	
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00			1,00		70,00	

NOTE

Il prodotto offerto dall'operatore economico **AB MEDICA SPA**, manca del requisito minimo di capitolato relativo a "....compatibilità con **filo guida da 0.018.....**", viene offerto compatibilità con filo guida da 0.035". L'operatore economico **New Medical Solutions srl.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo "... filamenti **intrecciati.....**", offre unico filamento richiedi 6 filamenti. La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 039 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0100

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT AUTOESPANDIBILE**

Lotto 100 - STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE DI DIAMETRO OLTRE I 12 MM - CIG : B14C292A83

Descrizione: Stent vascolare autoespandibile in nitinolo con disegno a maglie romboidali senza punti di saldatura ed estremità svasate di 2 mm, indicato per il trattamento di lesioni dell'arteria iliaca e femorale superficiale. Dotato di marker radiopachi su entrambe le estremità dello stent. Diametri dello stent da 4 a 14 mm e lunghezze da 20 a 120 mm, lunghezza dello shaft da 80 cm e 135cm Sistema di rilascio OTW compatibile con guida da 0.035" e introduttore da 6F, "tipless", con manipolo a tripla opzione di rilascio.

01-	Parametro: Flessibilità e resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Precisione del meccanismo di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLIE DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-						
26	New Medical Solutions srl	-						

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	70,00	1,00	70,00
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "....Diametri dello stent" richiesti 4 mm offerti 5 mm, manca anche della lunghezza dello shaft richiesto 135 cm. offerto 120 cm, L'operatore economico **New Medical Solutions srl.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo ".... Diametro minimo e massimo dello stent" richiesto 4 mm e 14 mm, offerto 6 mm e 12 mm. La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 040 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0101

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT AUTOESPANDIBILE****Lotto 101 - STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE DI DIAMETRO FINO A 12 MM - CIG : B14C2DE93B**

Descrizione: Stent self-expandable in Nitinol Piattaforma indicato per il trattamento di lesioni dell'arteria iliaca. Diametro nominale di espansione da 6 a 12 mm. Lunghezza dello stent da 20 a 150mm. Coating con bio inducer surface. "Single hand" delivery system con doppio sistema di rilascio: micrometrico e pull-back.

01-	Parametro: Flessibilità e resistenza al kinking		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pt	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-	-	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00

04-	Parametro: Precisione del meccanismo di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-	0,60	-	-
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,60	0,60	0,60		1,00	10,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-	1,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
23	Aetos Medical Srl	-	42,00	-				
26	New Medical Solutions srl	70,00		Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
23	Aetos Medical Srl	-	70,00	-	-
26	New Medical Solutions srl	70,00		1,00	70,00

NOTE

L'operatore economico **Aetos Medical Srl**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "....**manca diametri minimi e lunghezza massima.....**". richiedi 6, 7 e 8 mm offerto 9 mm mentre la lunghezza richiesta 150 mm offerta 80 mm. La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 041 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0102

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT AUTOESPANDIBILI A RILASCIO DI FARMACI**

Lotto 102 - STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE A RILASCIO DI FARMACO SIROLIMUS - CIG : B14C2DFA0E

Descrizione: Stent self-expandable polymer-free in Nitinol a rilascio di Sirolimus, rilascio abluminale controllato di Sirolimus + acidi grassi, single hand delivery system con doppio sistema di rilascio: micrometrico e pull-back. Diametri da 6 mm a 8 mm, lunghezze da 20 mm a 150 mm. Compatibilità introduttore 6 Fr, compatibilità filo guida 0,035", lunghezza catetere 85 cm e 135 cm.

01-	Parametro: Tempo e modalità di rilascio del farmaco			Criterio: QL			punteggio: 20	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00

04-	Parametro: Disponibilità di studi clinici in Letteratura a supporto		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA		Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
		-			-			
		-			-			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 042 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0103

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
BARE STENT AUTOESPANDIBILI A RILASCIO DI FARMACI**

Lotto 103 - STENT PERIFERICO AUTOESPANDIBILE A RILASCIO DI FARMACO PACLITAXEL - CIG : B14C2E0AE1

Descrizione: Stent auto-espandibile in Nitinol a rilascio di farmaco Paclitaxel (3 µg/mm²), per il trattamento di vasi periferici (arteria femorale superficiale e poplitea sopra il ginocchio), senza rivestimento polimerico. Sistema di rilascio triassiale disponibile in tutte le misure, compatibile con introduttore da 6 Fr. Presenza di 4 markers d'oro posti su ognuna delle estremità dello stent.

Lunghezza dello shaft: 80 e 125 cm

Diametri dello stent: da 5 mm a 8 mm

01-	Parametro: Tempo e modalità di rilascio del farmaco		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pt	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	20,00

04-	Parametro: Disponibilità di studi clinici in Letteratura a supporto		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

05-	Parametro: Disponibilità di diametri e lunghezze		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	-	-	-	1,00	-	-
24	COOK ITALIA SRL	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	42,00		-			
24	COOK ITALIA SRL	70,00			Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE		
10	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	-	70,00		-	-		
24	COOK ITALIA SRL	70,00			1,00	70,00		

NOTE

L'operatore economico **BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a "....diametro minimo e massimo.....", richiesti 5 mm e 8 mm offerti 6 mm e 7 mm. La Commissione NON procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 43 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0104

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE
Lotto 104 - STENT IN ACCIAIO RICOPERTI PREMONTATI - CIG : B14C2E1BB4**

Descrizione: Stent in acciaio con design a celle aperte, totalmente incapsulato in tessuto in PTFE ultrasottile, espandibile mediante gonfiaggio con palloncino non compliante. Indicato per il trattamento delle arterie iliache e renali. Possibilità di essere dilatato per la sua intera lunghezza o parzialmente oltre il diametro nominale. Dotato di shaft lungo 80 o 120 cm. Compatibili con filo guida da 0.035" ed introduttori da 6 a 7 Fr. Misure: tutti i diametri e le lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
16	MAQUET Italia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
16	MAQUET Italia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
16	MAQUET Italia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
16	MAQUET Italia	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
16	MAQUET Italia	7 DIAMETRI + 8 LUNGHEZZE		15,00	15,00	1,00	10,00
23	Aetos Medical Srl	-		-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
16	MAQUET Italia	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
23	Aetos Medical Srl	-			-			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
16	MAQUET Italia	70,00	70,00	1,00	70,00
23	Aetos Medical Srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **Aetos Medical Srl**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " lunghezza dello shaft ..." richiesto uno shaft corto da 80 cm offerto solo uno da 120 cm.. La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza del requisito minino

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE
Lotto 105 - Stent in cromocobalto ricoperti premontati - CIG : B14C2E2C87**

Descrizione: Stent in cromocobalto ricoperto in ePTFE premontato su pallone OTW o monorail utilizzabile per il trattamento di aneurismi, fistole, dissezioni o rotture dei vasi del distretto periferico. Maglie dello stent ad anelli corrugati con elevata forza radiale. Diametri compresi tra circa 2,5 mm e 10 mm. Lunghezze comprese tra circa 8 mm 58 mm. Disponibilità doppio shaft 75 e 120 cm. Compatibilità con introduttore di diametro massimo 6F fino al diametro di 8mm.

Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-
05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	6 DIAMETRI + 5 LUNGHEZZE			11,00	11,00	1,00	10,00
23	Aetos Medical Srl	-			-		-	-
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
18	CARDIO VASCULAR SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
23	Aetos Medical Srl	-			-			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATI		PUNTEGGIO FINALE	
18	CARDIO VASCULAR SRL	70,00	70,00		1,00		70,00	
23	Aetos Medical Srl	-			-		-	

NOTE

L'operatore economico **Aetos Medical Srl**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a "....mancanza di Stent in cromocobalto...." offerto in acciaio inossidabile 316L. La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



REGIONE BASILICATA

ALLEGATO N. 45 AL VERBALE N. 03 DEL 13.12.2024 - L0106

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE**

Lotto 106 - STENT IN CROMOCOBALTO RICOPERTI PER IL TRATTAMENTO DELLE COARTAZIONI AORTICHE - CIG : B14C295CFC

Descrizione: Stent in cromocobalto ricoperto in ePTFE premontato su pallone OTW per il trattamento di coartazione aortica. Maglie dello stent ad anelli corrugati con elevata forza radiale. Diametri compresi tra circa 12 mm e 24 mm. Lunghezze comprese tra circa 19 mm e 59 mm. Disponibilità doppio shaft 75 e 120 cm. Compatibilità con introduttore da 9 a 14 F.

Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,50	0,60	0,57		0,57	8,50
02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	0,80	0,87	0,89	0,89	1,00	15,00
19	AB MEDICA SPA	0,60	0,60	0,60	0,60		0,67	10,11
03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	0,80	1,00	1,00	0,93	0,93	1,00	10,00
19	AB MEDICA SPA	0,40	0,40	0,40	0,40		0,43	4,29
04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
19	AB MEDICA SPA	0,50	0,40	0,50	0,47		0,47	9,33
05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
18	CARDIO VASCULAR SRL	7 DIAMETRI + 5 LUNGHEZZE			12,00	16,00	0,75	7,50
19	AB MEDICA SPA	7 DIAMETRI + 9 LUNGHEZZE			16,00		1,00	10,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
18	CARDIO VASCULAR SRL	67,50	42,00		Soglia sbarramento superata			
19	AB MEDICA SPA	42,23			-			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE		
18	CARDIO VASCULAR SRL	67,50	67,50		1,00	70,00		
19	AB MEDICA SPA	42,23			0,63	43,80		

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI****STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE****Lotto 107 - STENT PREMONTATI RICOPERTI IN PTFE CON LEGAME COVALENTE DI EPARINA - CIG : B14C296DCF**

Descrizione: stent coperto espandibile su pallone, ricoperto in ePTFE con legame stabile covalente di eparina a punto unico, costituita da uno stent in acciaio inossidabile ad anelli indipendenti, premontato su pallone, catetere di rilascio da 80 o 135 cm, compatibile con guida da 0.035" con due markers radiopachi integrati sullo shaft del catetere. Diametri da 5 a 11 mm, espandibili fino a 16 mm e lunghezze da 15 a 79 mm.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00
							- -

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
							- -

04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 20
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 20,00
							- -

05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	8 DIAMETRI + 6 LUNGHEZZE			14,00	14,00	1,00 10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento			
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata			
		-		-			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRAT	PUNTEGGIO FINALE
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	70,00	1,00	70,00
		-		-	-

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT COPERTI PREMONTATI SU PALLONE****Lotto 108 - STENT IN ACCIAIO PREMONTATI INCAPSULATO IN DUE STRATI DI PTFE - CIG : B14C26ECCD**

Descrizione: Stent in acciaio inossidabile espandibile su pallone non conforme a spalle corte, incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE. Diametro dello stent da 5 mm a 12 mm e lunghezza da 16 a 58 mm. Sistema di rilascio compatibile con guida da 0.035" e introduttore da 6, 7 e 8 F a seconda della misura. Lunghezza del catetere da 80 e 135 cm. Indicato per il trattamento di lesioni aterosclerotiche in arterie iliache comuni ed esterne.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	0,90	1,00	0,80	0,90	0,90	1,00	15,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Radiovisibilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 20		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	20,00
23	Aetos Medical Srl	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	7 DIAMETRI + 4 LUNGHEZZE		11,00	11,00	1,00	10,00
23	Aetos Medical Srl	-		-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
23	Aetos Medical Srl	-		-				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	70,00	1,00	70,00
23	Aetos Medical Srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **Aetos Medical Srl**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minimo di capitolato relativo a " lunghezza e diametro minimo e massimo ...", diametri richiesti da 5 a 11 mm, offerti 6 e 7 mm. Inoltre la lunghezza richiesta da 15 a 79 mm offerti da 22 a 59 mm. La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT COPERTI AUTOESPANDIBILI**

Lotto 109 - ENDOPROTESI PERIFERICA AUTOESPANDIBILE IN PTFE CON LEGAME COVALENTE DI EPARINA - CIG : B14C29C2C6

Descrizione: Endoprotesi periferica ricoperta in ePTFE a parete ultrasottile con legame stabile covalente di eparina a punto unico, montata su stent esterno in nitinol autoespandibile con markers radiopachi. Sistema di rilascio compatibile con guida da 0.018 o 0.035" di lunghezza 110 cm, con due markers radiopachi sullo shaft del catetere. Sistema di rilascio con filo a rotazione in un'unica fase. Diametri da 5 a 13 mm con lunghezze da 2.5 a 25 cm.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15			
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	0,80	0,60	0,60	0,67	0,67	1,00	15,00	
02-	Parametro: Facilità del sistema di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00	
03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	
04-	Parametro: Tecnologia antitrombotica		Criterio: SI/No				punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA						COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione						1,00	10,00
04-	Parametro: Presenza di eparina		Criterio: SI/No				punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA						COEFF.	PUNTEGGIO
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione						1,00	10,00
05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1				punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	8 DIAMETRI + 6 LUNGHEZZE			14,00	14,00	1,00	10,00	
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO								
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento				
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata				
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE								
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE		
9	W.L. GORE E ASSOCIATI S.R.L.	70,00	70,00		1,00		70,00		

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE
OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura :**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT COPERTI AUTOESPANDIBILI**

Lotto 110 - STENT COPERTO AUTOESPANDIBILE IN NITINOL INCAPSULATO IN DUE STRATI DI PTFE - CIG : B14C2A5A31

Descrizione: Stent vascolare ricoperto autoespandibile in nitinol incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE con lume interno impregnato al Carbonio. 4 marker radiopachi in Tantalio su ciascuna estremità dello stent. Diametro dello stent da 5 mm a 13,5 mm e lunghezza da 20 a 120 mm. Sistema di rilascio OTW compatibile con guida 0,035" e introduttori da 8 a 10F. Lunghezza sistema di rilascio da 80 e 117 cm. Indicato per uso nelle arterie iliache e femorali.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Facilità del sistema di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Tecnologia antitrombotica		Criterio: SI/No			punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-				-	-

04-	Parametro: Presenza di eparina		Criterio: SI/No			punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA				COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione				1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-				-	-

05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze		valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	8 DIAMETRI + 7 LUNGHEZZE		15,00	15,00	1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	-		-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				
26	New Medical Solutions srl	-		-				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE			
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	70,00	1,00	70,00			
26	New Medical Solutions srl	-		-	-			

NOTE

L'operatore economico **New Medical Solutions srl**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " **assenza grandi diametri e lunghezza minima e massima** ...", richiesti diametri da 5 mm a 13,5 mm, offerti da 5 a 9 mm, mentre la lunghezza richiesta è da 20 a 120 cm, offerti da 40 a 100 cm . La Commissione **NON** procede alla valutazione dello stesso per carenza del requisito minimo.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI

STENT COPERTI AUTOESPANDIBILI

Lotto 111 - STENT COPERTO AUTOESPANDIBILE IN NITINOL INCAPSULATO IN DUE STRATI DI PTFE IMPREGNATO AL CARBONIO - CIG : B14C29B1F3

Descrizione: Stent vascolare ricoperto autoespandibile in Nitinol, interamente incapsulato in due strati extra-sottili di ePTFE con lume interno impregnato al Carbonio. Disponibile in versione retta e conica. Diametri dello stent da 6 a 10 mm e lunghezze da 30 a 100 mm. Sistema di Rilascio Triassiale OTW con guaina esterna di supporto e Manipolo Ergonomico a doppia opzione di velocità per il rilascio dello stent. Compatibilità con filo guida da 0,035" e introduttore da 8 e 9 Fr. Lunghezza dello shaft da 80 e 120 cm. Indicato per il trattamento di stenosi nel tratto di efflusso delle fistole artero-venose protesiche o native e per il trattamento di lesioni aterosclerotiche delle arterie iliache e femorali.

01-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Facilità del sistema di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-	-	-	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Tecnologia antitrombotica		Criterio: SI/No			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-					-	-
26	New Medical Solutions srl	-					-	-

04-	Parametro: Presenza di eparina		Criterio: SI/No			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	SOLUZIONE OFFERTA					COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	La qualità richiesta è dichiarata espressamente in relazione					1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-					-	-
26	New Medical Solutions srl	-					-	-

05-	Parametro: Gamma di diametri e lunghezze		Criterio: QT1			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri e lunghezze			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	5 DIAMETRI + 5 LUNGHEZZE			17,00	17,00	1,00	10,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-			-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-			-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-			-			
26	New Medical Solutions srl	-			-			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
6	BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00	70,00	1,00	70,00
21	CARDIO.TEK s.r.l.	-		-	-
26	New Medical Solutions srl	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **CARDIO.TEK s.r.l.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " lume interno non è impregnato al Carbonio ..." e " non è Disponibile in versione conica ...". L'operatore economico **New Medical Solutions srl**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " Manca il diametro da 10 ..." e " manca la lunghezza minima 30 mm ...". La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza dei requisiti minimi.

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT CAROTIDEI
Lotto 112 - STENT CAROTIDEO IN NITINOL A CELLE APERTE - CIG : B14C27636A**

Descrizione: Stent in Nitinol autoespandibile a celle aperte, disponibile nelle forme cilindrica o conica. Markers prossimali e distali sullo stent. Sistema di ritenzione dello stent per eliminare l'effetto jumping in seguito a rilascio. Sistema di rilascio a semplice pull-back. Lunghezza del catetere di rilascio 135cm. Compatibilità con introduttore 6Fr e filoguida 0.014". Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,50	0,60	0,50	0,53	0,93	0,57	5,71
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,80	1,00	0,93		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,60	0,60	0,60		0,64	6,43
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

02-	Parametro: Radiopacità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,67	0,67	0,67	0,67	0,87	0,77	11,60
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	0,60	0,87		1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	1,00	0,80	0,80	0,87		1,00	15,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-			

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,60	0,50	0,70	0,60	0,93	0,64	6,43
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	0,80	0,93		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,50	0,50	0,53		0,57	5,71
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,67	0,53	0,67	0,62	1,00	0,62	9,35
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	15,00
26	New Medical Solutions srl	0,80	0,67	0,67	0,71		0,71	10,70
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

04-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	0,50	0,60	0,60	0,57	0,93	0,61	6,07
23	Aetos Medical Srl	1,00	0,80	1,00	0,93		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	0,60	0,50	0,50	0,53		0,57	5,71
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-	-	-		-	-

05-	Parametro: Ampiezza della gamma di diametri disponibili		Criterio: QT1			punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	ampiezza diametri disponibili	valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	DIAMETRI	6,00	7,00	0,86	8,57
23	Aetos Medical Srl	DIAMETRI	7,00		1,00	10,00
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI	7,00		1,00	10,00
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-	-		-	-

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO					
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento		
7	Cordis Italy S.r.l.	47,73	42,00	Soglia sbarramento superata		
23	Aetos Medical Srl	70,00		Soglia sbarramento superata		
26	New Medical Solutions srl	53,56		Soglia sbarramento superata		
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-		-		

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	47,73	70,00	0,68	47,73
23	Aetos Medical Srl	70,00		1,00	70,00
26	New Medical Solutions srl	53,56		0,77	53,56
27	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	-		-	-

NOTE

L'operatore economico **ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.**, offre un prodotto che non rispetta il requisito minino di capitolato relativo a " Lunghezza del catetere di rilascio 135 cm ...", offerto 132 cm. La Commissione **NON** procede alla valutazione degli stessi per carenza dei requisiti minimi.

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT CAROTIDEI****Lotto 113 - STENT CAROTIDEO RICOPERTO A COPERTURA DI PLACCA - CIG : B14C2F8EAE**

Descrizione: Stent carotideo in nitinol ricoperto da retina di Pet dallo spessore di 20µ. Si richiede la presenza di 4 markers radioopachi ed un accorciamento radiale non superiore al 10%. Diametro iesterno del sistema non superiore a 6 Fr, compatibilità con catetere guida 8Fr. Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

02-	Parametro: Radiopacità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

05-	Parametro: Ampiezza della gamma di diametri disponibili		Criterio: QT1			punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri	valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	DIAMETRI	5,00	5,00	1,00	10,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO					
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento		
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata		

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT CAROTIDEI**

Lotto 114 - STENT CAROTIDEO IN NITINOL A CELLE CHIUSE - CIG : B14C2698AE

Descrizione: Stent a memoria di forma, autoespandibile, con design a celle chiuse, < a 2 mm². Dotato di sistema a scambio rapido (monorail) e di sistema di rilascio "pull-back", con possibilità di recupero parziale e riposizionabilità. Compatibile con filo guida da 0.014", introduttori da 5 o 6 Fr e cateteri guida da 7 e 8 Fr. Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
02-	Parametro: Radiopacità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
04-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
05-	Parametro: Ampiezza della gamma di diametri disponibili		Criterio: QT1				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	CARDIO.TEK s.r.l.	DIAMETRI			3,00	3,00	1,00	10,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
21	CARDIO.TEK s.r.l.	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421****MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT CAROTIDEI****Lotto 115 - STENT CAROTIDEO RICOPERTO A COPERTURA DI PLACCA AD ELEVATA FLESSIBILITA' - CIG : B14C29D399**

Descrizione: Stent carotideo a fili intrecciati autoespandibile in nitinol, con dispositivo di rilascio tipo RX per il trattamento di lesioni arteriose stenotiche od occlusive della carotide, a doppia maglia, con micromaglia interna intrecciata alla maglia esterna per un ottimale scaffolding di placca; elevata flessibilità ed adattabilità vasale. Compatibile con guide da 0,014" e introduttore 5 Fr per tutte le misure. Ricatturabile e riposizionabile con sistema di rilascio «push & pull». Diametri da 5 mm a 10 mm e lunghezze da 20 a 40 mm. Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
02-	Parametro: Radiopacità		Criterio: QL			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00
03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00
04-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00
05-	Parametro: Ampiezza della gamma di diametri disponibili		Criterio: QT1			punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta		diametri		valore	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
13	TERUMO ITALIA S.r.l.		DIAMETRI		6,00	6,00	1,00 10,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento			Verifica Soglia di sbarramento	
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00				Soglia sbarramento superata	
			42,00				
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE	
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00			1,00	70,00	
			70,00				

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
STENT CAROTIDEI**

Lotto 116 - STENT CAROTIDEO IN NITINOL A CELLE CHIUSE AD ALTA FORZA RADIALE PER LESIONI CALCIFICHE - CIG : B14C29E46C

Descrizione: Stent vascolari carotidei autoespandibili in Nitinol con disegno a celle chiuse, ad elevata forza radiale nella zona centrale; sistema di rilascio micrometrico a scambio rapido. Disponibile in forma cilindrica e conica. Compatibile con introduttore 6Fr e cateteri guida 8F. Misure: tutti i diametri e lunghezze disponibili.

01-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
02-	Parametro: Radiopacità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
03-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
04-	Parametro: Precisione di rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
04-	Parametro: Forza radiale		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
05-	Parametro: Ampiezza della gamma di diametri disponibili		Criterio: QT1				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	diametri			valore	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	DIAMETRI			7,00	7,00	1,00	10,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
21	ABBOTT MEDICAL ITALIA S.r.l.	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
13	TERUMO ITALIA S.r.l.	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE
Lotto 117 - ENDOPROTESI AORTICA BIMODULARE IN DACRON CON AGGANCIO SOPRARENALE - CIG : B14C2A16E5**

Descrizione: Endoprotesi bimodulare per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale con fissaggio soprarenale e uncini, stent in nitinolo e protesi in poliestere. Disponibilità di segmenti aggiuntivi di estensioni aortiche e segmenti conici. Possibilità di trattamento con colletto prossimale della lunghezza maggiore o uguale a 10mm. IFU per il trattamento di aneurismi iuxtaerenali in associazione con stent ricoperti per arterie renali (tecnica Chimney). Meccanismo di rilascio dello stent soprarenale indipendente dall'apertura della protesi nella porzione coperta, a vite micrometrica per possibilità di adattamento durante il posizionamento. Dispositivo di introduzione a basso profilo e idrofilico.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio:	10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
23	Aetos Medical Srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421



MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE
Lotto 118 - ENDOPROTESI AORTO-UNILIACA IN DACRON CON AGGANCIO SOPRARENALE - CIG : B14C2A6B04

Descrizione: Endoprotesi aorto-uniliaca per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale, con fissaggio soprarenale ed uncini, con stent a memoria di forma rivestito di poliestere, composta di componente prossimale di minor lunghezza possibile - per un adattamento alle anatomie con ridotta lunghezza tra arterie renali e biforcazione aortica, e componente distale di diversi calibri e lunghezze, comprensiva di sistema di introduzione (il sistema di introduzione deve essere già compreso oppure specificato a parte con apposito codice ma il suo costo deve essere compreso entro la base d'asta). Il sistema può prevedere un impiego primario o una conversione su precedente impianto biforcato. Deve essere fornito un occluder per l'asse iliaco controlaterale.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00
04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio:	punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00
06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			
07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
23	Aetos Medical Srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

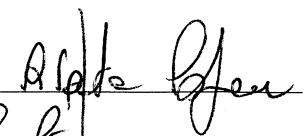dott.ssa Angela BAIANO 
dott. Danilo MENNA 

dott.ssa Ripalta PAGLIONE 
geom. Pietro ROTA 



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE
Lotto 119 - ENDOPROTESI AORTICA RETTA IN DRACON - CIG : B14C2A7BD7**

Descrizione: Endoprotesi aortica retta per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale, con stent a memoria di forma rivestito in poliestere, con stent scoperto soprarenale dotato di uncini per il fissaggio alla parete aortica, dotato di meccanismo di rilascio controllato per possibilità di adattamento durante il posizionamento.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
23	Aetos Medical Srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
23	Aetos Medical Srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
23	Aetos Medical Srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE**

Lotto 120 - ENDOPROTESI AORTICA TRIMODULARE IN DACRON CON AGGANCIO SOPRARENALE PER COLLETTI ANGOLATI FINO A 60° - CIG : B14C2A8CAA

Descrizione: Endoprotesi biforcata trimodulare per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale in poliestere con aggancio soprarenale, endo/eso scheletro in nitinolo. Le endoprotesi usate per il trattamento sono precaricate in introduttori idrofilici armati a basso profilo esterno, ≤ 19Fr per il corpo principale e ≤ 16Fr per l'estensione iliaca. Per facilitare la visualizzazione fluoroscopica tali endoprotesi presentano marker radiopachi in oro. Corpo protesico principale diametri da 22 a 36 mm, lunghezze al controlato da 70 a 128mm. Estensione iliaca diametri da 9 a 24 mm, lunghezze da 42 a 125mm.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio:	punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENAL
Lotto 121 - BRANCA ENDOPROTESICA ILIACA IN DACRON - CIG : B14C2A9D7D**

Descrizione: branche endoprotesiche iliache in poliestere, endo/eso scheletro in nitinolo, marker radiopachi in oro. Diametri da 9 a 24 mm, lunghezze da 42 a 125mm

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

Angela BAIANO
Danilo MENNA

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

Ripalta PAGLIONE
Pietro ROTA

geom. Pietro ROTA



PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE
Lotto 122 - ENDOPROTESI PER CONVERSIONE DA IMPIANTO BISILIACO E MONOILIACO - CIG : B14C298F75**

Descrizione: Endoprotesi per conversione di impianto da bisiliaco a monoiliaco (converter) e cuffia aortica. Endoprotesi in poliestere con endo/eso scheletro in nitinolo. Le endoprotesi usate per il trattamento sono precaricate in introduttori idrofilici armati a basso profilo esterno. Per facilitare la visualizzazione fluoroscopica tali endoprotesi presentano

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO	
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00	

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE**

Lotto 123 - ENDOPROTESI TRIMODULARE ULTRA-LOW-PROFILE PER ACCESSI VASCOLARI OSTILI E/O DI PICCOLO CALIBRO - CIG : B14C2A388B

Descrizione: Endoprotesi trimodulare in nitinolo ultra-low-profile per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale, con aggancio soprarenale. Diametro esterno sistema di rilascio ≤16Fr per il corpo principale e ≤ 13Fr per l'estensione iliaca. Possibilità di modulare la lunghezza della gamba in fase operatoria di 3 cm per ipsilaterale e di 2 cm per omolaterale.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio:	15	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
7	Cordis Italy S.r.l.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERIFICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento	Verifica Soglia di sbarramento				
7	Cordis Italy S.r.l.	70,00	42,00	Soglia sbarramento superata				

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
7	Cordis Italy S.r.l.	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

dott. Danilo MENNA

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE**

Lotto 124 - ENDOPROTESI AORTICA TRIMODULARE CON AGGANCIO SOPRARENALE PER COLLETTI ANGOLATI FINO A 75° - CIG : B14C2AAE50

Descrizione: Endoprotesi bimodulare per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale con colletto prossimale con angoli $\leq 75^\circ$. Stent in Nitinol rivestito in polietilene tereftalato (PET) ultra sottile con tessitura Woven a bassa porosità e privo di suture. Aggancio soprarenale attivo con uncini, e meccanismo a T per la cattura e rilascio separato dello stesso. Meccanismo di Rilascio "squeeze to release" costituito da un catetere idrofilico con armatura a spirale, per consentire una maggiore flessibilità e navigabilità in situazioni anatomiche complesse. Possibilità di modulo branched per il salvataggio dell'arteria ipogastrica.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL			punteggio: 10		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL			punteggio:	punteggio:	15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE
Lotto 125 - ENDOPROTESI AORTO-UNILIACO PER COLLETTI ANGOLATI FINO A 75° - CIG : B14C28C591**

Descrizione: Endoprotesi aortomonoiliaca per trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale con colletto prossimale con angolo $\leq 75^\circ$. Stent in Nitinolo rivestito in polietilentereftalato (PET) ultra sottile con tessitura Woven a bassa porosità e privo di suture. Aggancio sopra renale attivo con uncini, e meccanismo a T per la cattura e rilascio separato dello stesso. Meccanismo di Rilascio "squeeze to release" costituito da un catetere idrofilico con armatura a spirale, per consentire una maggiore flessibilità e navigabilità in situazioni anatomiche complesse.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio: 10
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 10,00

04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL				punteggio: 15
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF. PUNTEGGIO
26	New Medical Solutions srl	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00 15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO						
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento		
26	New Medical Solutions srl	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata		

07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE				
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max	COEFF. RIPARAMETRATO	PUNTEGGIO FINALE
26	New Medical Solutions srl	70,00	70,00	1,00	70,00

NOTE

dott.ssa Angela BAIANO

dott. Danilo MENNA

dott.ssa Ripalta PAGLIONE

geom. Pietro ROTA

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA VASCOLARE OCCORRENTI
ALL'A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA E ALL'AZIENDA SANITARIA DI MATERA - Edizione II - Riferimento procedura : G00421**

**MATERIALE PER PROCEDURE ENDOVASCOLARI
ENDOPROTESI PER AORTA ADDOMINALE CON AGGANCIO SOPRARENALE**

**Lotto 126 - ENDOPROTESI AORTICA TRIMODULARE CON AGGANCIO SOPRARENALE PER COLLETTI ANGOLATI FINO A 75° CON MECCANISMO DI RECUPERO DEL PUNTALE
FACILITATO PER ANATOMIE TORTUOSE - CIG : B14C2ABF23**

Descrizione: Endoprotesi biforcata tri-modulare, con stent in nitinol elettrolucidato e graft in Dacron. Possibilità di trattare colletti di lunghezza uguale a 10 mm fino a 60° di angolazione e 15mm fino a 75° di angolazione. Stent scoperto prossimale con doppia fila di barbs sia a livello soprarenale che a livello infrarenale. Presenza di barbs anche nei penultimi stent distali del corpo biforcuto per evitare migrazione delle gambe. Sistema di rilascio del corpo principale a vite (o pull back). Esclusivo sistema di clamping del puntale prossimale, che consente il riposizionamento fino al rilascio dello stent scoperto e la non ricattura dello stesso dopo la fase di rilascio. Possibilità di cuffia aortica.

01-	Parametro: Conformabilità		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

02-	Parametro: Precisione di posizionamento		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

03-	Parametro: Precisione nel rilascio		Criterio: QL			punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

04-	Parametro: Flessibilità		Criterio: QL				punteggio: 10	
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10,00


04-	Parametro: Navigabilità		Criterio: QL		punteggio:	punteggio: 15		
N.pl	Rag. sociale ditta	BAIANO	PAGLIONE	MENNA	MEDIA	Max MEDIA	COEFF.	PUNTEGGIO
2	Serom Medical Technology SRL	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15,00

06-	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO E VERICA SOGLI DI SBARRAMENTO							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Soglia di sbarramento		Verifica Soglia di sbarramento			
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	42,00		Soglia sbarramento superata			


07-	TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA E RIPARAMETRAZIONE							
N.pl	Rag. sociale ditta	Punteggio	Punteggio Max		COEFF. RIPARAMETRATO		PUNTEGGIO FINALE	
2	Serom Medical Technology SRL	70,00	70,00		1,00		70,00	

NOTE


dott.ssa Angela BAIANO



dott. Danilo MENNA



dott.ssa Ripalta PAGLIONE



geom. Pietro ROTA

